



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUBACAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/10/1993	<b>Profession</b> CHAUFFEUR BUS
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CAWA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 11	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 54 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 702,1 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 44 %

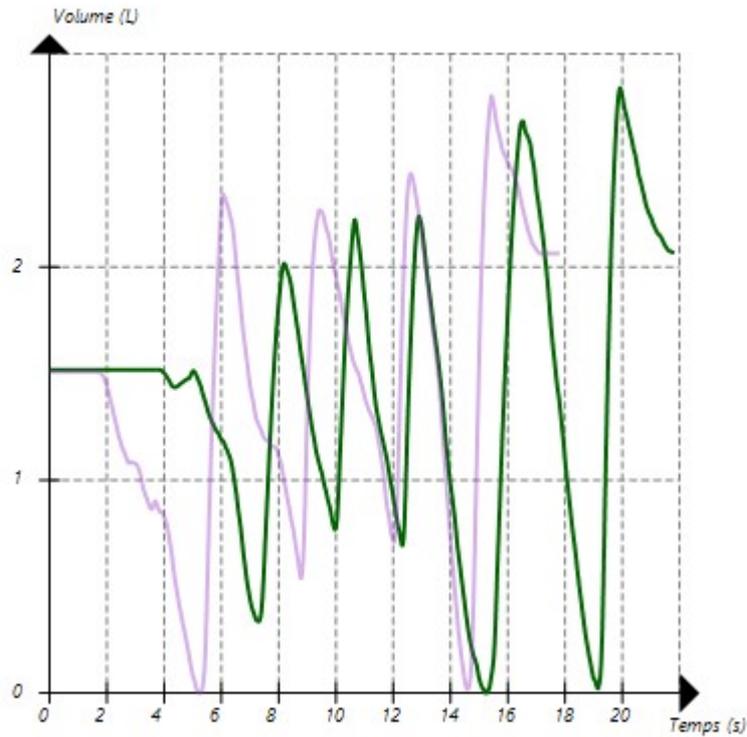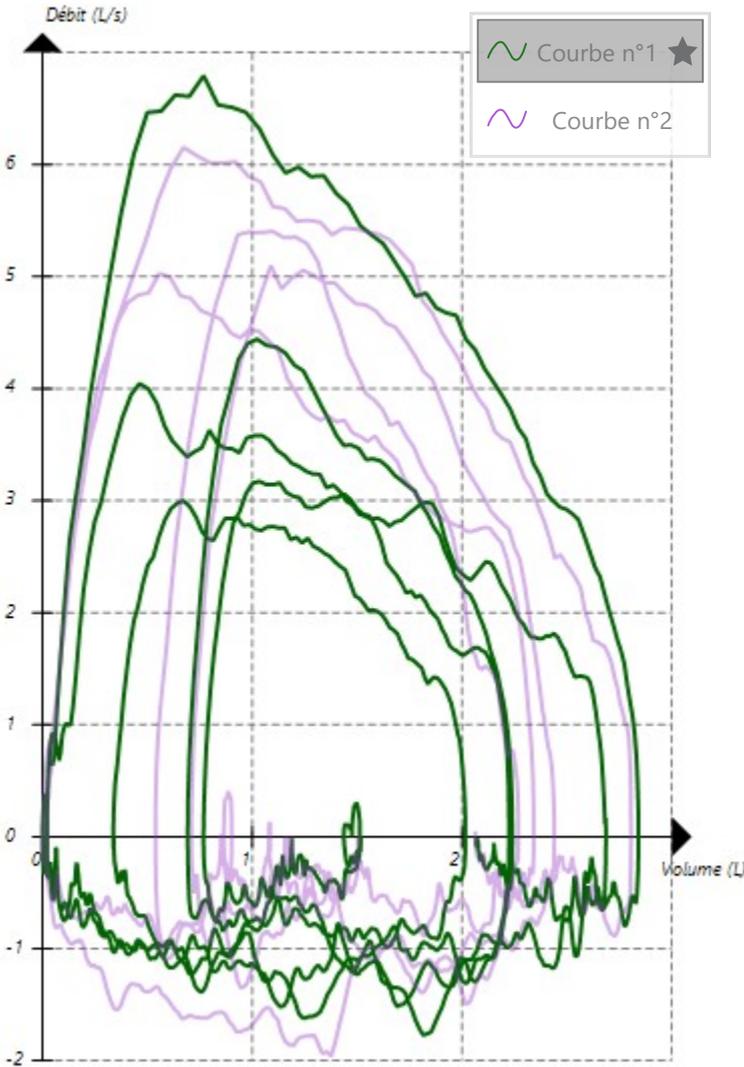

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,82 L	2,79 L	4,69 L	60,13 %
VEMS	2,82 L	2,79 L	3,92 L	71,94 %
DEP	6,95 L/s	6,25 L/s	9,86 L/s	70,49 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	83,76 %	119,39 %
Durée d'expiration	0,77 s	0,85 s	-	
DEMM	5,57 L/s	5,34 L/s	4,27 L/s	130,44 %
DEMM/ CVF	1,98 s-1	1,91 s-1	0,91 s-1	217,58 %
DE75	6,61 L/s	6,17 L/s	-	
DE50	5,61 L/s	5,38 L/s	-	
DE25	4,10 L/s	3,83 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: