

**Nom KOUROUMA**  
**Prénom BANGALY**  
**Né le** 04/08/1999  
**Age** 26 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 171  
**Taille** 171 cm  
**Poids** 72 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** PLOMBIER  
**Entreprise**  
**Service** KCTC  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 29,9 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 51 %

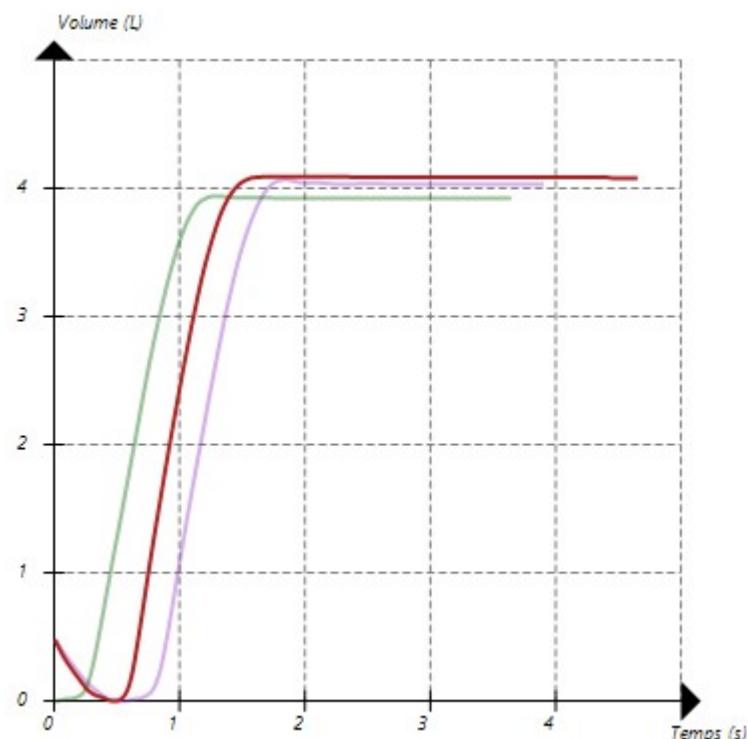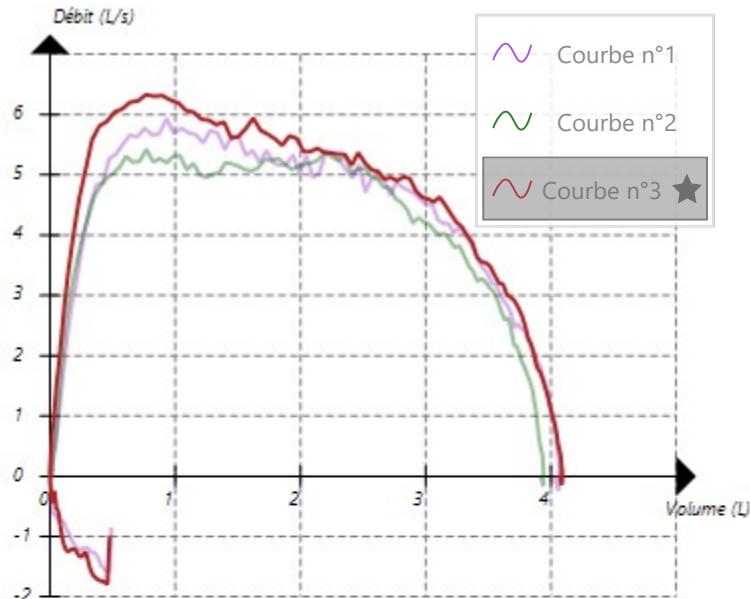

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,07 L	3,94 L	4,09 L	4,24 L	96,46 %
VEMS	4,07 L	3,94 L	4,09 L	3,60 L	113,61 %
DEP	6,02 L/s	5,56 L/s	6,44 L/s	9,16 L/s	70,31 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,49 %	118,36 %
Durée d'expiration	1,33 s	1,28 s	1,20 s	-	
DEMM	5,28 L/s	5,14 L/s	5,51 L/s	4,10 L/s	134,39 %
DEMM/CVF	1,30 s <sup>-1</sup>	1,30 s <sup>-1</sup>	1,35 s <sup>-1</sup>	0,97 s <sup>-1</sup>	139,18 %
DE75	5,70 L/s	5,37 L/s	6,19 L/s	-	
DE50	5,33 L/s	5,25 L/s	5,43 L/s	-	
DE25	4,50 L/s	4,31 L/s	4,52 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: