

Nom <b>BAMBA</b>	Adresse
Prénom <b>MANDJOU</b>	Exposition
Né le <b>02/01/2003</b>	Profession <b>SOUDEUR</b>
Age <b>22 Ans</b>	Entreprise <b>KCTC</b>
Genre <b>Masculin</b>	Service
ID <b>102</b>	Fumeur <b>Fumeur</b>
Taille <b>174 cm</b>	Groupe ethnique <b>Origine africaine</b>
Poids <b>69 kg</b>	Prescripteur:
Valeurs prédites <b>NHANES III</b>	Smoking Pack Years : <b>0</b>
Opérateur <b>BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	




**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Numéro de série : 253565  
Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Température ambiante : 30,8 °C  
Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
Humidité : 51 %

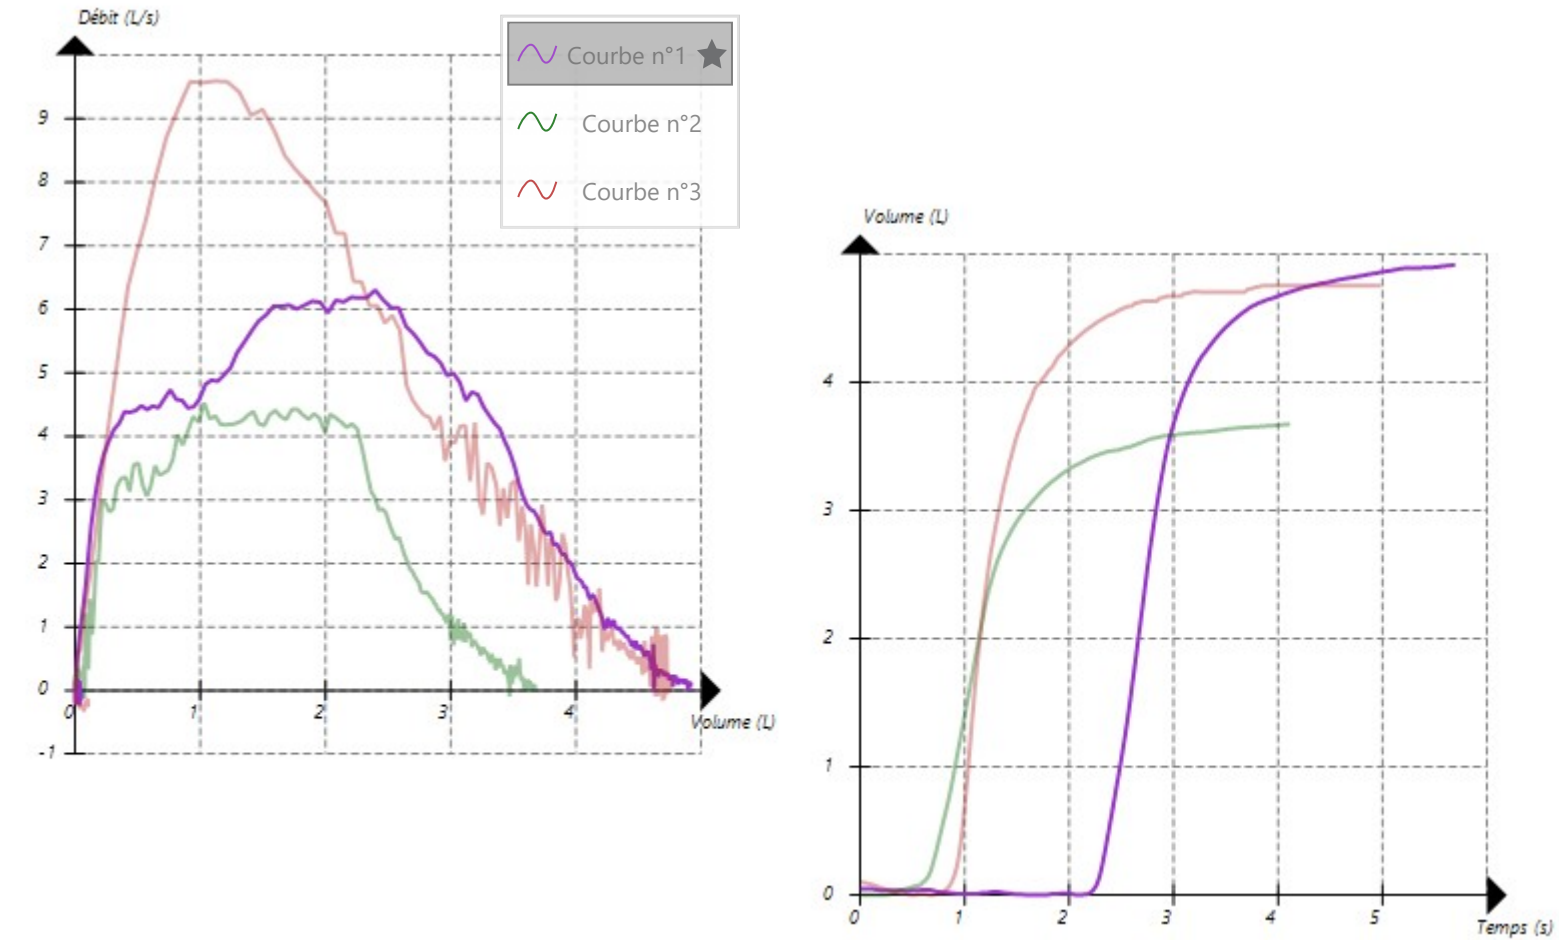

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,92 L	3,57 L	4,76 L	4,49 L	109,58 %
VEMS	4,28 L	3,01 L	4,22 L	3,83 L	111,75 %
DEP	6,34 L/s	4,70 L/s	9,85 L/s	9,60 L/s	66,04 %
VEMS/CVF	86,99 %	84,31 %	88,66 %	85,22 %	102,08 %
Durée d'expiration	3,62 s	3,51 s	3,18 s	-	
DEMM	5,23 L/s	3,58 L/s	5,39 L/s	4,38 L/s	119,41 %
DEMM/CVF	1,06 s-1	1,00 s-1	1,13 s-1	0,98 s-1	108,16 %
DE75	5,07 L/s	4,39 L/s	9,52 L/s	-	
DE50	6,13 L/s	4,40 L/s	6,08 L/s	-	
DE25	2,76 L/s	1,51 L/s	2,98 L/s	-	