

**Nom** CAMARA  
**Prénom** SEKOU SARATA  
**Né** le 01/07/1990  
**Age** 35 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 37  
**Taille** 167 cm  
**Poids**  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MAÇON  
**Entreprise** AGS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,8 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 36 %

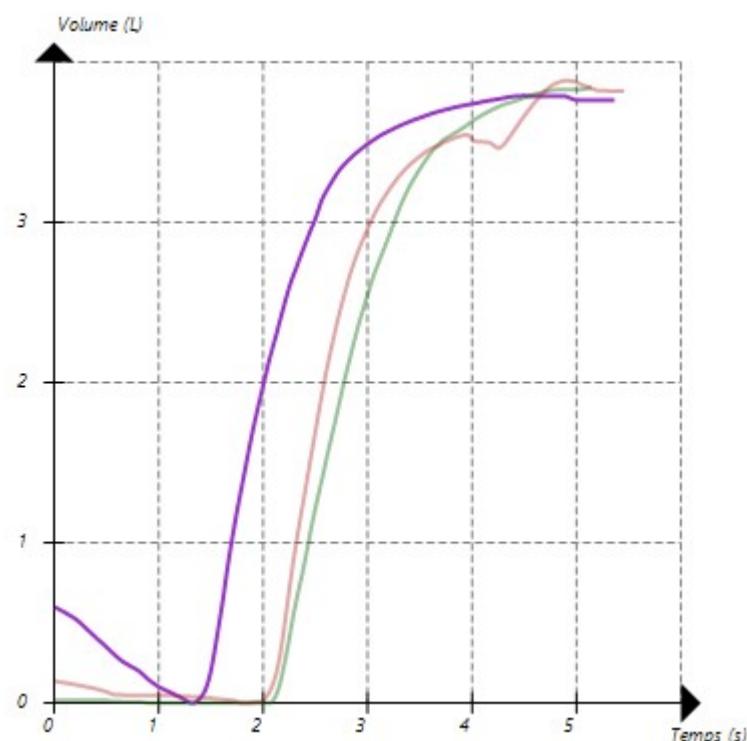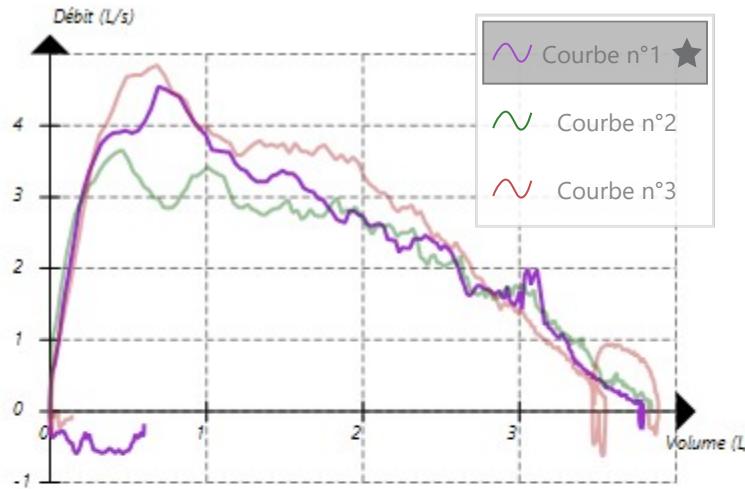

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,79 L	3,84 L	3,54 L	3,85 L	98,44 %
VEMS	2,96 L	2,80 L	3,10 L	3,21 L	92,21 %
DEP	4,63 L/s	3,73 L/s	4,94 L/s	8,42 L/s	54,99 %
VEMS/CVF	78,10 %	72,92 %	87,57 %	82,84 %	94,28 %
Durée d'expiration	3,16 s	3,15 s	1,98 s	-	
DEMM	2,68 L/s	2,52 L/s	3,30 L/s	3,58 L/s	74,86 %
DEMM/CVF	0,71 s <sup>-1</sup>	0,66 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	76,34 %
DE75	4,01 L/s	3,32 L/s	4,19 L/s	-	
DE50	2,70 L/s	2,85 L/s	3,52 L/s	-	
DE25	1,58 L/s	1,64 L/s	2,17 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: