



<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DONGO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/08/1996	<b>Profession</b> ELINGUEUR
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> TRUST AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 75	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

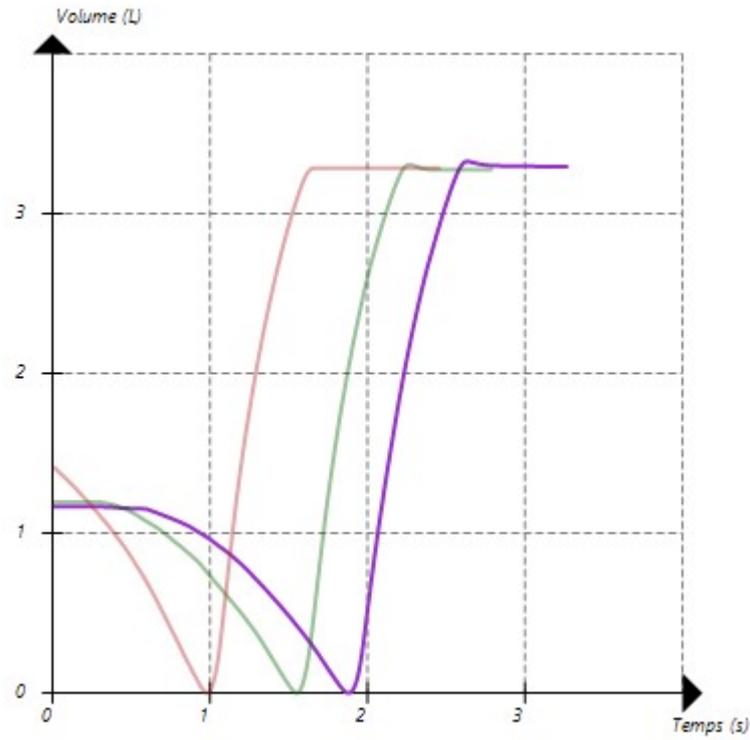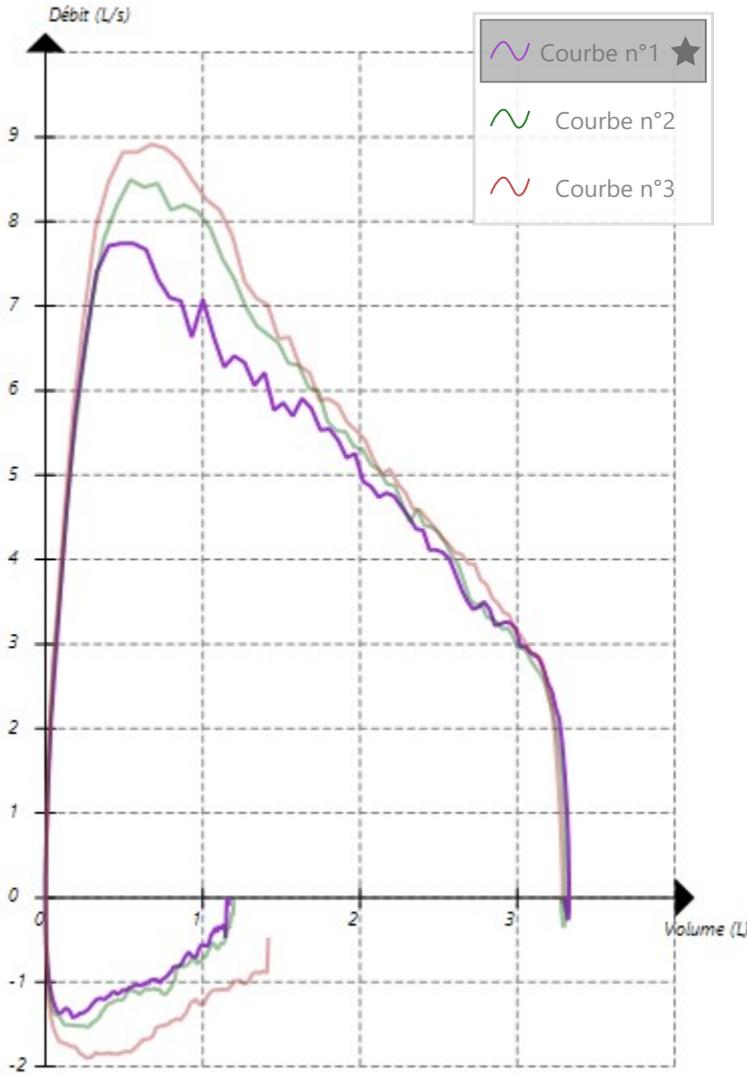

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,33 L	3,31 L	3,29 L	4,44 L	75,00 %
VEMS	3,33 L	3,31 L	3,29 L	3,74 L	89,04 %
DEP	8,10 L/s	8,56 L/s	9,01 L/s	9,45 L/s	85,71 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	0,75 s	0,71 s	0,68 s	-	
DEMM	5,60 L/s	6,08 L/s	6,30 L/s	4,16 L/s	134,62 %
DEMM/ CVF	1,68 s-1	1,84 s-1	1,91 s-1	0,94 s-1	178,72 %
DE75	7,27 L/s	8,12 L/s	8,71 L/s	-	
DE50	5,49 L/s	6,35 L/s	6,31 L/s	-	
DE25	4,15 L/s	4,24 L/s	4,43 L/s	-	