

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/03/1994	<b>Profession</b> ELINGUEUR
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> TRUST AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 89	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 28,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Humidité : 64 %

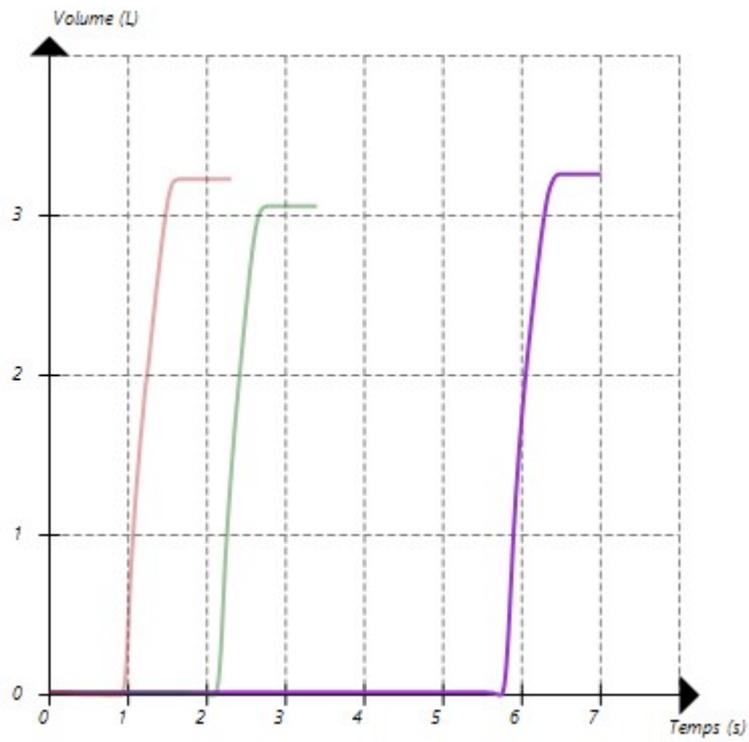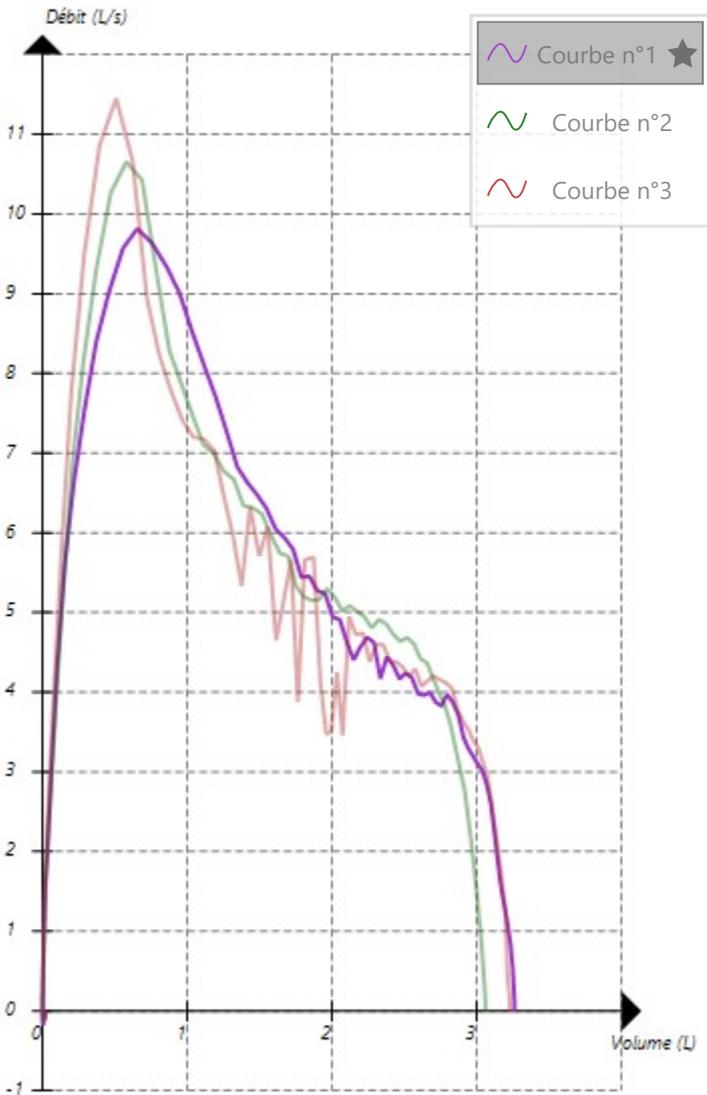

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,26 L	3,06 L	3,23 L	4,38 L	74,43 %
VEMS	3,26 L	3,06 L	3,23 L	3,67 L	88,83 %
DEP	10,00 L/s	10,83 L/s	11,48 L/s	9,33 L/s	107,18 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,57 %	119,66 %
Durée d'expiration	0,76 s	0,70 s	0,83 s	-	
DEMM	6,06 L/s	6,22 L/s	5,47 L/s	4,04 L/s	150,00 %
DEMM/ CVF	1,86 s-1	2,03 s-1	1,69 s-1	0,92 s-1	202,17 %
DE75	9,36 L/s	9,41 L/s	8,23 L/s	-	
DE50	5,93 L/s	6,18 L/s	4,26 L/s	-	
DE25	4,11 L/s	4,92 L/s	4,44 L/s	-	