



<b>Nom</b> KOLAMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1991	<b>Profession</b> ELINGUEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> TRUST AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 77	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

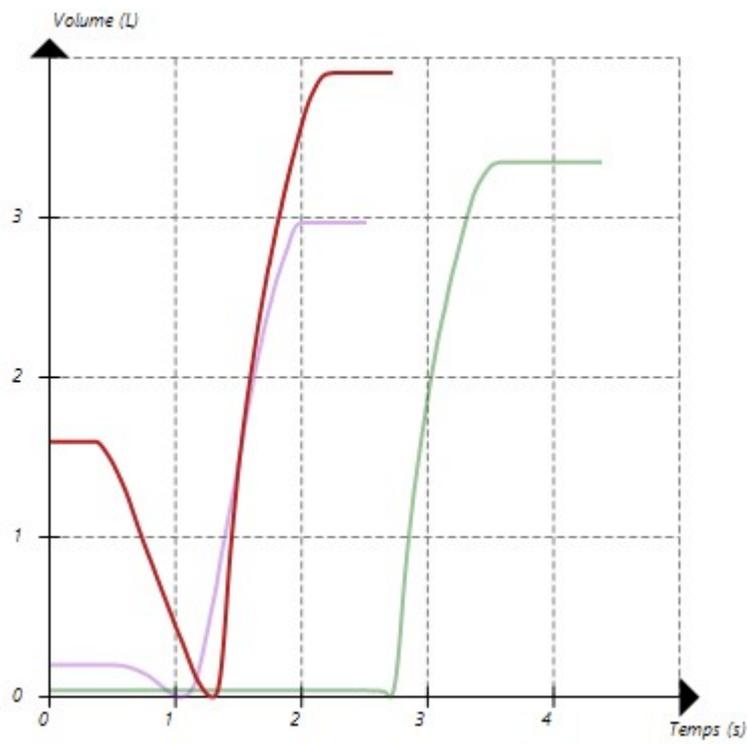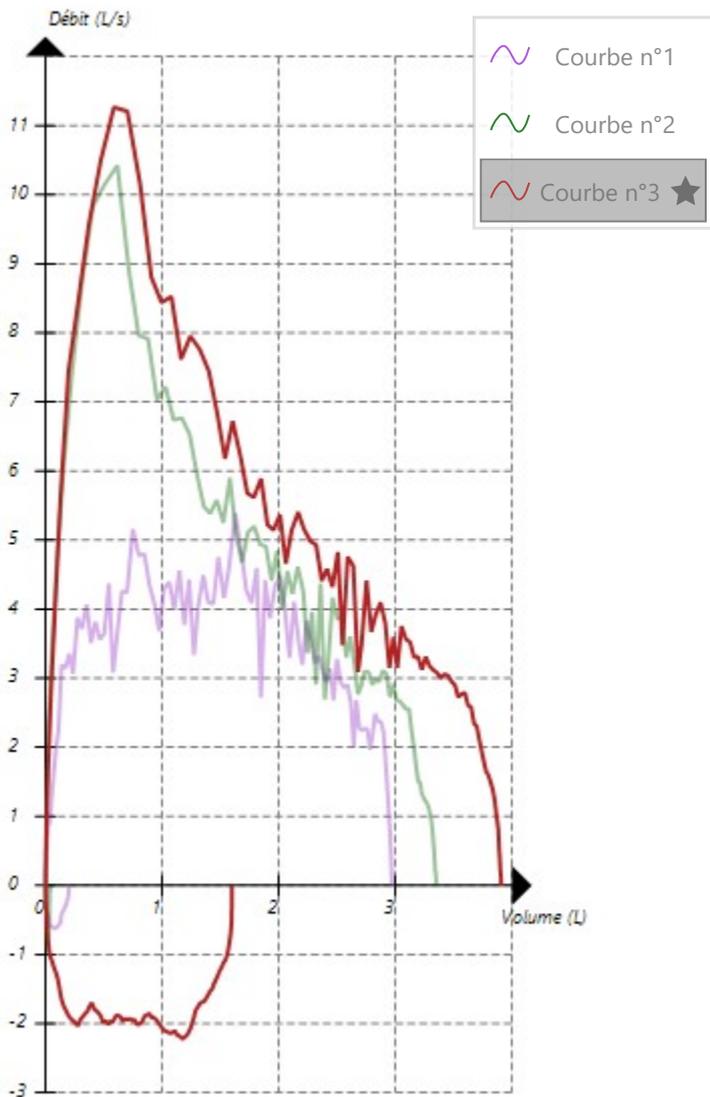

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,97 L	3,35 L	3,91 L	3,98 L	98,24 %
VEMS	2,97 L	3,35 L	3,91 L	3,32 L	117,77 %
DEP	6,04 L/s	10,91 L/s	11,52 L/s	8,64 L/s	133,33 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,02 %	120,45 %
Durée d'expiration	0,98 s	0,89 s	0,97 s	-	
DEMM	4,27 L/s	5,11 L/s	5,47 L/s	3,69 L/s	148,24 %
DEMM/ CVF	1,44 s-1	1,53 s-1	1,40 s-1	0,93 s-1	150,54 %
DE75	5,01 L/s	7,64 L/s	8,68 L/s	-	
DE50	4,92 L/s	4,41 L/s	5,28 L/s	-	
DE25	3,72 L/s	4,00 L/s	3,57 L/s	-	