


<b>Nom</b> BILIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DAVID	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1960	<b>Profession</b> TECHNICIEN
<b>Age</b> 64 Ans	<b>Entreprise</b> ENVIRO AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 16	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 69 %

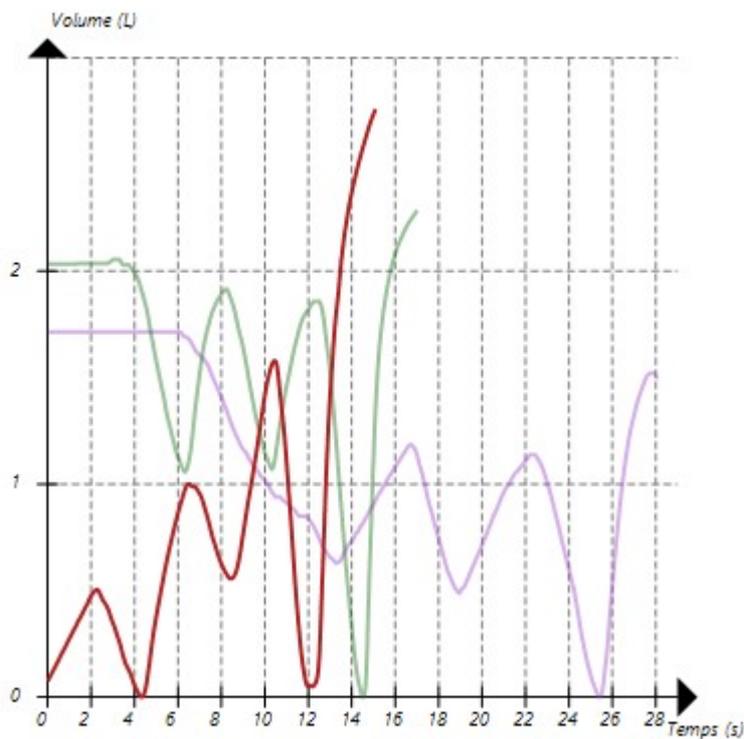

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,52 L	2,29 L	2,71 L	3,27 L	82,87 %
VEMS	1,10 L	1,93 L	1,95 L	2,50 L	78,00 %
DEP	1,38 L/s	3,50 L/s	3,00 L/s	7,15 L/s	41,96 %
VEMS/ CVF	72,37 %	84,28 %	71,96 %	77,54 %	92,80 %
Durée d'expiration	2,41 s	2,52 s	2,96 s	-	
DEMM	0,99 L/s	2,14 L/s	1,60 L/s	2,32 L/s	68,97 %
DEMM/ CVF	0,65 s-1	0,93 s-1	0,59 s-1	0,71 s-1	83,10 %
DE75	1,32 L/s	2,88 L/s	2,69 L/s	-	
DE50	0,99 L/s	2,69 L/s	1,37 L/s	-	
DE25	0,65 L/s	0,99 L/s	0,83 L/s	-	