

<b>Nom</b> GEGBELEMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BLAISE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/11/1990	<b>Profession</b> CHAUFFEUR
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> BEDROSS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 04	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 60 %

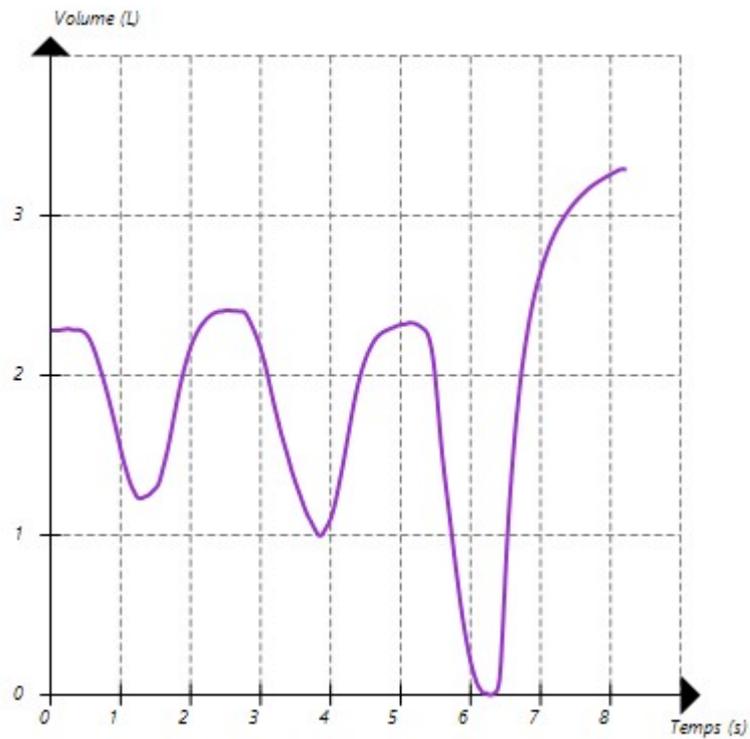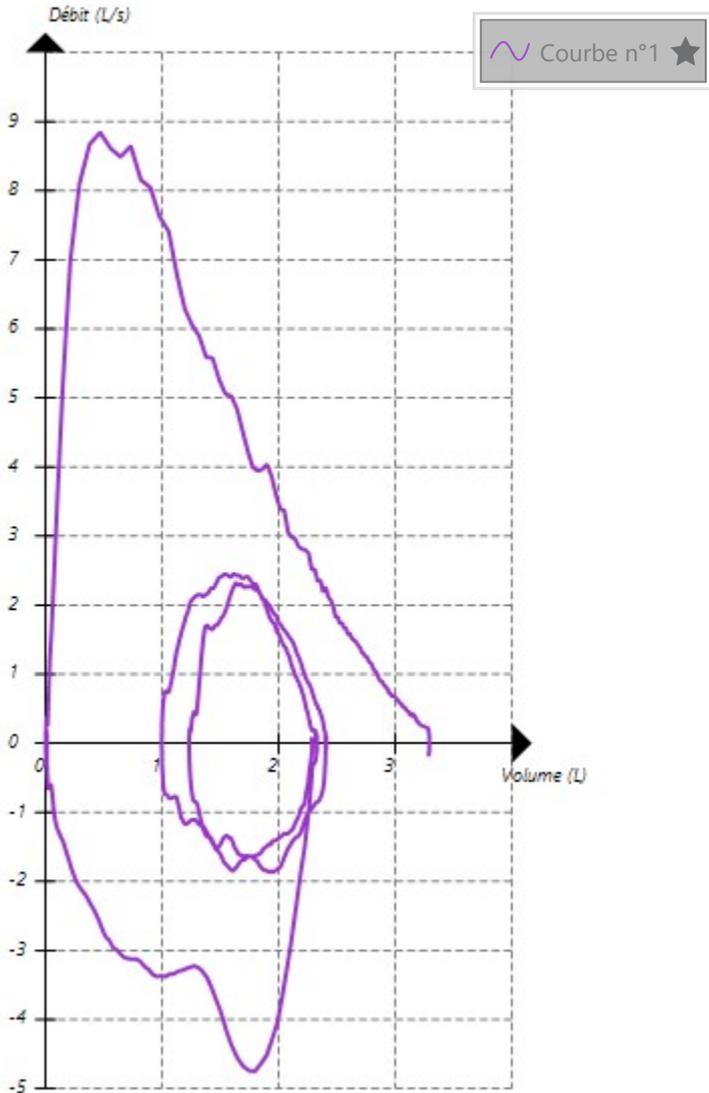

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,29 L	4,13 L	79,66 %
VEMS	3,04 L	3,41 L	89,15 %
DEP	9,05 L/s	8,52 L/s	106,22 %
VEMS/ CVF	92,40 %	81,25 %	113,72 %
Durée d'expiration	1,88 s	-	
DEMM	4,22 L/s	3,60 L/s	117,22 %
DEMM/ CVF	1,28 s-1	0,87 s-1	147,13 %
DE75	8,06 L/s	-	
DE50	4,94 L/s	-	
DE25	2,00 L/s	-	