



<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MOUCTAR</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 08/02/2002</b>	<b>Profession OPERATEUR</b>
<b>Age 22 Ans</b>	<b>Entreprise CHEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 138</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 183 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 67 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 71 %

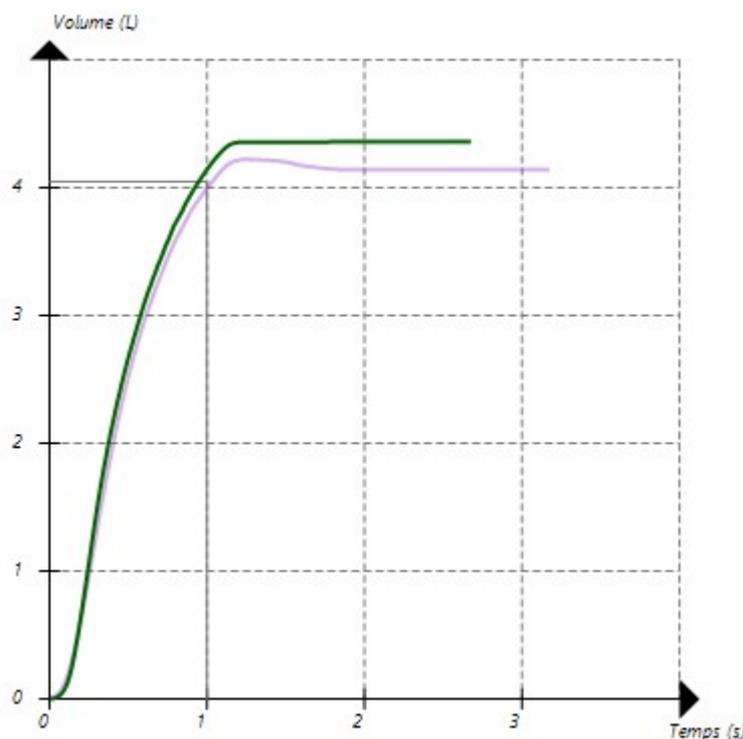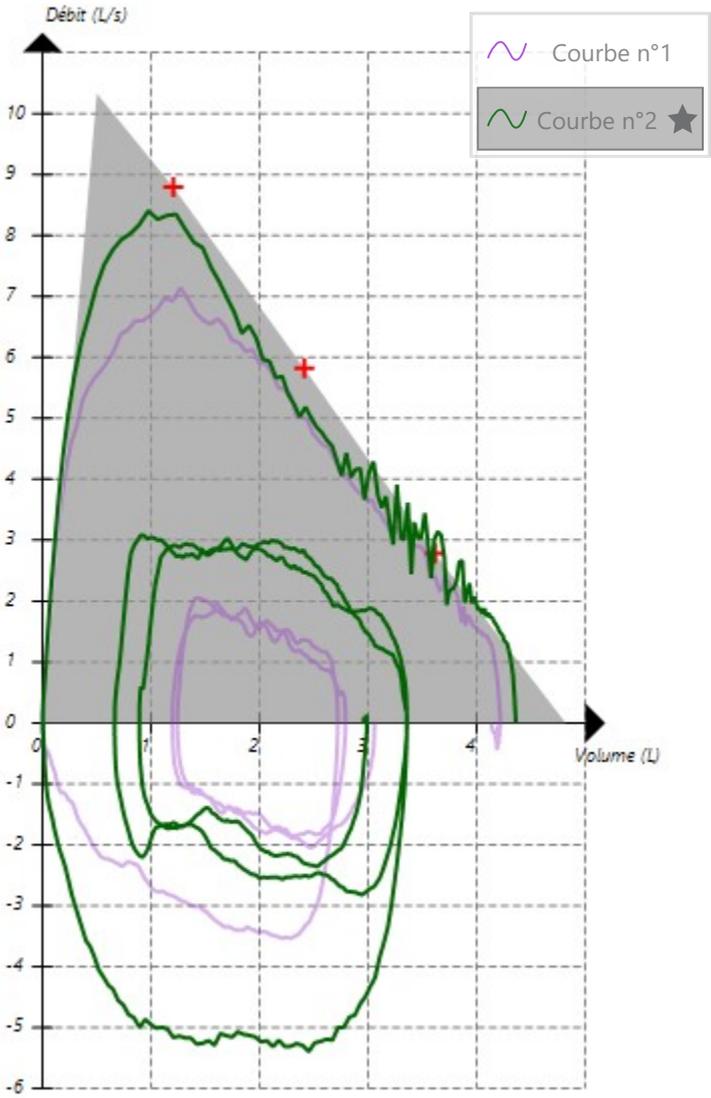

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,22 L	4,36 L	4,82 L	90,46 %
VEMS	4,16 L	4,32 L	4,05 L	106,67 %
DEP	7,19 L/s	8,58 L/s	10,33 L/s	83,06 %
VEMS/CVF	98,58 %	99,08 %	82,74 %	119,75 %
Durée d'expiration	1,29 s	1,83 s	-	
DEMM	5,32 L/s	5,49 L/s	5,18 L/s	105,98 %
DEMM/CVF	1,26 s-1	1,26 s-1	0,94 s-1	134,04 %
DE75	6,81 L/s	8,24 L/s	8,79 L/s	93,74 %
DE50	5,76 L/s	5,46 L/s	5,82 L/s	93,81 %
DE25	3,26 L/s	3,99 L/s	2,78 L/s	143,53 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: