

<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SAMBA DIOUMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 28/08/1983	<b>Profession</b> SOUDEUR
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 15	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 52 %

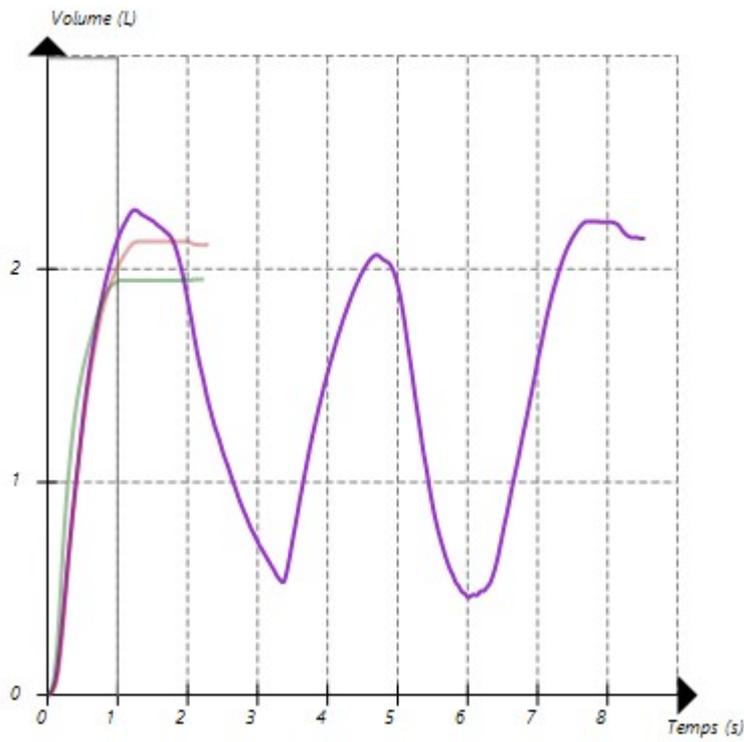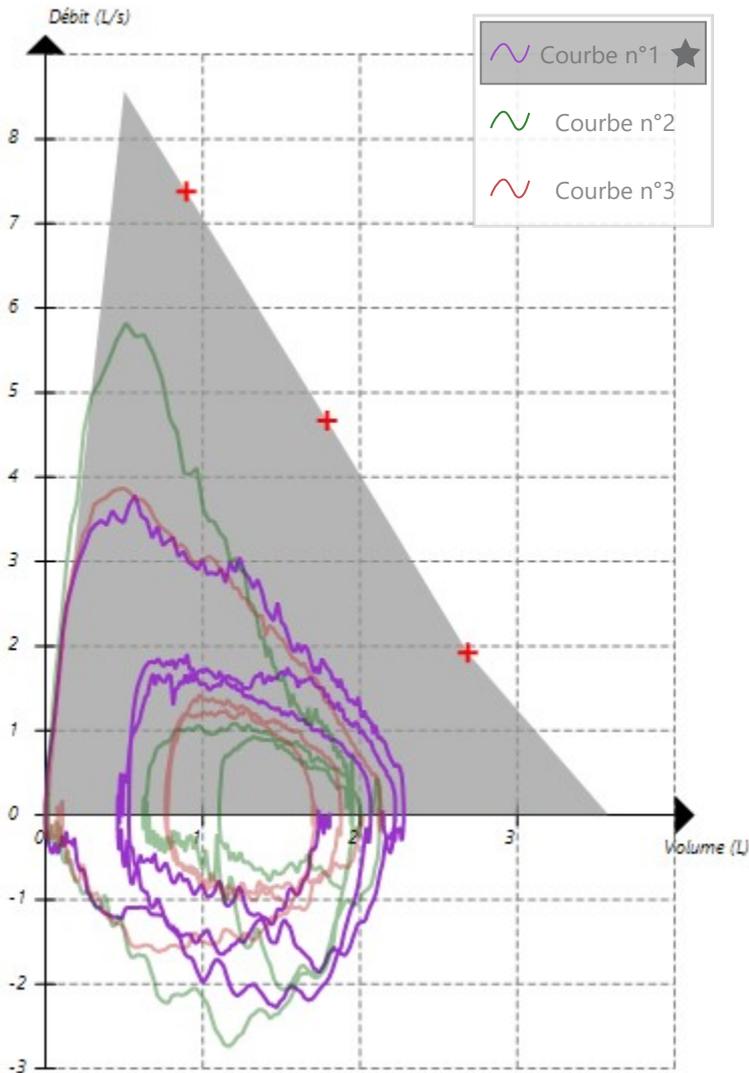

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,28 L	1,95 L	2,13 L	3,58 L	63,69 %
VEMS	2,22 L	1,95 L	2,09 L	2,99 L	74,25 %
DEP	3,87 L/s	5,99 L/s	3,97 L/s	8,57 L/s	45,16 %
VEMS/CVF	97,37 %	100,00 %	98,12 %	80,05 %	121,64 %
Durée d'expiration	1,28 s	1,02 s	1,32 s	-	
DEMM	2,76 L/s	3,53 L/s	2,81 L/s	4,19 L/s	65,87 %
DEMM/CVF	1,21 s-1	1,81 s-1	1,32 s-1	1,02 s-1	118,63 %
DE75	3,85 L/s	5,98 L/s	3,83 L/s	7,38 L/s	52,17 %
DE50	2,79 L/s	4,01 L/s	3,00 L/s	4,67 L/s	59,74 %
DE25	1,33 L/s	1,74 L/s	1,75 L/s	1,92 L/s	69,27 %