



<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MORLAYE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 09/03/1990</b>	<b>Profession FERRAILLEUR</b>
<b>Age 34 Ans</b>	<b>Entreprise CHEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 183</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 178 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 65 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 101,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 74 %

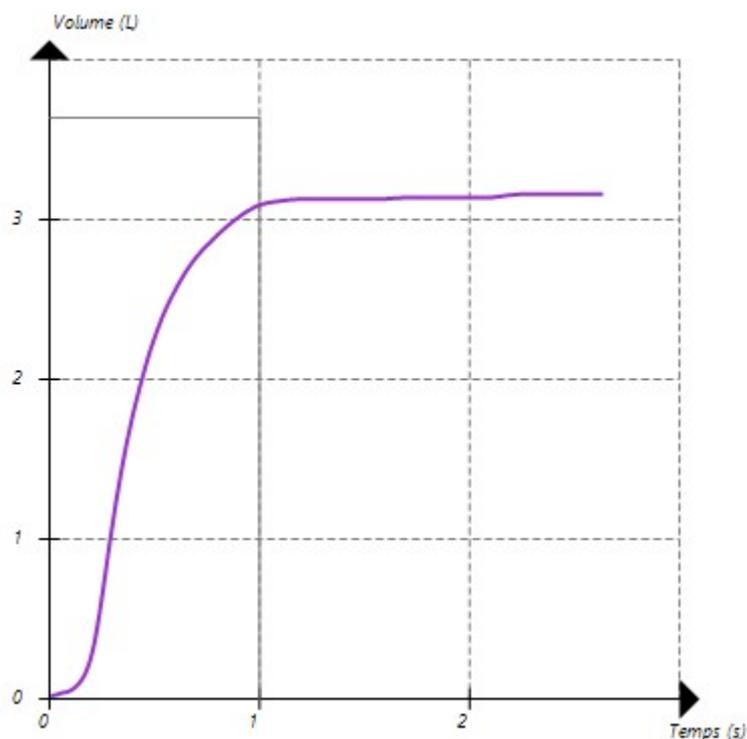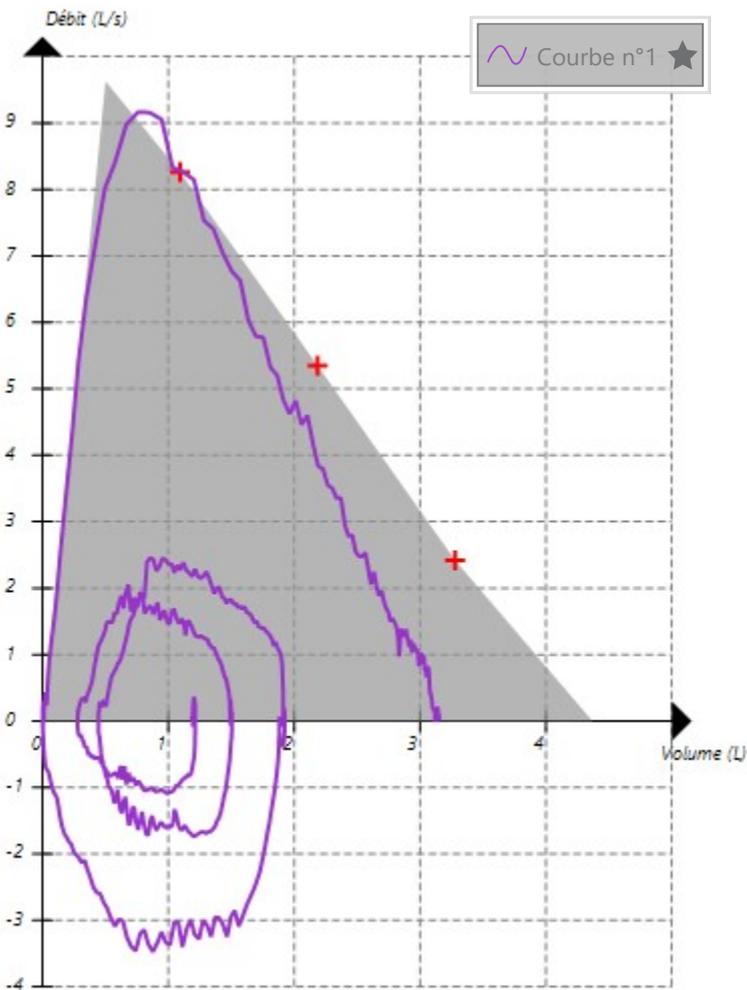

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,15 L	4,37 L	72,08 %
VEMS	3,12 L	3,64 L	85,71 %
DEP	9,30 L/s	9,63 L/s	96,57 %
VEMS/ CVF	99,05 %	81,12 %	122,10 %
Durée d'expiration	2,69 s	-	
DEMM	5,95 L/s	4,70 L/s	126,60 %
DEMM/ CVF	1,89 s-1	0,94 s-1	201,06 %
DE75	9,10 L/s	8,26 L/s	110,17 %
DE50	6,52 L/s	5,35 L/s	121,87 %
DE25	3,41 L/s	2,42 L/s	140,91 %