


|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nom CAMARA                     | Adresse                           |
| Prénom ALHASSANE               | Exposition                        |
| Né le 01/07/2000               | Profession MACON                  |
| Age 24 Ans                     | Entreprise CHEC                   |
| Genre Masculin                 | Service                           |
| ID 18                          | Fumeur Non fumeur                 |
| Taille 166 cm                  | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 60 kg                    | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur admin admin          |                                   |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                     | Température ambiante : 32,1 °C     |
| Numéro de série : 232697                                     | Pression atmosphérique : 100,9 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 | Humidité : 67 %                    |

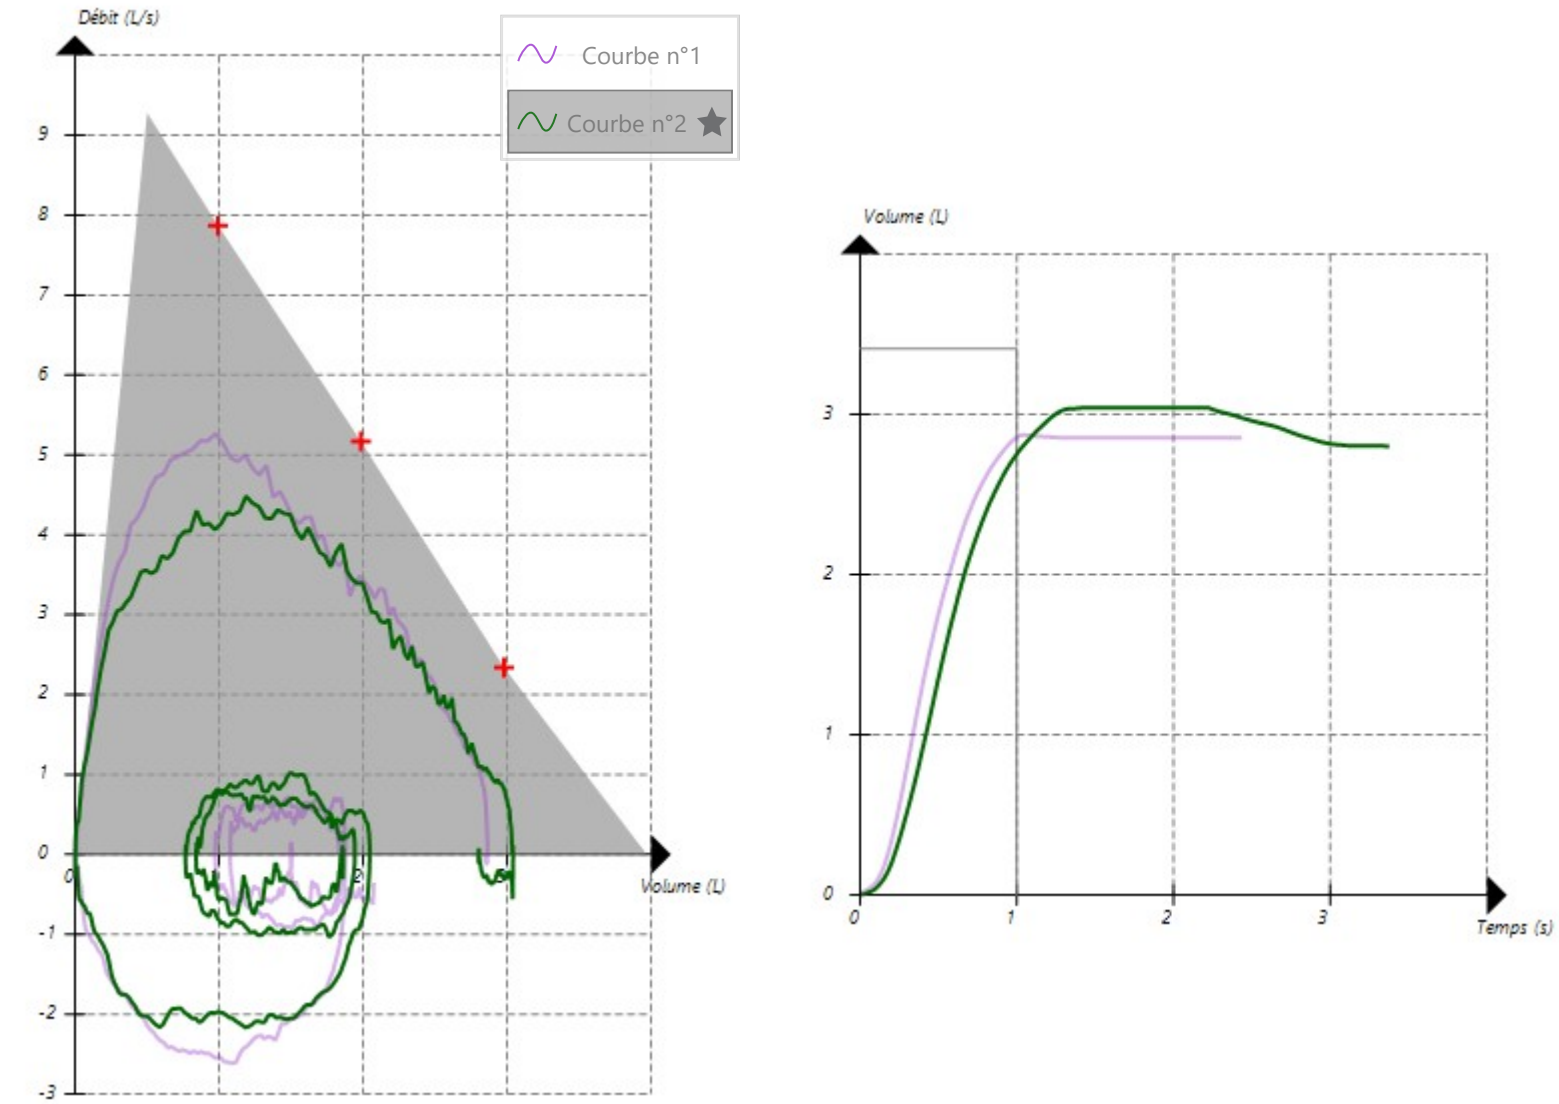

| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 2,86 L     | 3,04 L               | 3,97 L   | 76,57 %   |
| VEMS               | 2,86 L     | 2,96 L               | 3,41 L   | 86,80 %   |
| DEP                | 5,30 L/s   | 4,57 L/s             | 9,28 L/s | 49,25 %   |
| VEMS/CVF           | 100,00 %   | 97,37 %              | 82,74 %  | 117,68 %  |
| Durée d'expiration | 1,11 s     | 2,27 s               | -        |           |
| DEMM               | 4,34 L/s   | 3,83 L/s             | 4,85 L/s | 78,97 %   |
| DEMM/CVF           | 1,52 s-1   | 1,26 s-1             | 1,06 s-1 | 118,87 %  |
| DE75               | 4,97 L/s   | 4,10 L/s             | 7,87 L/s | 52,10 %   |
| DE50               | 4,40 L/s   | 4,11 L/s             | 5,17 L/s | 79,50 %   |
| DE25               | 3,44 L/s   | 2,51 L/s             | 2,34 L/s | 107,26 %  |