



<b>Nom</b> MANSARAY	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FODE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/02/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 141	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 71 %

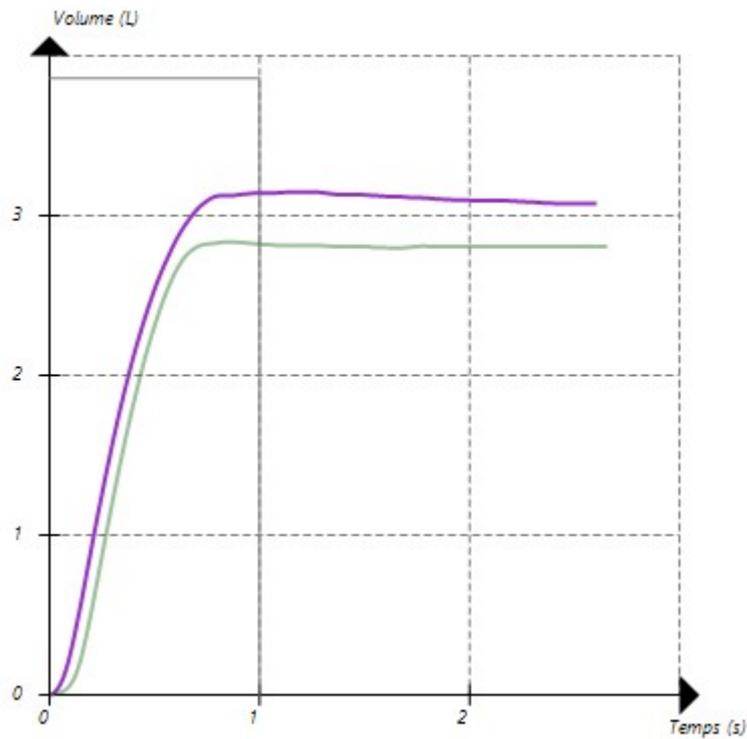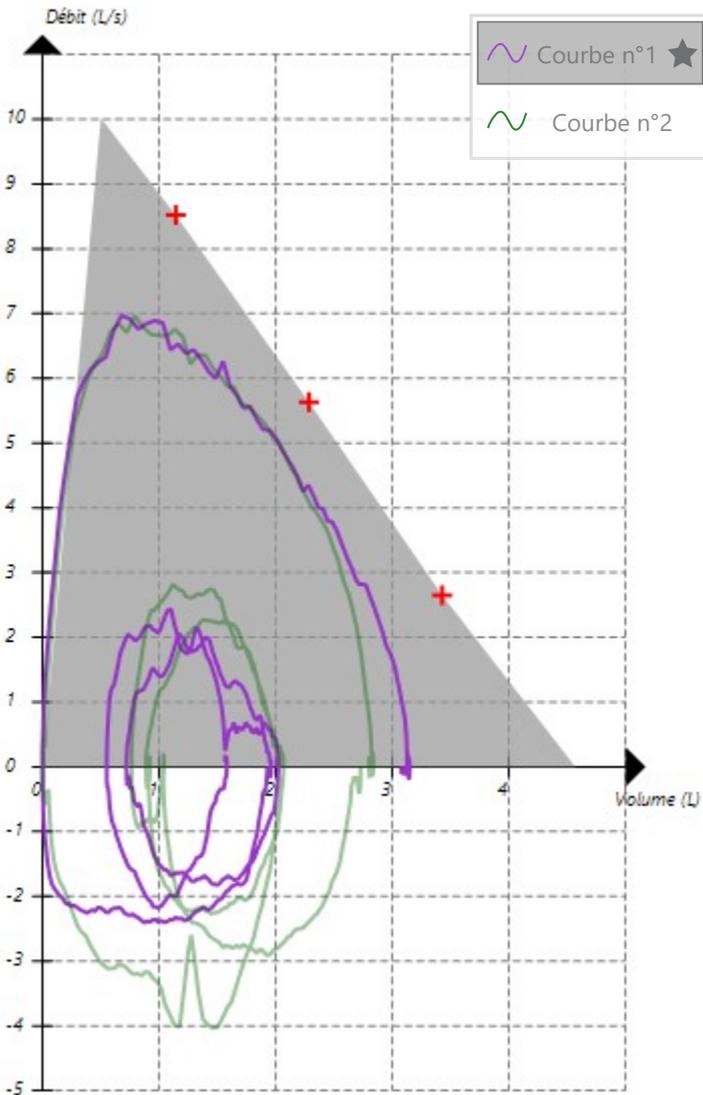

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,15 L	2,84 L	4,57 L	68,93 %
VEMS	3,14 L	2,84 L	3,86 L	81,35 %
DEP	7,12 L/s	7,18 L/s	10,02 L/s	71,06 %
VEMS/ CVF	99,68 %	100,00 %	82,74 %	120,47 %
Durée d'expiration	1,15 s	0,84 s	-	
DEMM	5,75 L/s	6,11 L/s	5,08 L/s	113,19 %
DEMM/ CVF	1,83 s-1	2,15 s-1	0,97 s-1	188,66 %
DE75	6,79 L/s	6,69 L/s	8,52 L/s	79,69 %
DE50	6,23 L/s	6,17 L/s	5,63 L/s	110,66 %
DE25	3,94 L/s	4,50 L/s	2,65 L/s	148,68 %