

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUMAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 233	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 32,8 °C  
 Pression atmosphérique : 101,2 kPa  
 Humidité : 78 %

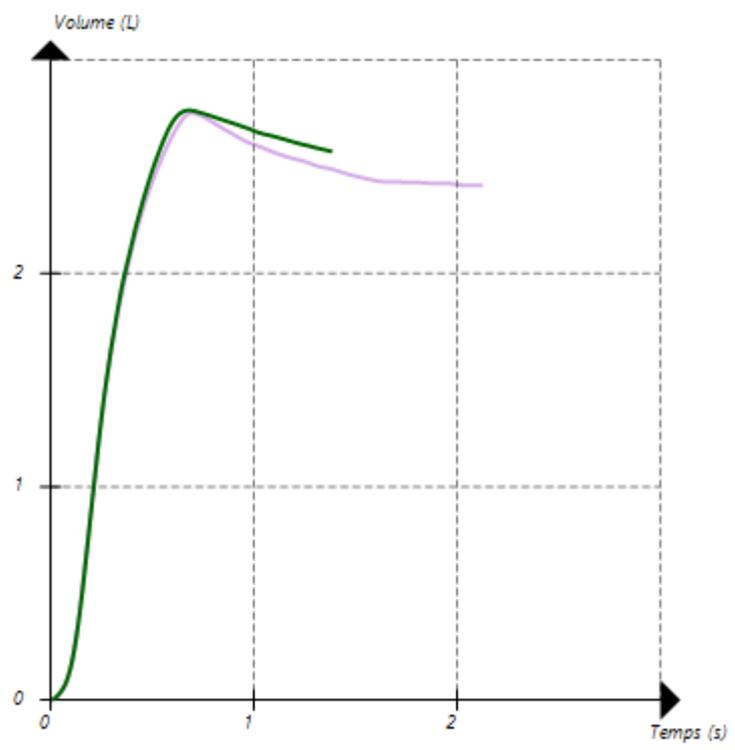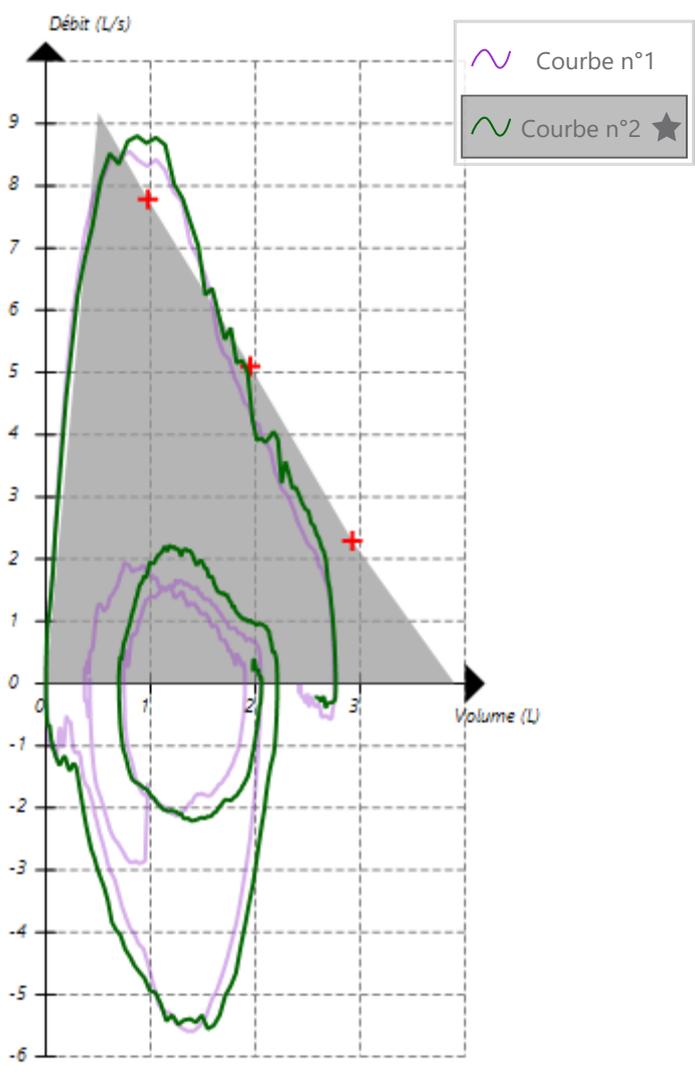

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,75 L	2,76 L	3,90 L	70,77 %
VEMS	2,75 L	2,76 L	3,35 L	82,39 %
DÉP	8,63 L/s	8,97 L/s	9,18 L/s	97,71 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,56 %	121,12 %
Durée d'expiration	0,70 s	0,68 s	-	
DEMM	6,52 L/s	6,74 L/s	4,79 L/s	140,71 %
DEMM/ CVF	2,37 s <sup>-1</sup>	2,44 s <sup>-1</sup>	1,07 s <sup>-1</sup>	228,04 %
DE75	8,40 L/s	8,43 L/s	7,78 L/s	108,35 %
DE50	7,14 L/s	7,45 L/s	5,10 L/s	146,08 %
DE25	3,94 L/s	3,52 L/s	2,29 L/s	153,71 %