

<b>Nom BAH</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom SOULEYMANE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/2002</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 22 Ans</b>	<b>Entreprise CHEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 05</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 170 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 49 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 101,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 66 %

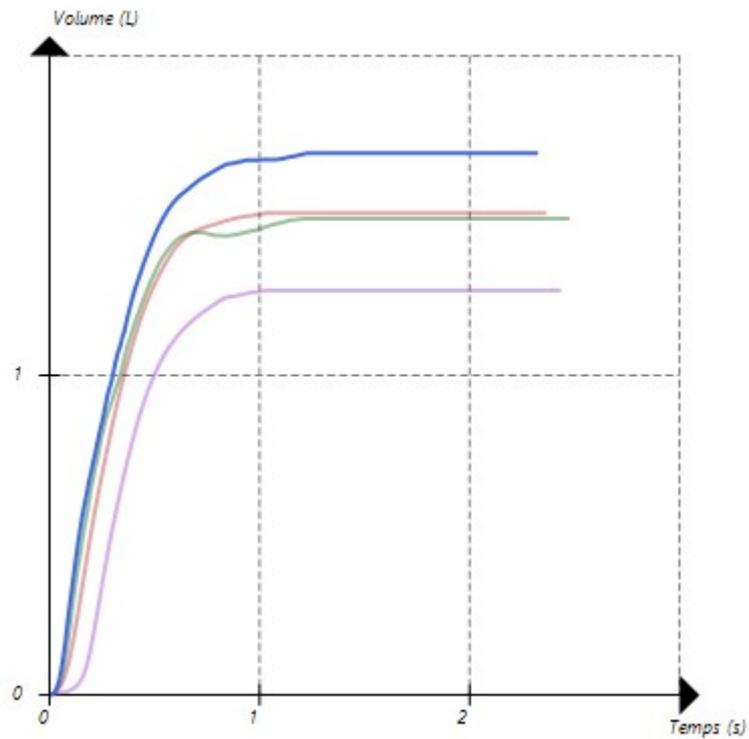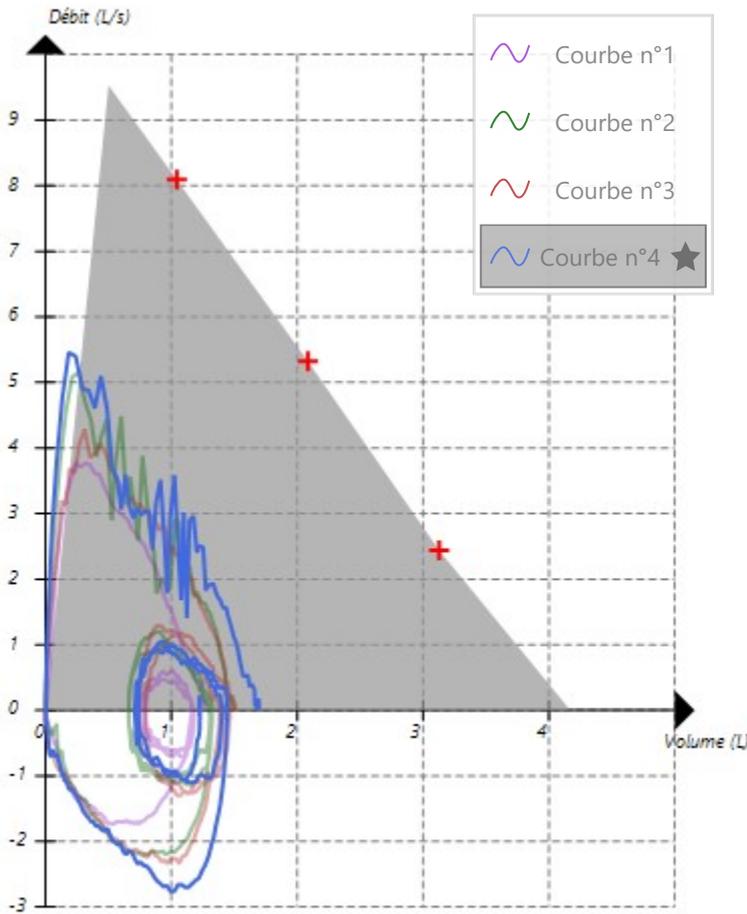

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,27 L	1,45 L	1,51 L	1,70 L	4,17 L	40,77 %
VEMS	1,27 L	1,45 L	1,51 L	1,68 L	3,56 L	47,19 %
DEP	3,86 L/s	5,25 L/s	4,75 L/s	5,63 L/s	9,53 L/s	59,08 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,82 %	82,74 %	119,43 %
Durée d'expiration	1,19 s	0,69 s	1,05 s	1,26 s	-	
DEMM	2,82 L/s	2,99 L/s	3,07 L/s	3,00 L/s	4,93 L/s	60,85 %
DEMM/ CVF	2,22 s-1	2,06 s-1	2,03 s-1	1,76 s-1	1,03 s-1	170,87 %
DE75	3,77 L/s	4,42 L/s	4,22 L/s	5,33 L/s	8,09 L/s	65,88 %
DE50	2,95 L/s	2,78 L/s	3,14 L/s	2,28 L/s	5,32 L/s	42,86 %
DE25	1,75 L/s	2,63 L/s	2,03 L/s	1,69 L/s	2,44 L/s	69,26 %