



<b>Nom</b> KAMANO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JEAN PIERRE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/03/2000	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 90	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 72 %

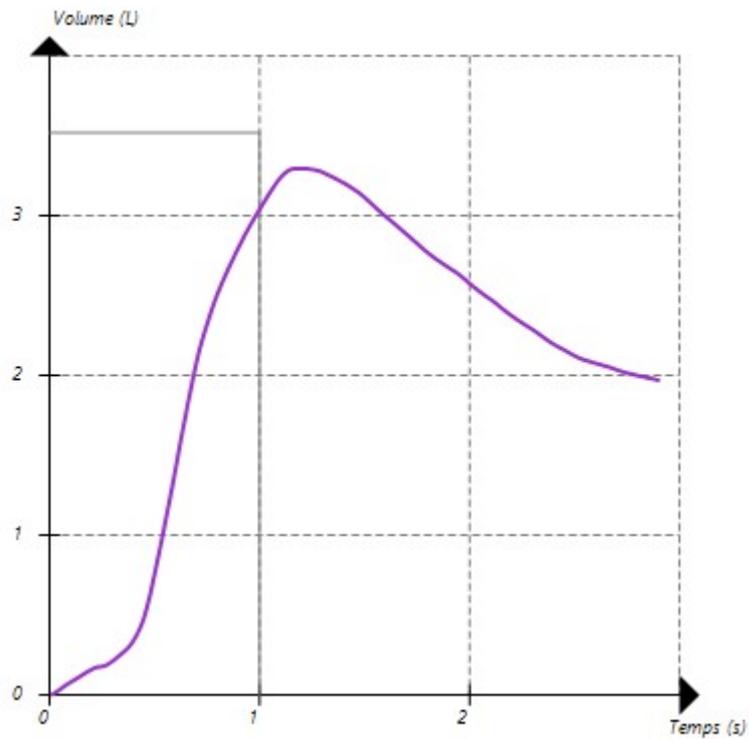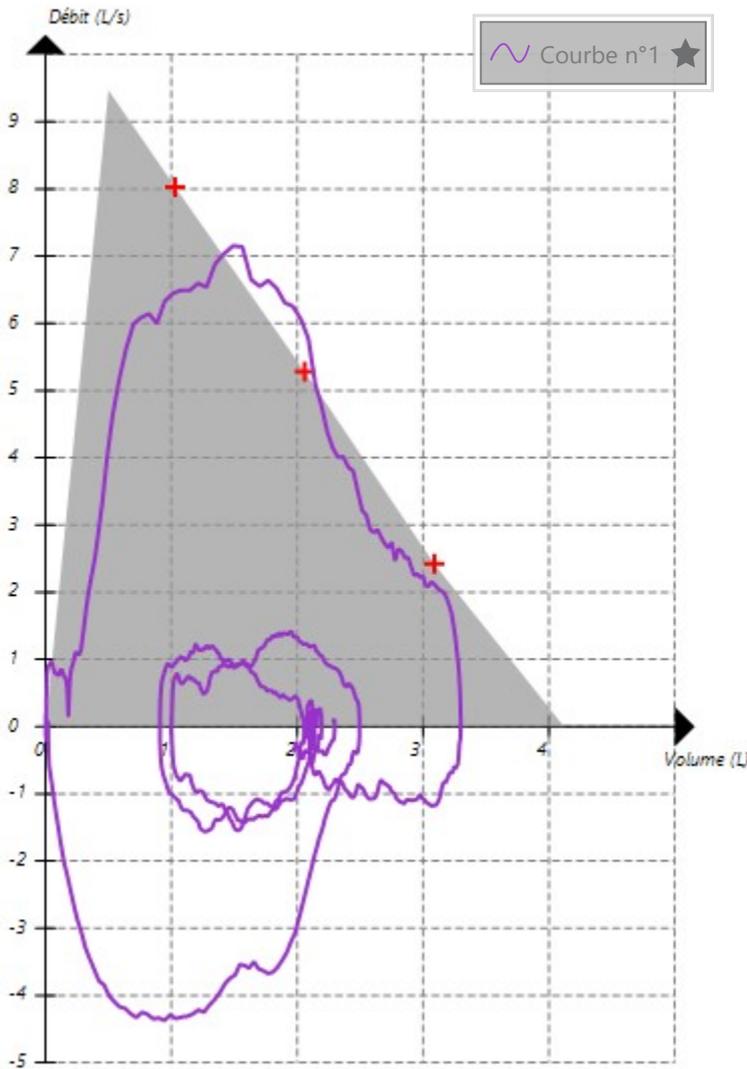

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,30 L	4,12 L	80,10 %
VEMS	3,30 L	3,52 L	93,75 %
DEP	7,38 L/s	9,47 L/s	77,93 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,18 s	-	
DEMM	5,95 L/s	4,91 L/s	121,18 %
DEMM/ CVF	1,80 s-1	1,04 s-1	173,08 %
DE75	6,17 L/s	8,03 L/s	76,84 %
DE50	6,80 L/s	5,28 L/s	128,79 %
DE25	3,42 L/s	2,42 L/s	141,32 %