



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADOUBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 46	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,7 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

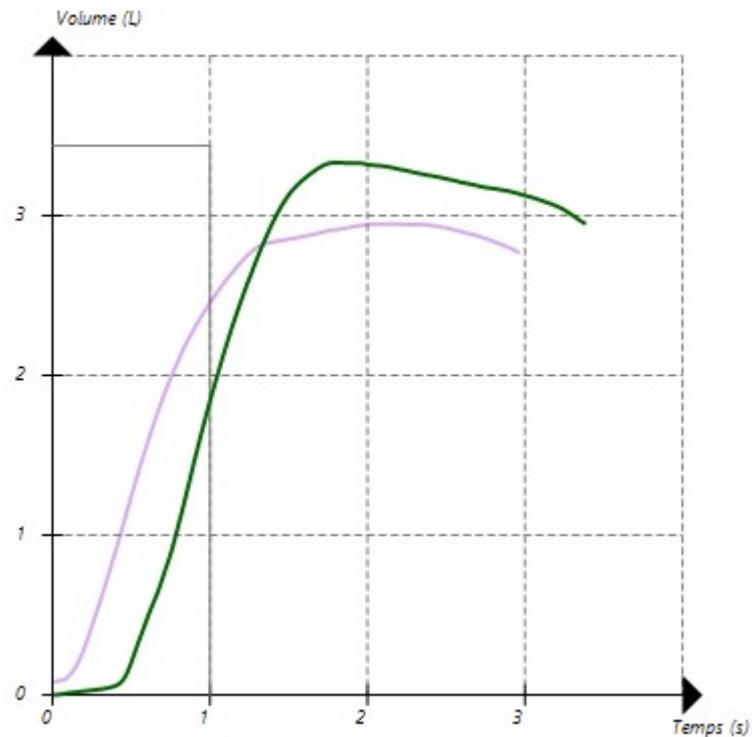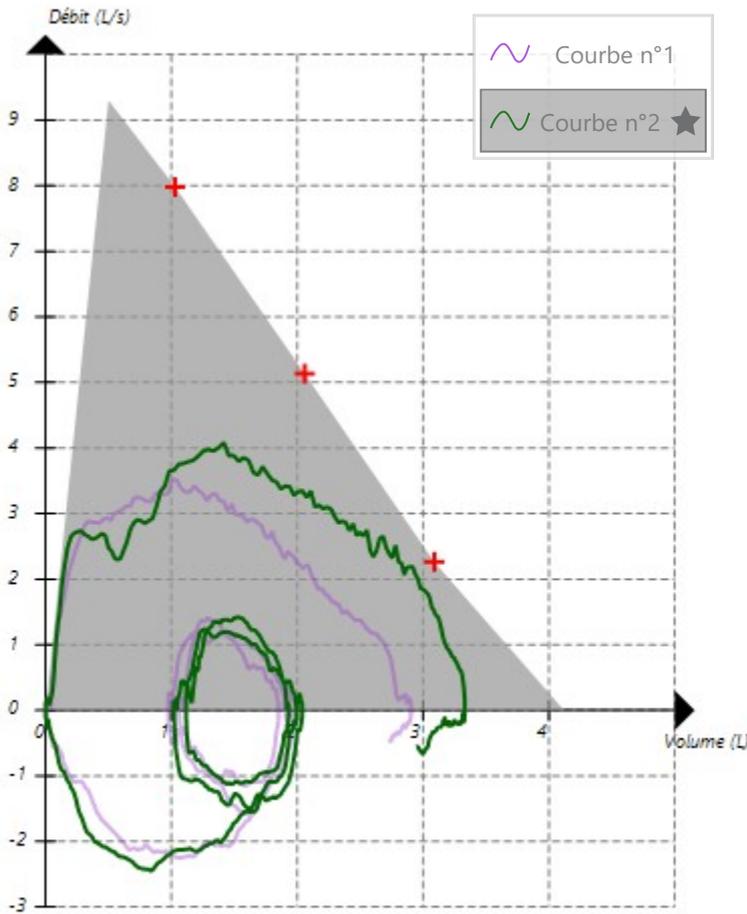

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,91 L	3,33 L	4,12 L	80,83 %
VEMS	2,61 L	3,18 L	3,44 L	92,44 %
DEP	3,54 L/s	4,15 L/s	9,30 L/s	44,62 %
VEMS/ CVF	89,69 %	95,50 %	80,77 %	118,24 %
Durée d'expiration	2,80 s	1,82 s	-	
DEMM	2,91 L/s	3,51 L/s	4,53 L/s	77,48 %
DEMM/ CVF	1,00 s-1	1,05 s-1	0,96 s-1	109,38 %
DE75	3,29 L/s	2,92 L/s	7,98 L/s	36,59 %
DE50	3,01 L/s	3,51 L/s	5,13 L/s	68,42 %
DE25	1,86 L/s	2,62 L/s	2,26 L/s	115,93 %