

<b>Nom</b> SAGNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ANDRE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1977	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 47 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 279	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 30 °C  
 Pression atmosphérique : 101,3 kPa  
 Humidité : 82 %

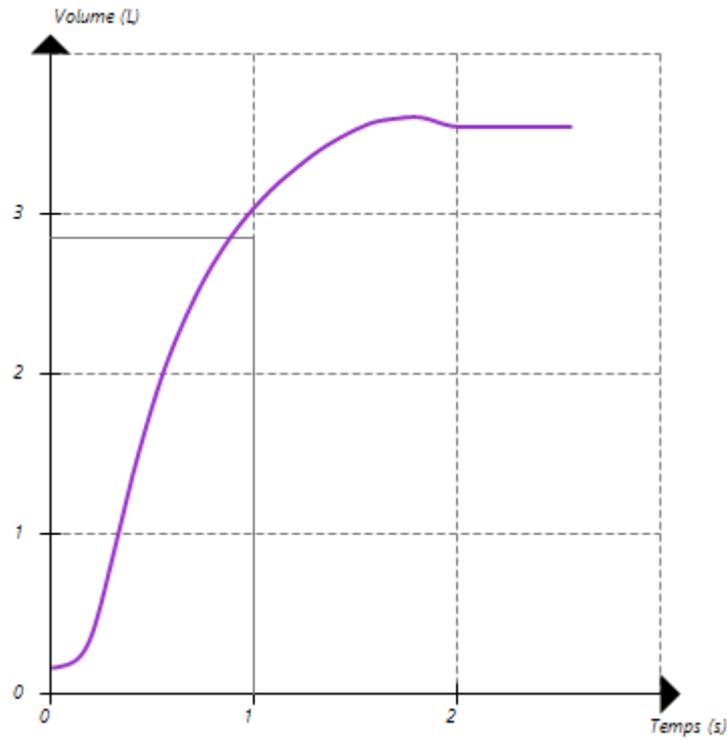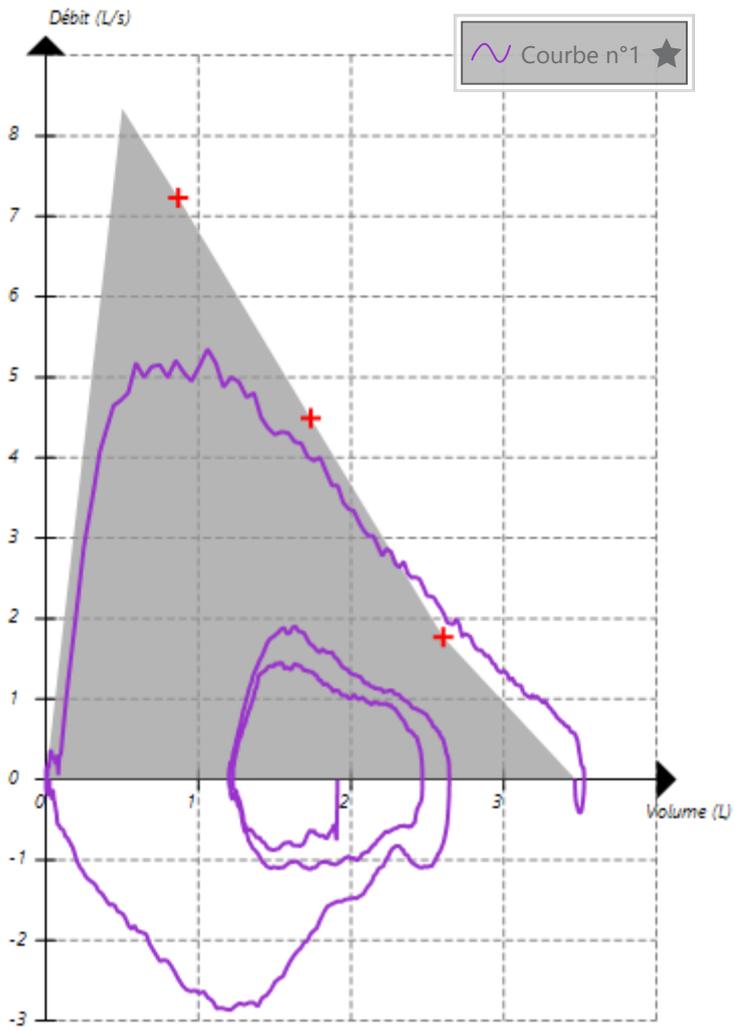

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,53 L	3,47 L	101,73 %
VEMS	3,15 L	2,85 L	110,53 %
DÉP	5,53 L/s	8,34 L/s	66,31 %
VEMS/CVF	89,24 %	78,80 %	113,25 %
Durée d'expiration	2,19 s	-	
DEMM	3,58 L/s	3,91 L/s	91,56 %
DEMM/CVF	1,01 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	103,06 %
DE75	5,09 L/s	7,23 L/s	70,40 %
DE50	3,92 L/s	4,49 L/s	87,31 %
DE25	2,00 L/s	1,77 L/s	112,99 %