



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA SORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 35	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

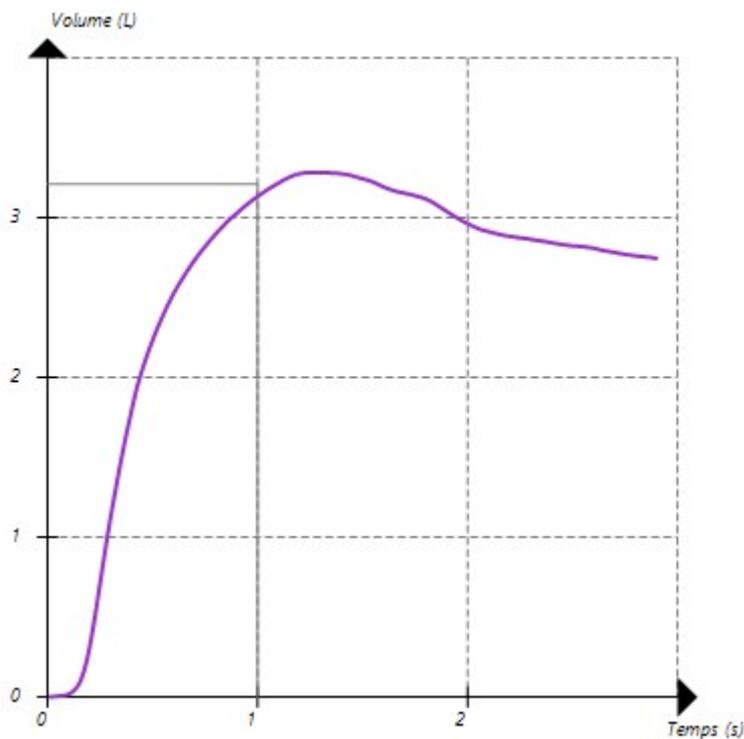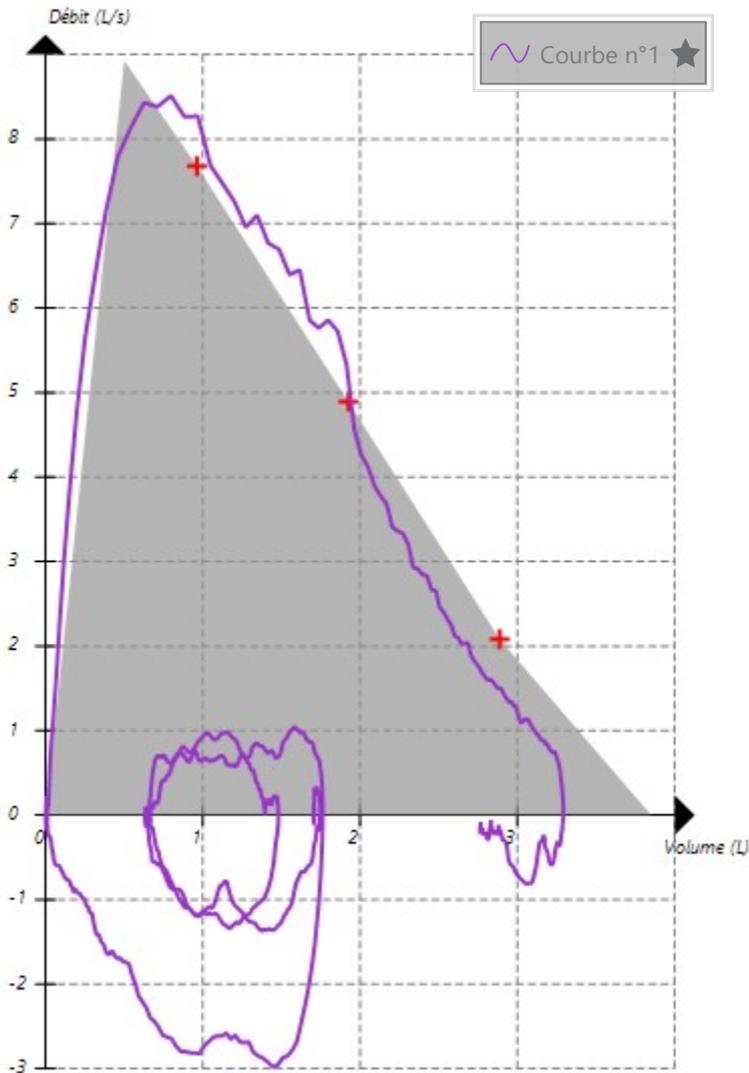

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,28 L	3,85 L	85,19 %
VEMS	3,26 L	3,21 L	101,56 %
DEP	8,57 L/s	8,93 L/s	95,97 %
VEMS/ CVF	99,39 %	80,23 %	123,88 %
Durée d'expiration	1,25 s	-	
DEMM	5,24 L/s	4,33 L/s	121,02 %
DEMM/ CVF	1,60 s-1	0,98 s-1	163,27 %
DE75	8,47 L/s	7,68 L/s	110,29 %
DE50	6,21 L/s	4,89 L/s	126,99 %
DE25	2,68 L/s	2,08 L/s	128,85 %