

<b>Nom</b> SAVANE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEYDOUBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1997	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 217	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 32,6 °C  
 Pression atmosphérique : 101,3 kPa  
 Humidité : 77 %

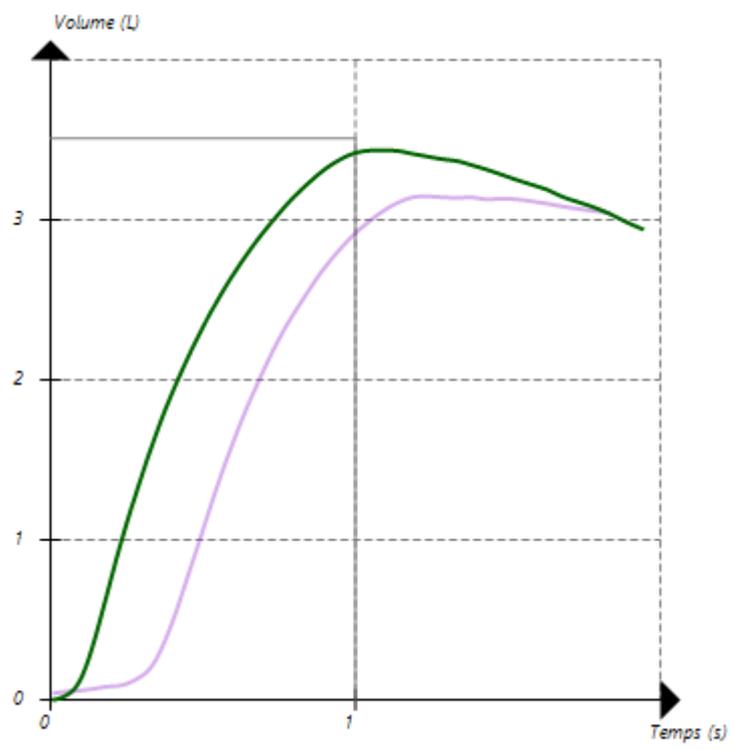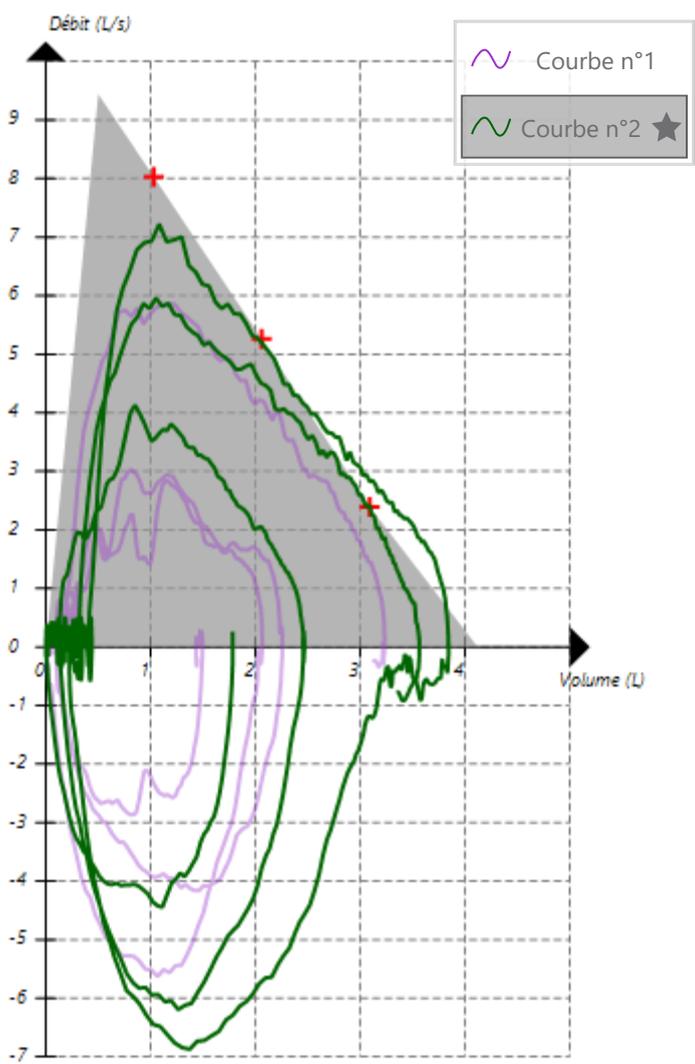

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,13 L	3,44 L	4,12 L	83,50 %
VEMS	3,13 L	3,44 L	3,51 L	98,01 %
DÉP	6,06 L/s	7,43 L/s	9,44 L/s	78,71 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,38 %	121,39 %
Durée d'expiration	1,33 s	1,11 s	-	
DEMM	4,78 L/s	4,79 L/s	4,84 L/s	98,97 %
DEMM/ CVF	1,53 s-1	1,39 s-1	1,02 s-1	136,27 %
DE75	5,76 L/s	7,08 L/s	8,03 L/s	88,17 %
DE50	4,89 L/s	5,08 L/s	5,26 L/s	96,58 %
DE25	3,02 L/s	3,05 L/s	2,39 L/s	127,62 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: