



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOUL AZIZ	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> SOUDEUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 127	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 98 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 70 %

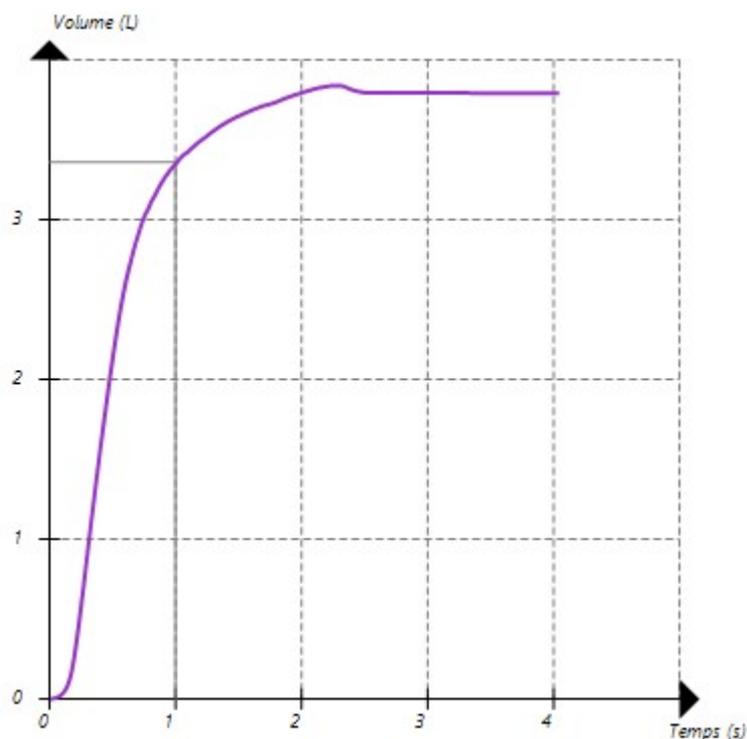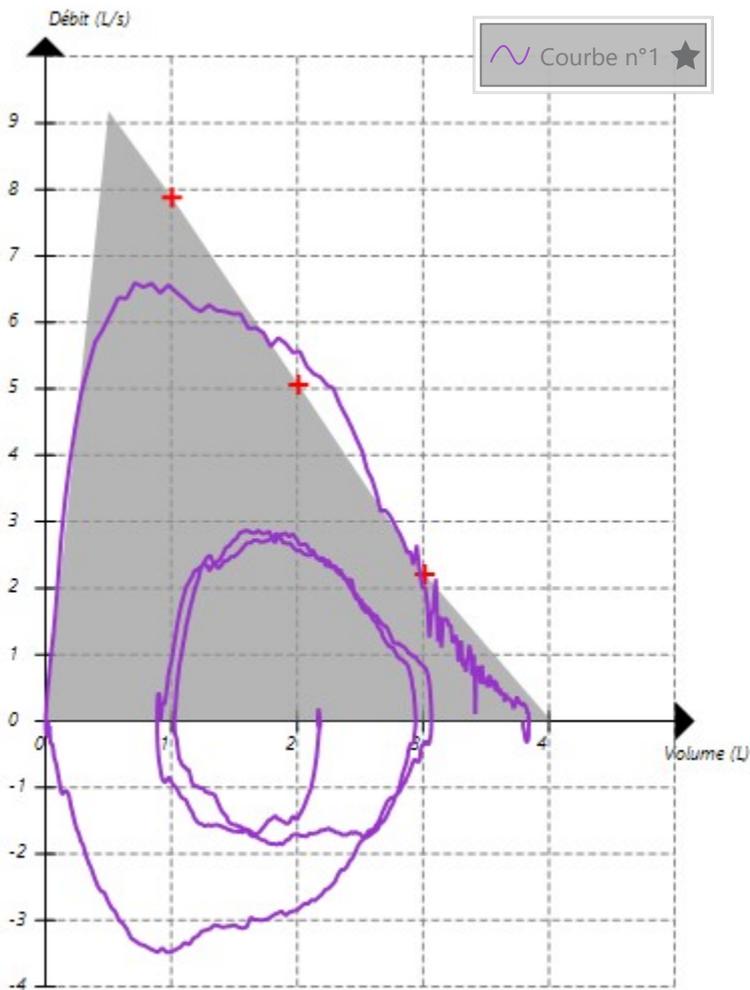

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,84 L	4,02 L	95,52 %
VEMS	3,47 L	3,36 L	103,27 %
DEP	6,67 L/s	9,18 L/s	72,66 %
VEMS/ CVF	90,36 %	80,77 %	111,87 %
Durée d'expiration	2,30 s	-	
DEMM	4,99 L/s	4,49 L/s	111,14 %
DEMM/ CVF	1,30 s-1	0,97 s-1	134,02 %
DE75	6,53 L/s	7,88 L/s	82,87 %
DE50	5,66 L/s	5,06 L/s	111,86 %
DE25	2,62 L/s	2,21 L/s	118,55 %