

<b>Nom</b> DORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ERNEST	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/02/1980	<b>Profession</b> MACON
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 330	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 47 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 3
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 32,5 °C  
 Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Humidité : 70 %

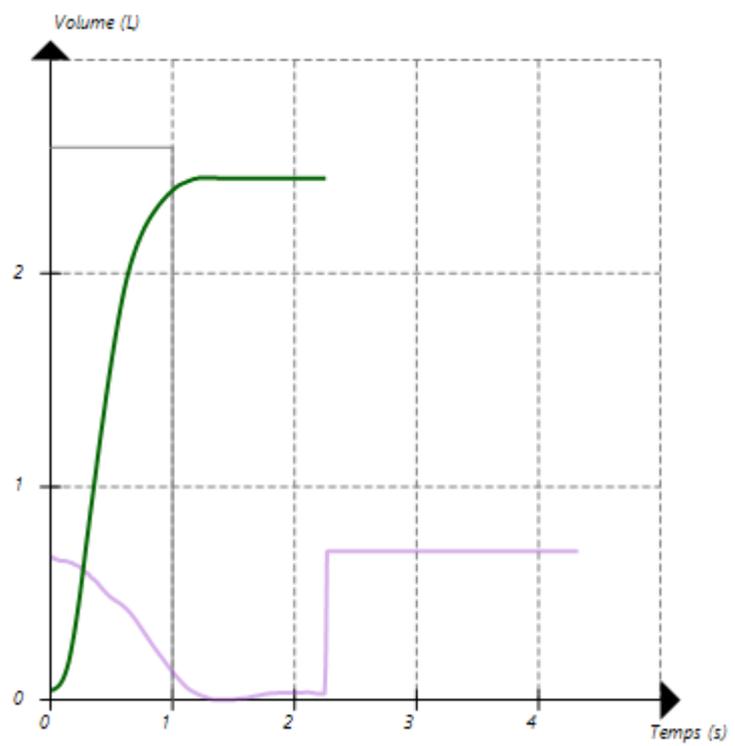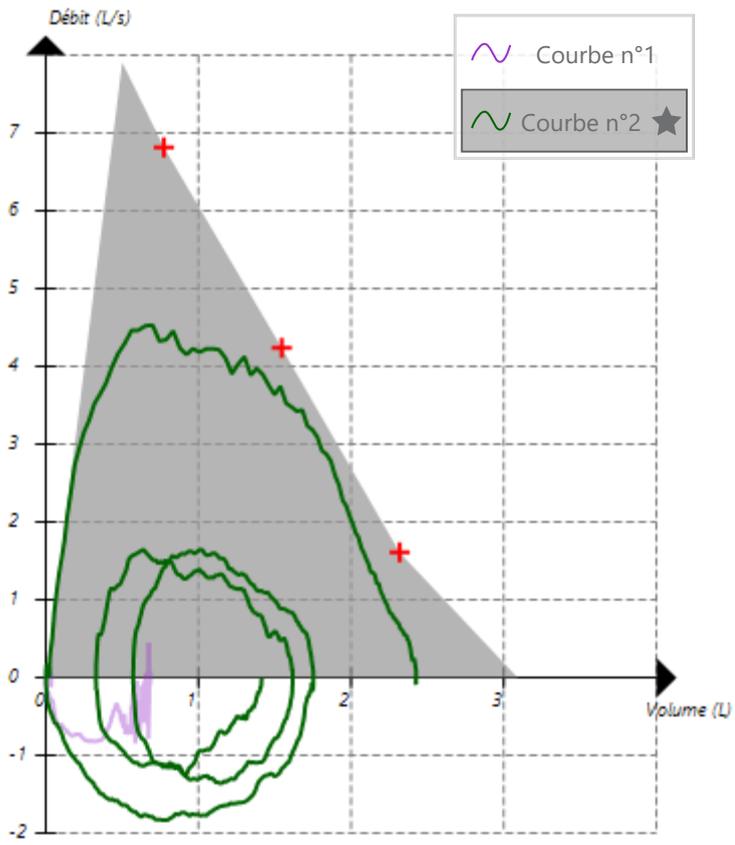

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,01 L	2,43 L	3,09 L	78,64 %
VEMS	0,01 L	2,41 L	2,59 L	93,05 %
DÉP	0,90 L/s	4,58 L/s	7,91 L/s	57,90 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,18 %	79,33 %	125,02 %
Durée d'expiration	0,01 s	1,50 s	-	
DEMM	0,72 L/s	3,99 L/s	3,86 L/s	103,37 %
DEMM/CVF	72,00 s-1	1,64 s-1	1,09 s-1	150,46 %
DE75	0,38 L/s	4,50 L/s	6,82 L/s	65,98 %
DE50	0,88 L/s	3,93 L/s	4,24 L/s	92,69 %
DE25	0,90 L/s	2,91 L/s	1,61 L/s	180,75 %