



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/04/1991	<b>Profession</b> FERAILLEUR
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 105	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 2
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 69 %

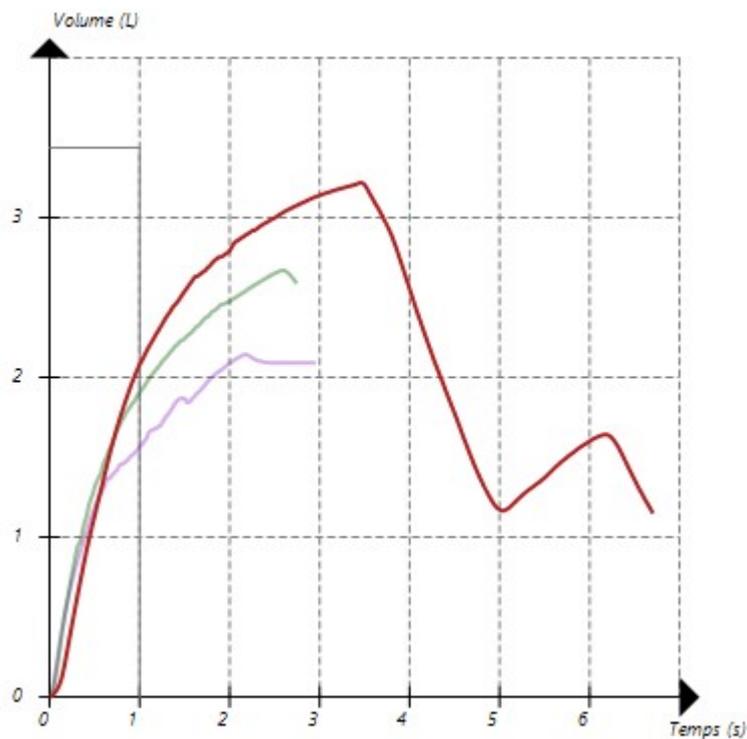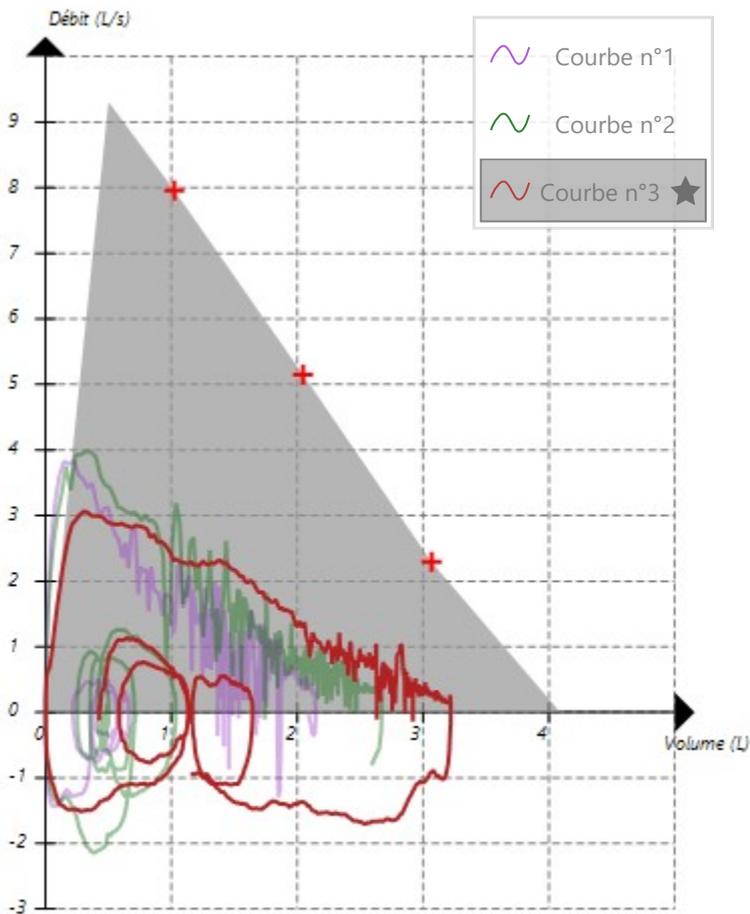

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,14 L	2,67 L	3,22 L	4,09 L	78,73 %
VEMS	1,57 L	1,93 L	2,19 L	3,44 L	63,66 %
DEP	3,90 L/s	4,14 L/s	3,07 L/s	9,31 L/s	32,98 %
VEMS/CVF	73,36 %	72,28 %	68,01 %	81,30 %	83,65 %
Durée d'expiration	2,17 s	2,58 s	3,46 s	-	
DEMM	1,20 L/s	1,48 L/s	1,65 L/s	4,62 L/s	35,71 %
DEMM/CVF	0,56 s-1	0,55 s-1	0,51 s-1	0,98 s-1	52,04 %
DE75	2,47 L/s	3,07 L/s	2,83 L/s	7,96 L/s	35,55 %
DE50	2,84 L/s	1,58 L/s	1,99 L/s	5,15 L/s	38,64 %
DE25	0,94 L/s	0,88 L/s	1,10 L/s	2,29 L/s	48,03 %