

<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom ABOUBACAR</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 05/05/1992</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 32 Ans</b>	<b>Entreprise CHEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 12</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 165 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 88 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 101,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 67 %

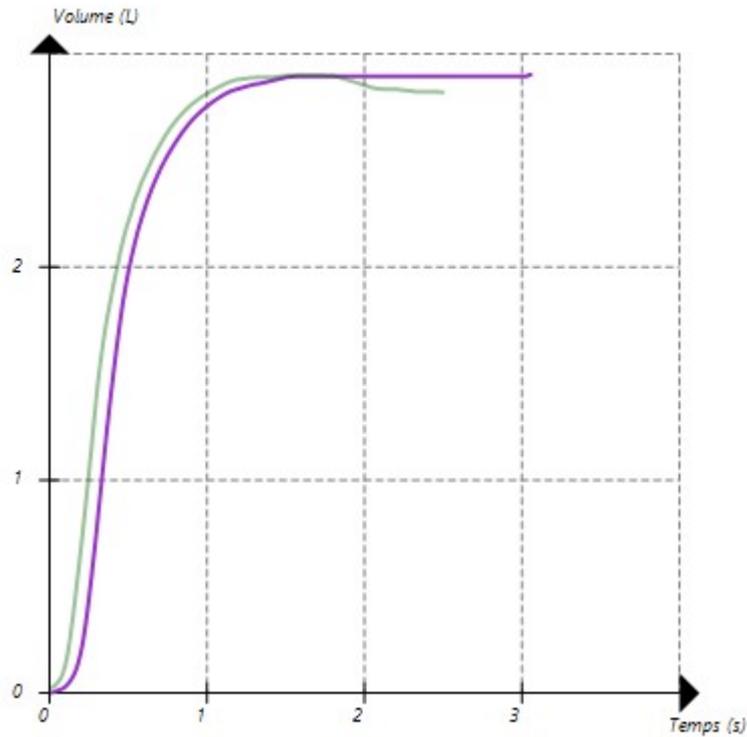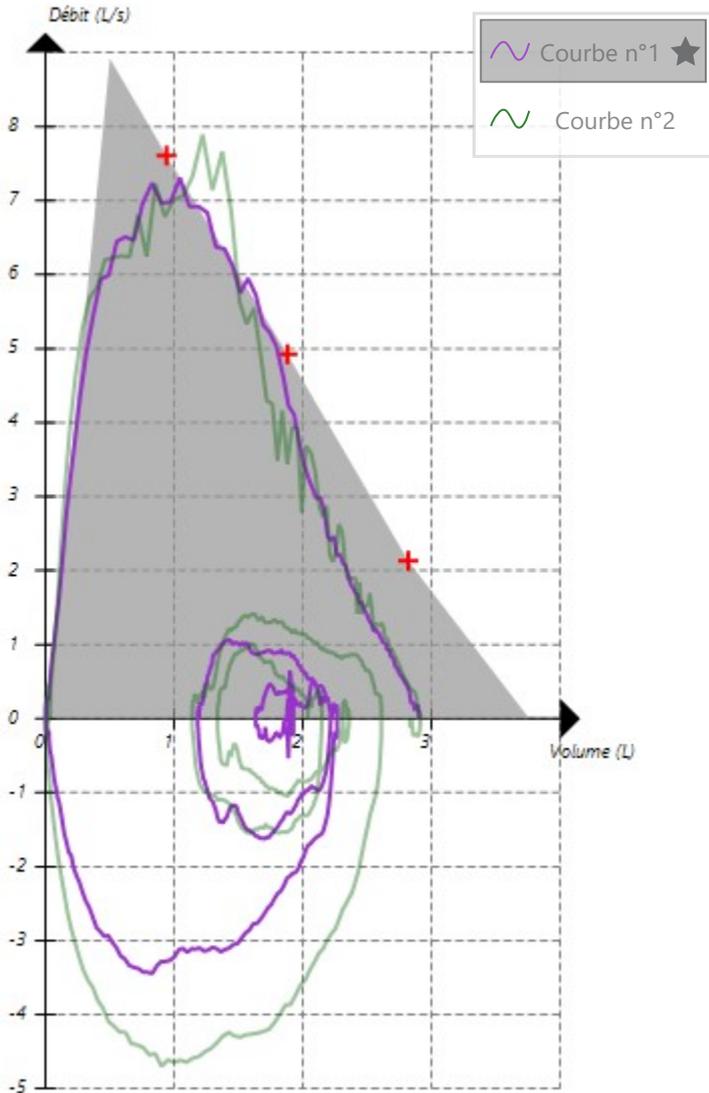

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,90 L	2,89 L	3,76 L	77,13 %
VEMS	2,84 L	2,85 L	3,20 L	88,75 %
DEP	7,52 L/s	8,75 L/s	8,92 L/s	84,30 %
VEMS/ CVF	97,93 %	98,62 %	81,48 %	120,19 %
Durée d'expiration	3,05 s	1,61 s	-	
DEMM	5,40 L/s	5,20 L/s	4,53 L/s	119,21 %
DEMM/ CVF	1,86 s-1	1,80 s-1	1,05 s-1	177,14 %
DE75	6,70 L/s	6,74 L/s	7,61 L/s	88,04 %
DE50	6,27 L/s	6,16 L/s	4,92 L/s	127,44 %
DE25	2,54 L/s	2,94 L/s	2,13 L/s	119,25 %