



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE DIX	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 13/08/1998	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 49	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 53 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

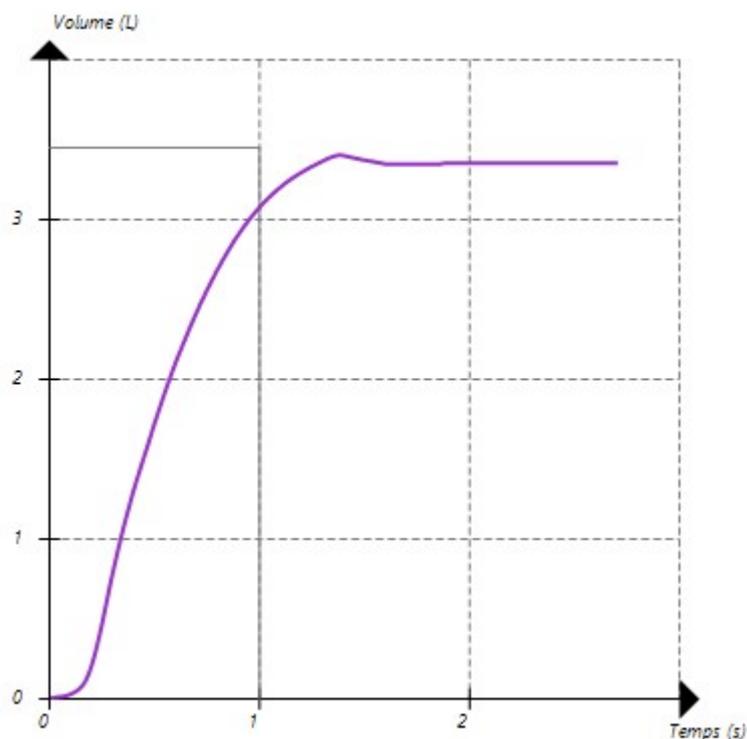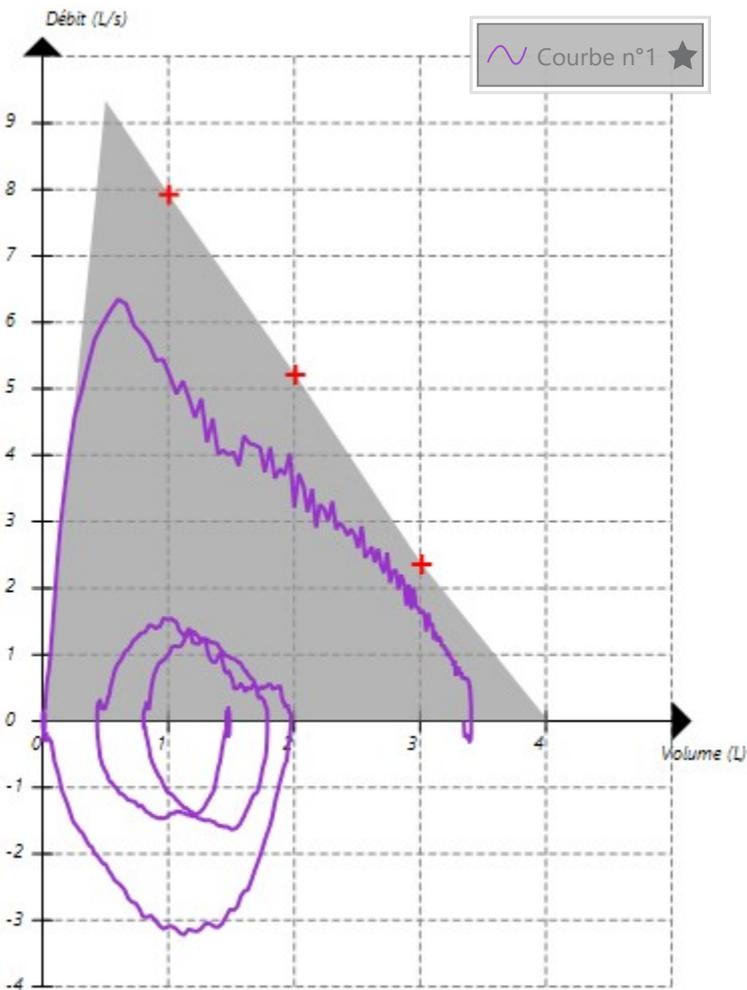

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,40 L	4,02 L	84,58 %
VEMS	3,27 L	3,45 L	94,78 %
DEP	6,54 L/s	9,34 L/s	70,02 %
VEMS/ CVF	96,18 %	82,74 %	116,24 %
Durée d'expiration	1,46 s	-	
DEMM	3,91 L/s	4,87 L/s	80,29 %
DEMM/ CVF	1,15 s-1	1,05 s-1	109,52 %
DE75	5,64 L/s	7,92 L/s	71,21 %
DE50	4,37 L/s	5,21 L/s	83,88 %
DE25	2,51 L/s	2,36 L/s	106,36 %