

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DJIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 16/12/1998	<b>Profession</b> ELINGUEUR
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 239	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 32,3 °C  
 Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Humidité : 71 %

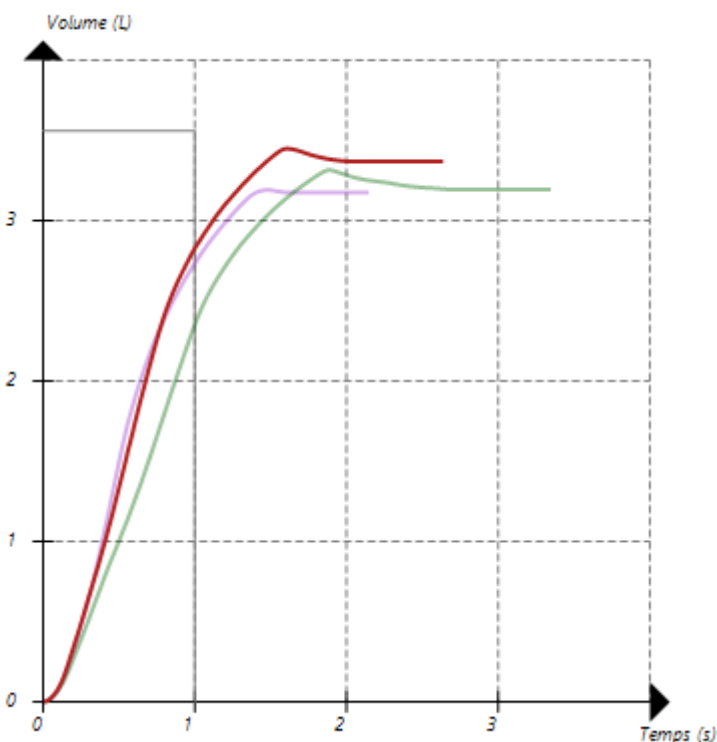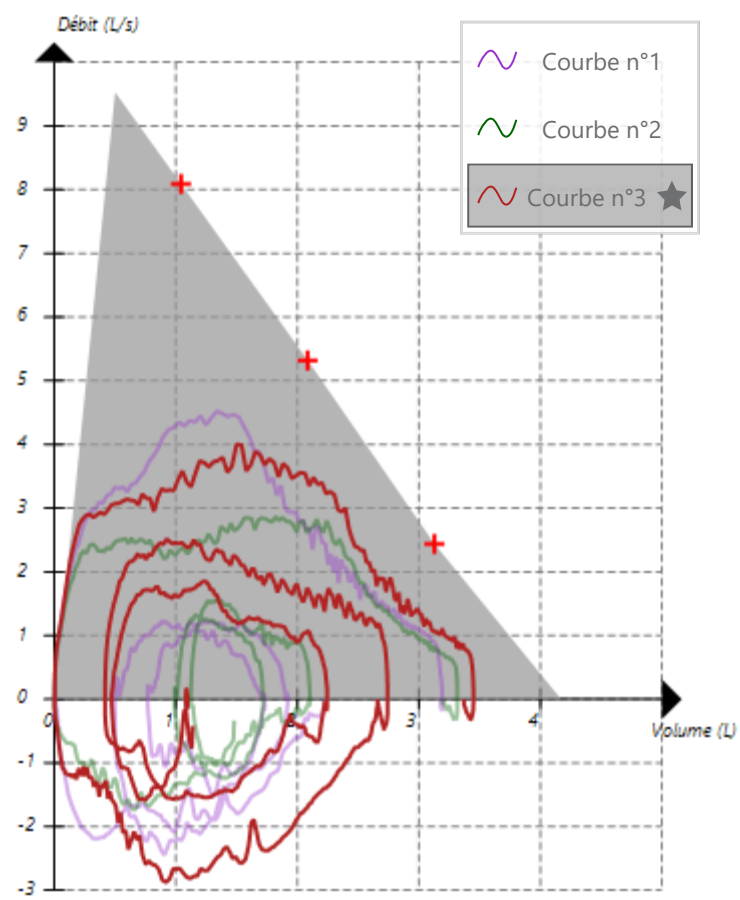

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,19 L	3,32 L	3,45 L	4,17 L	82,73 %
VEMS	2,95 L	2,68 L	3,04 L	3,56 L	85,39 %
DÉP	4,60 L/s	2,92 L/s	4,04 L/s	9,53 L/s	42,39 %
VEMS/ CVF	92,48 %	80,72 %	88,12 %	82,74 %	106,50 %
Durée d'expiration	1,52 s	1,90 s	1,66 s	-	
DEMM	3,47 L/s	2,61 L/s	3,42 L/s	4,93 L/s	69,37 %
DEMM/ CVF	1,09 s <sup>-1</sup>	0,79 s <sup>-1</sup>	0,99 s <sup>-1</sup>	1,03 s <sup>-1</sup>	96,12 %
DE75	3,92 L/s	2,31 L/s	3,24 L/s	8,09 L/s	40,05 %
DE50	4,05 L/s	2,68 L/s	3,63 L/s	5,32 L/s	68,23 %
DE25	2,26 L/s	1,96 L/s	2,00 L/s	2,44 L/s	81,97 %