



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 92	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 72 %

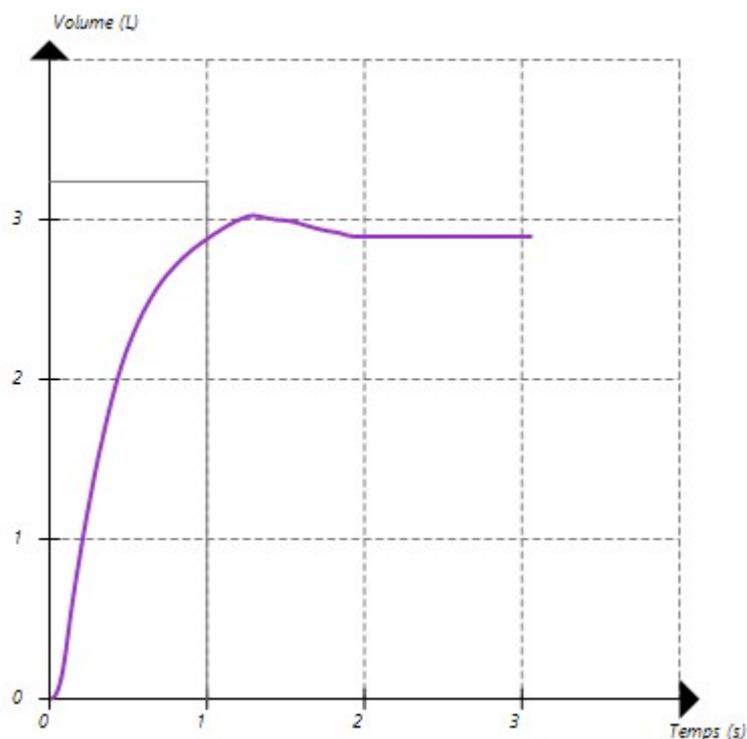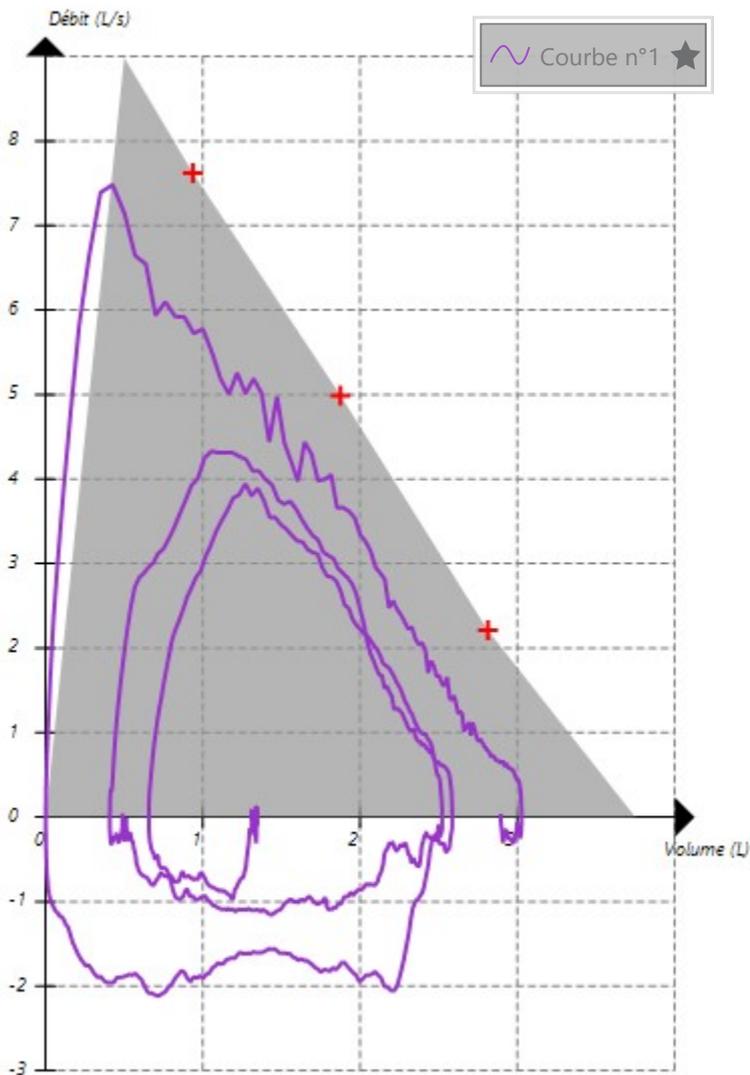

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,03 L	3,75 L	80,80 %
VEMS	2,92 L	3,24 L	90,12 %
DEP	7,61 L/s	8,99 L/s	84,65 %
VEMS/ CVF	96,37 %	82,56 %	116,73 %
Durée d'expiration	1,29 s	-	
DEMM	4,26 L/s	4,73 L/s	90,06 %
DEMM/ CVF	1,41 s-1	1,10 s-1	128,18 %
DE75	6,47 L/s	7,62 L/s	84,91 %
DE50	4,47 L/s	4,99 L/s	89,58 %
DE25	2,39 L/s	2,21 L/s	108,14 %