

<b>Nom</b> MAOMY	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUODIEBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> TECHNICIEN LABORATOIRE
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> LC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 14	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %

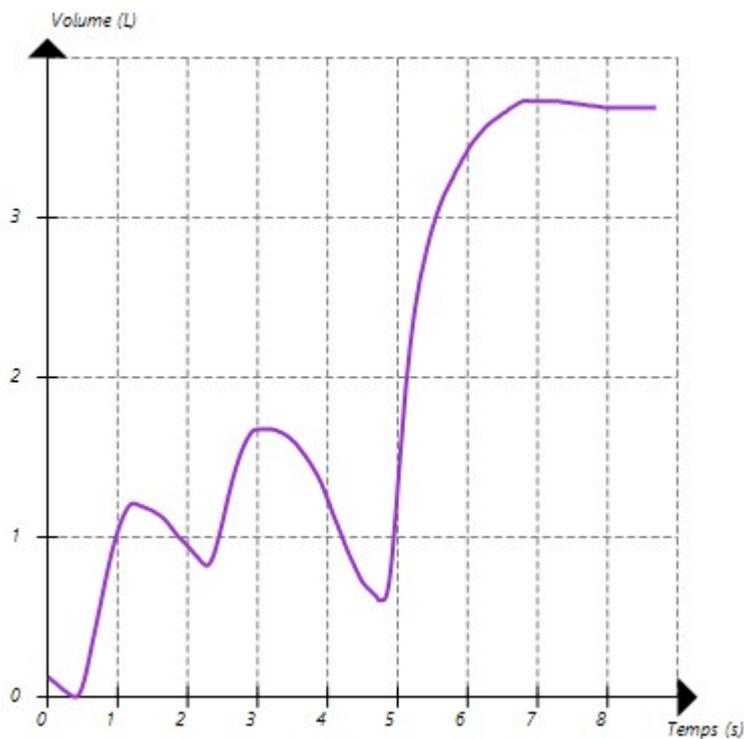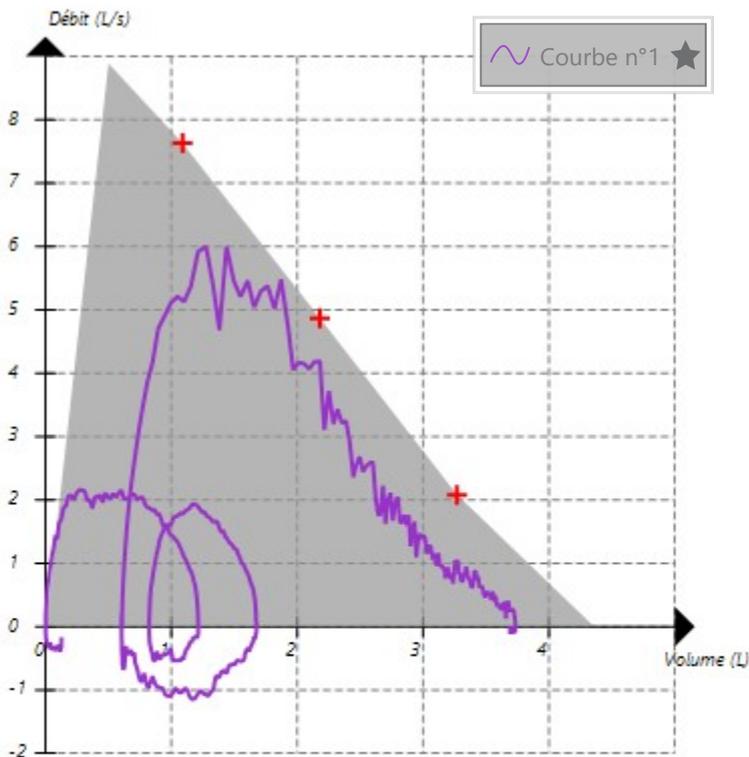

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,13 L	4,36 L	71,79 %
VEMS	2,72 L	3,66 L	74,32 %
DEP	6,68 L/s	8,89 L/s	75,14 %
VEMS/ CVF	86,90 %	80,59 %	107,83 %
Durée d'expiration	2,04 s	-	
DEMM	3,17 L/s	4,37 L/s	72,54 %
DEMM/ CVF	1,01 s-1	1,00 s-1	101,00 %
DE75	4,73 L/s	7,63 L/s	61,99 %
DE50	4,59 L/s	4,87 L/s	94,25 %
DE25	1,49 L/s	2,08 L/s	71,63 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: