

<b>Nom</b> LOUA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MATHOS	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/03/1992	<b>Profession</b> RESPONSABLE RH
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> LENS CORPS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 17	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 106 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 25,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 57 %

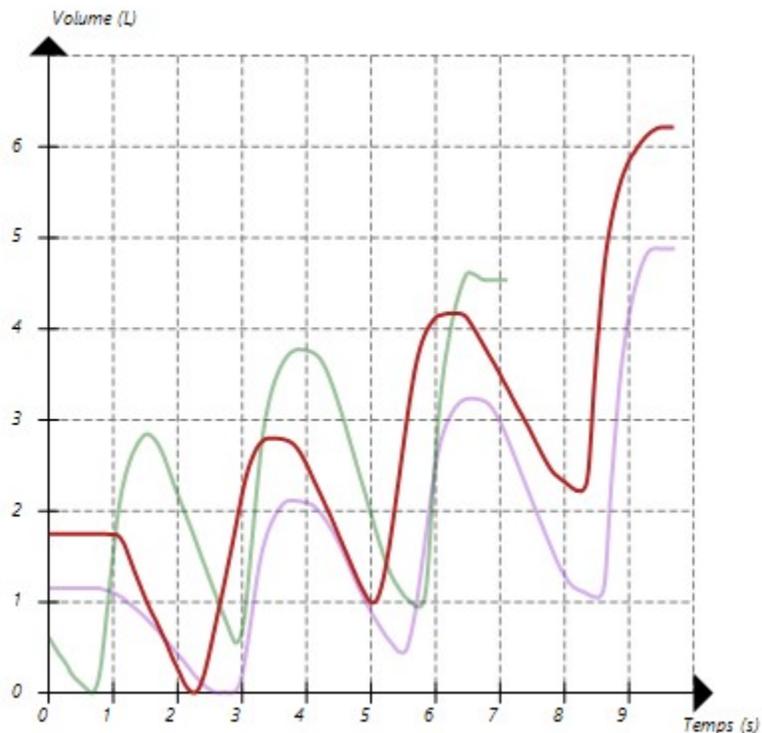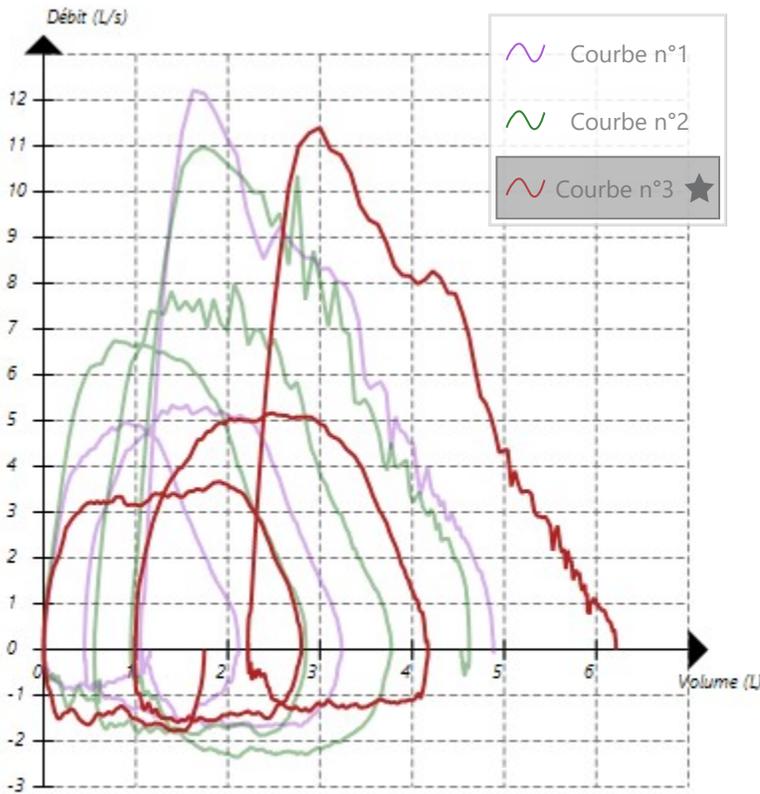

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,84 L	3,67 L	4,00 L	5,59 L	71,56 %
VEMS	3,84 L	3,67 L	3,95 L	4,56 L	86,62 %
DEP	12,42 L/s	11,16 L/s	11,60 L/s	-	
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	98,75 %	81,97 %	120,47 %
Durée d'expiration	0,89 s	0,79 s	1,25 s	-	
DEMM	7,68 L/s	7,92 L/s	6,92 L/s	4,63 L/s	149,46 %
DEMM/CVF	2,00 s-1	2,16 s-1	1,73 s-1	0,83 s-1	208,43 %
DE75	11,11 L/s	10,85 L/s	10,81 L/s	-	
DE50	8,56 L/s	9,56 L/s	8,35 L/s	-	
DE25	4,64 L/s	4,28 L/s	3,29 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: