

Nom THIAM	Adresse
Prénom DJIBY	Exposition
Né le 31/12/1999	Profession DIRECTEUR QHSE
Age 24 Ans	Entreprise LENSE-CORPS
Genre Masculin	Service
ID 19	Fumeur Non fumeur
Taille 189 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 86 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,7 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 60 %

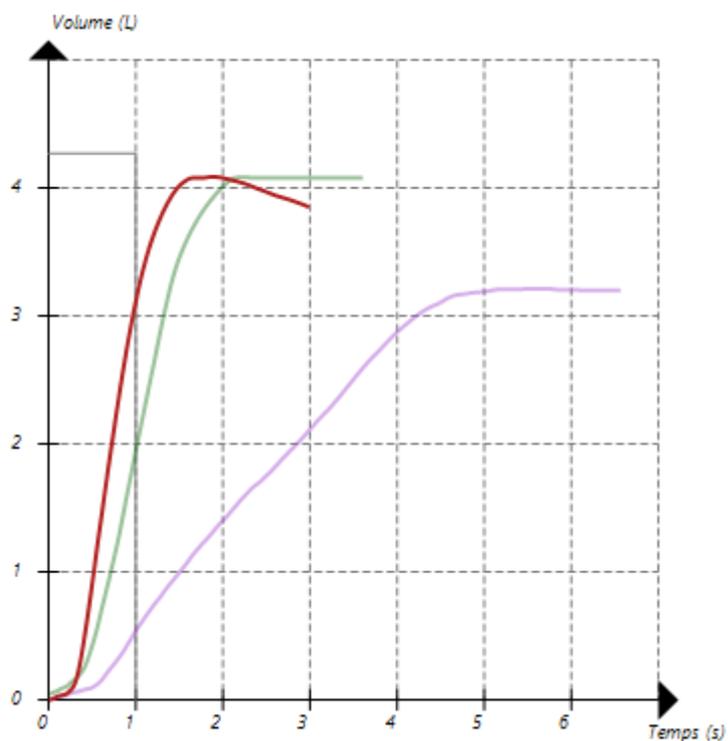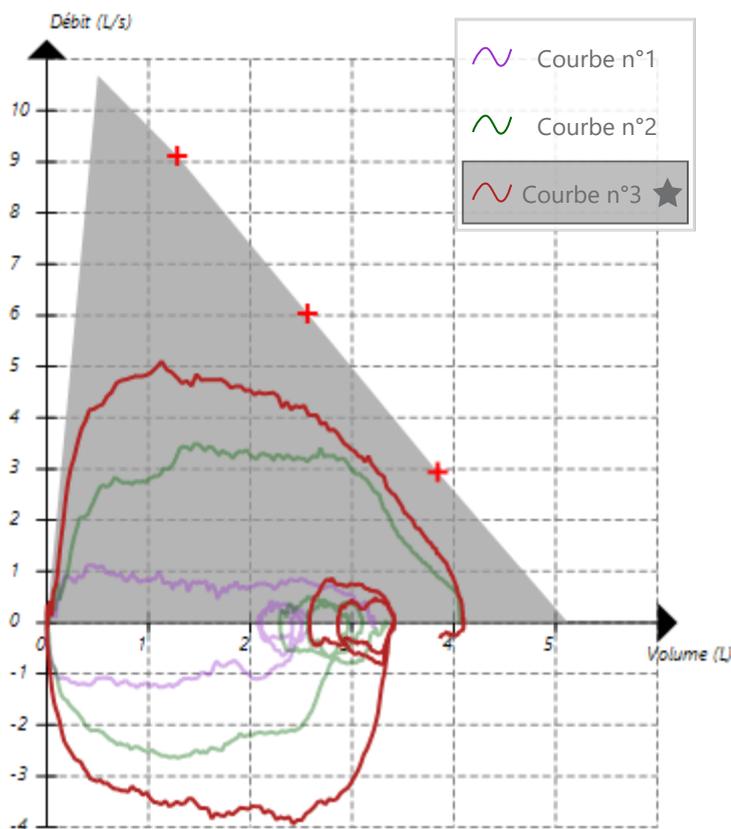

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,21 L	4,06 L	4,09 L	5,12 L	79,88 %
VEMS	1,02 L	3,33 L	3,82 L	4,27 L	89,46 %
DÉP	1,14 L/s	3,53 L/s	5,20 L/s	10,69 L/s	48,64 %
VEMS/CVF	31,78 %	82,02 %	93,40 %	82,74 %	112,88 %
Durée d'expiration	5,48 s	2,32 s	1,88 s	-	
DEMM	0,76 L/s	3,29 L/s	4,42 L/s	5,30 L/s	83,40 %
DEMM/CVF	0,24 s ⁻¹	0,81 s ⁻¹	1,08 s ⁻¹	0,90 s ⁻¹	120,00 %
DE75	0,87 L/s	2,81 L/s	4,83 L/s	9,12 L/s	52,96 %
DE50	0,71 L/s	3,22 L/s	4,49 L/s	6,04 L/s	74,34 %
DE25	0,85 L/s	2,86 L/s	3,19 L/s	2,94 L/s	108,50 %