

<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 26/09/1990	<b>Profession</b> INGENIEUR CHEF DE CHANTIER
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> EITP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 54 %

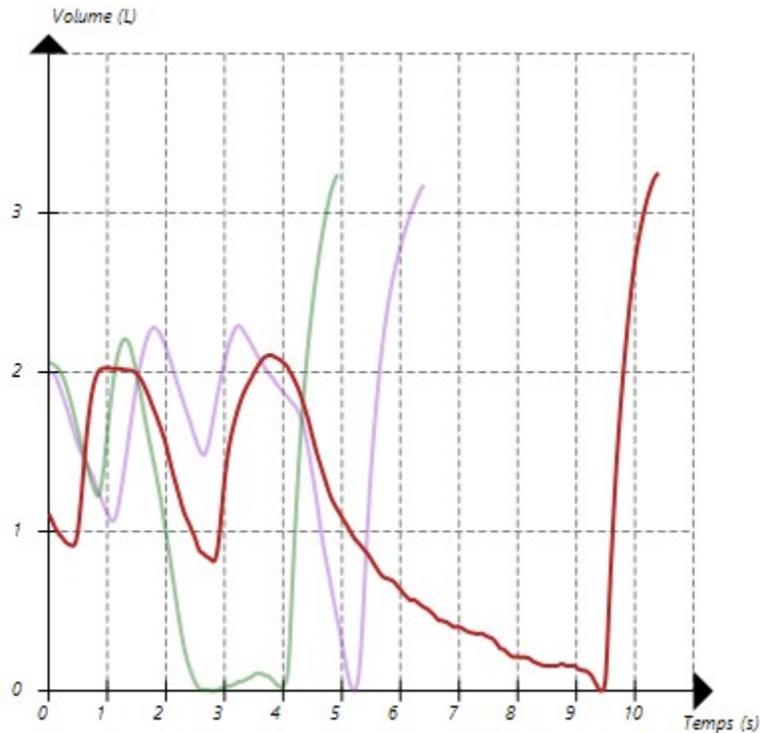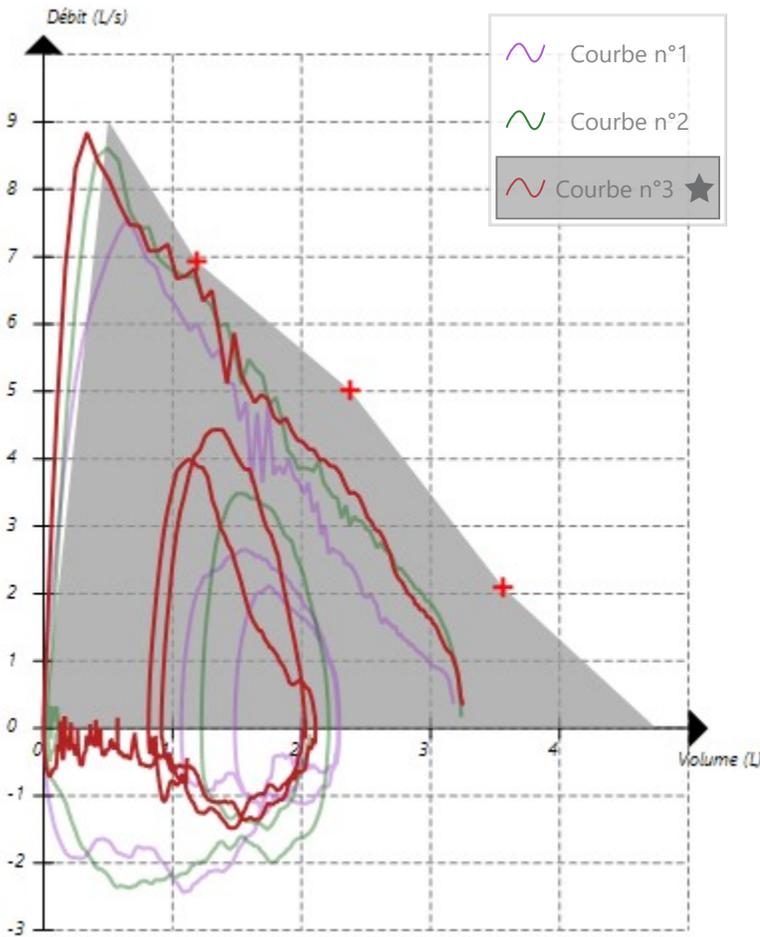

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,18 L	3,22 L	3,26 L	4,75 L	68,63 %
VEMS	3,10 L	3,22 L	3,26 L	3,96 L	82,32 %
DEP	7,65 L/s	8,77 L/s	9,01 L/s	9,02 L/s	99,89 %
VEMS/ CVF	97,48 %	100,00 %	100,00 %	83,24 %	120,13 %
Durée d'expiration	1,21 s	0,98 s	0,99 s	-	
DEMM	4,31 L/s	4,92 L/s	5,09 L/s	4,24 L/s	120,05 %
DEMM/ CVF	1,36 s-1	1,53 s-1	1,56 s-1	0,89 s-1	175,28 %
DE75	6,96 L/s	7,61 L/s	7,54 L/s	6,93 L/s	108,80 %
DE50	4,32 L/s	5,47 L/s	4,85 L/s	5,02 L/s	96,61 %
DE25	2,37 L/s	3,11 L/s	3,43 L/s	2,09 L/s	164,11 %