

**Nom** SIDIBE  
**Prénom** MORY  
**Né le** 15/05/2000  
**Age** 24 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 3  
**Taille** 168 cm  
**Poids** 67 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** TECHNICIEN DE LABORATOIRE C...  
**Entreprise** ENVIROCOM  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 25,9 °C

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Humidité : 53 %

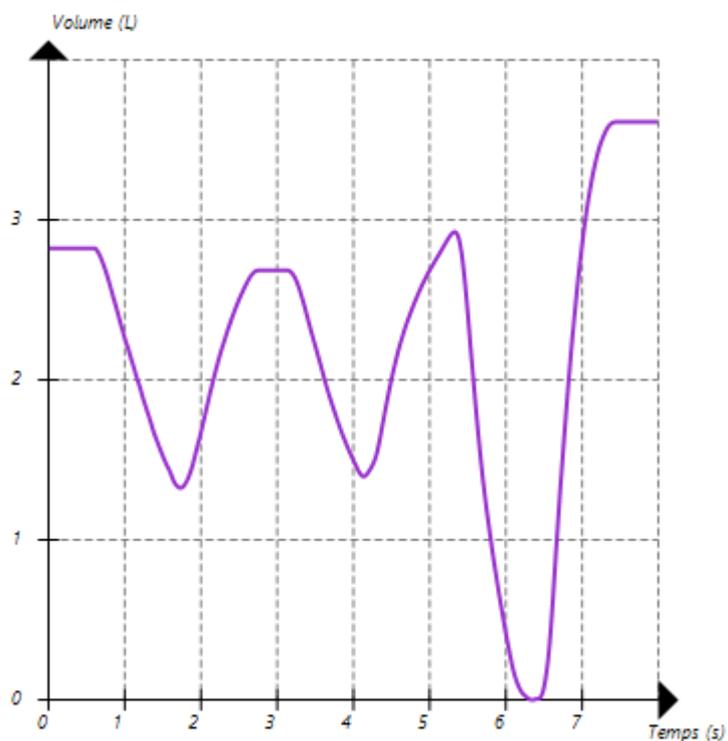

| Nom                | Courbe n°1 (Validée) | Prédits              | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| CVF                | 3,61 L               | 4,80 L               | 75,21 %   |
| VEMS               | 3,61 L               | 4,13 L               | 87,41 %   |
| DÉP                | 7,54 L/s             | 9,03 L/s             | 83,50 %   |
| VEMS/CVF           | 100,00 %             | 84,18 %              | 118,79 %  |
| Durée d'expiration | 1,08 s               | -                    |           |
| DEMM               | 5,79 L/s             | 4,65 L/s             | 124,52 %  |
| DEMM/CVF           | 1,60 s <sup>-1</sup> | 0,97 s <sup>-1</sup> | 164,95 %  |
| DE75               | 7,21 L/s             | 8,24 L/s             | 87,50 %   |
| DE50               | 5,85 L/s             | 5,49 L/s             | 106,56 %  |
| DE25               | 4,34 L/s             | 2,29 L/s             | 189,52 %  |