

<b>Nom</b> MUGABE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> CLARISSE SARA MATEUS	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 11/04/1991	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> MOTA BENGIL
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b> TECHNICIENNE
<b>ID</b> 63	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,1 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 59 %

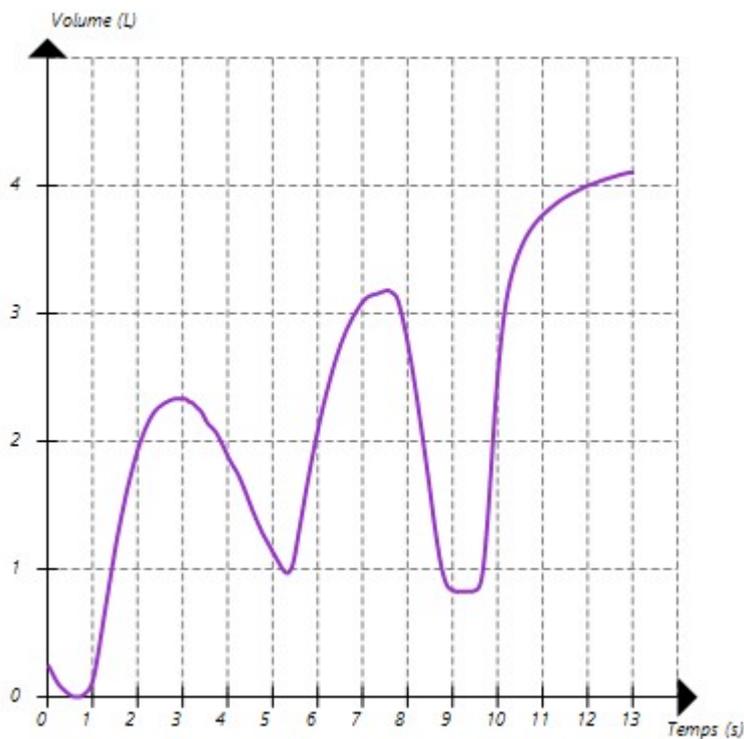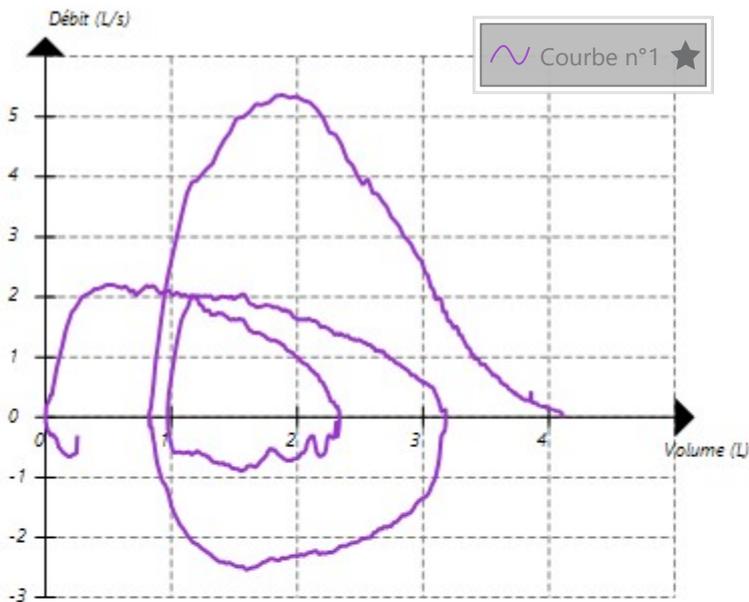

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,28 L	3,16 L	103,80 %
VEMS	2,80 L	2,66 L	105,26 %
DEP	5,47 L/s	6,76 L/s	80,92 %
VEMS/ CVF	85,37 %	84,93 %	100,52 %
Durée d'expiration	3,88 s	-	
DEMM	3,48 L/s	3,08 L/s	112,99 %
DEMM/ CVF	1,06 s-1	0,97 s-1	109,28 %
DE75	5,15 L/s	-	
DE50	4,06 L/s	-	
DE25	1,37 L/s	-	