

<b>Nom</b> TANO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KESSE PACOME	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/12/1991	<b>Profession</b> INGENIEUR GENIE CIVIL
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> MOTA ENGL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 149	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 88 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 25,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Humidité : 58 %

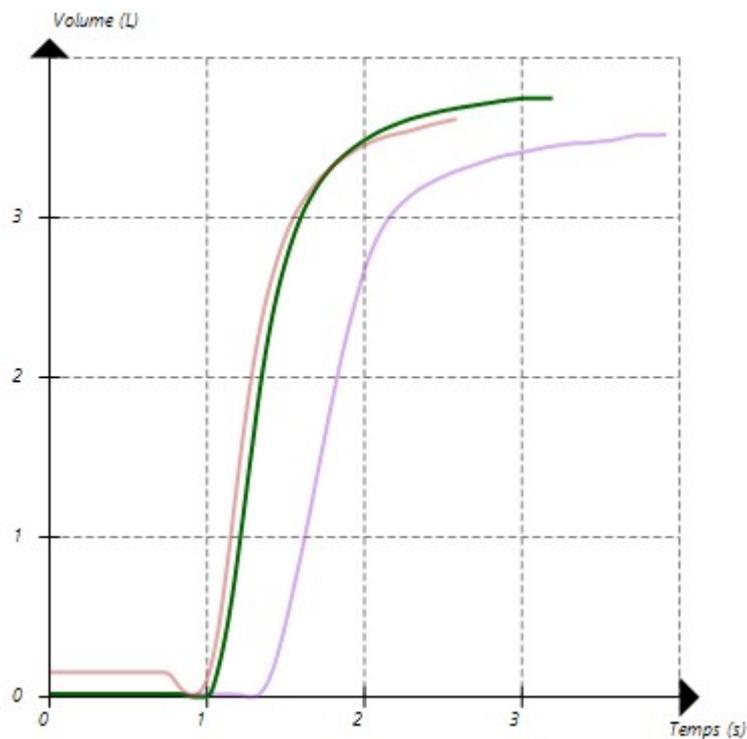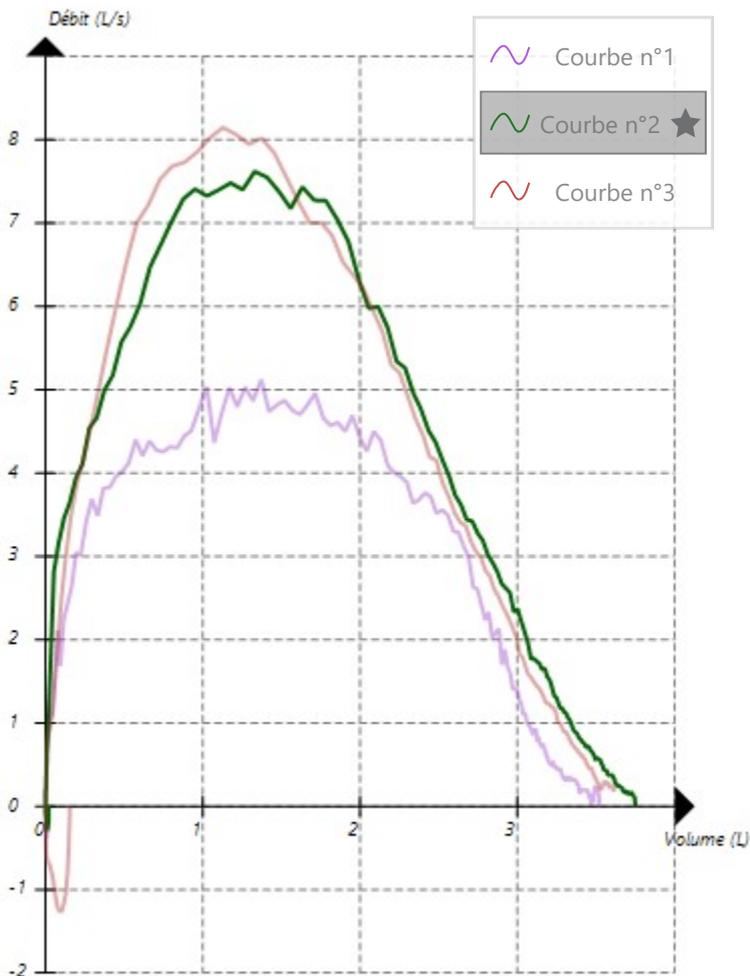

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,52 L	3,75 L	3,62 L	4,58 L	81,88 %
VEMS	3,21 L	3,53 L	3,47 L	3,81 L	92,65 %
DEP	5,31 L/s	7,71 L/s	8,21 L/s	9,64 L/s	79,98 %
VEMS/CVF	91,19 %	94,13 %	95,86 %	83,21 %	113,12 %
Durée d'expiration	2,61 s	2,22 s	1,68 s	-	
DEMM	4,45 L/s	5,82 L/s	6,03 L/s	4,10 L/s	141,95 %
DEMM/CVF	1,26 s-1	1,55 s-1	1,67 s-1	0,90 s-1	172,22 %
DE75	4,45 L/s	7,30 L/s	7,84 L/s	-	
DE50	4,42 L/s	6,76 L/s	6,81 L/s	-	
DE25	3,15 L/s	3,02 L/s	3,17 L/s	-	