

Nom <b>WILIAM</b>	Adresse
Prénom <b>JOSE DA SILVA</b>	Exposition
Né le <b>27/10/1966</b>	Profession <b>TRAINER</b>
Age <b>59 Ans</b>	Entreprise <b>MOTA ENGIL</b>
Genre <b>Masculin</b>	Service
ID <b>212</b>	Fumeur <b>Non fumeur</b>
Taille <b>175 cm</b>	Groupe ethnique <b>Mexicain</b>
Poids <b>88 kg</b>	Prescripteur:
Valeurs prédites <b>NHANES III</b>	Smoking Pack Years : <b>0</b>
Opérateur <b>BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	




**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Numéro de série : 253565  
Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Température ambiante : 27,6 °C  
Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
Humidité : 43 %

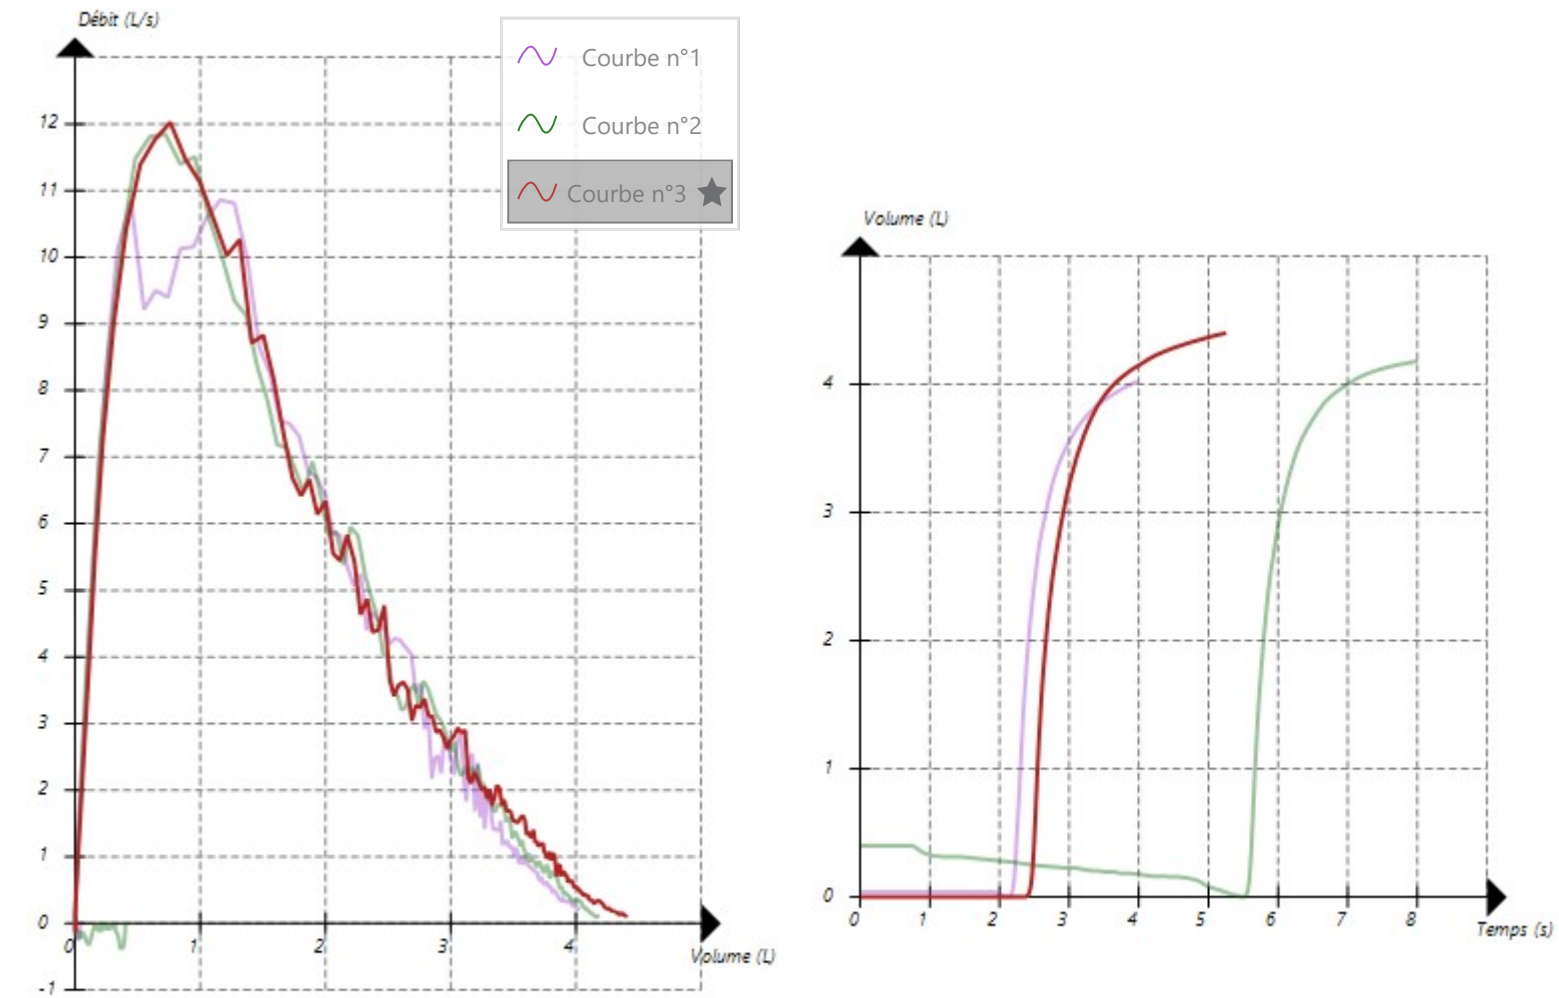

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,03 L	4,18 L	4,40 L	4,54 L	96,92 %
VEMS	3,73 L	3,79 L	3,88 L	3,53 L	109,92 %
DEP	11,00 L/s	12,00 L/s	12,36 L/s	9,07 L/s	136,27 %
VEMS/ CVF	92,56 %	90,67 %	88,18 %	77,13 %	114,33 %
Durée d'expiration	1,88 s	2,52 s	2,91 s	-	
DEMM	5,43 L/s	5,02 L/s	4,52 L/s	3,22 L/s	140,37 %
DEMM/ CVF	1,35 s-1	1,20 s-1	1,03 s-1	0,71 s-1	145,07 %
DE75	10,08 L/s	10,55 L/s	10,69 L/s	-	
DE50	6,52 L/s	5,75 L/s	5,42 L/s	-	
DE25	2,38 L/s	2,31 L/s	1,99 L/s	-	