

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nom GOMES | Adresse |
| Prénom BRANCO TEIXEIRA | Exposition |
| Né le 19/08/1974 | Profession |
| Age 50 Ans | Entreprise MOTA ENGL |
| Genre Masculin | Service EQUIPEMENR MANAGER |
| ID 65 | Fumeur Fumeur |
| Taille 167 cm | Groupe ethnique Autre |
| Poids 83 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 59 %

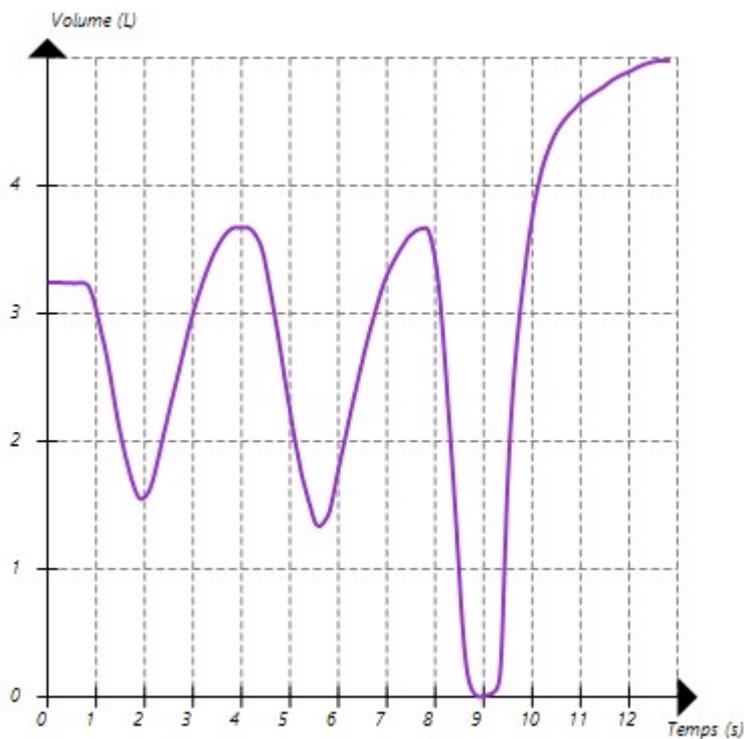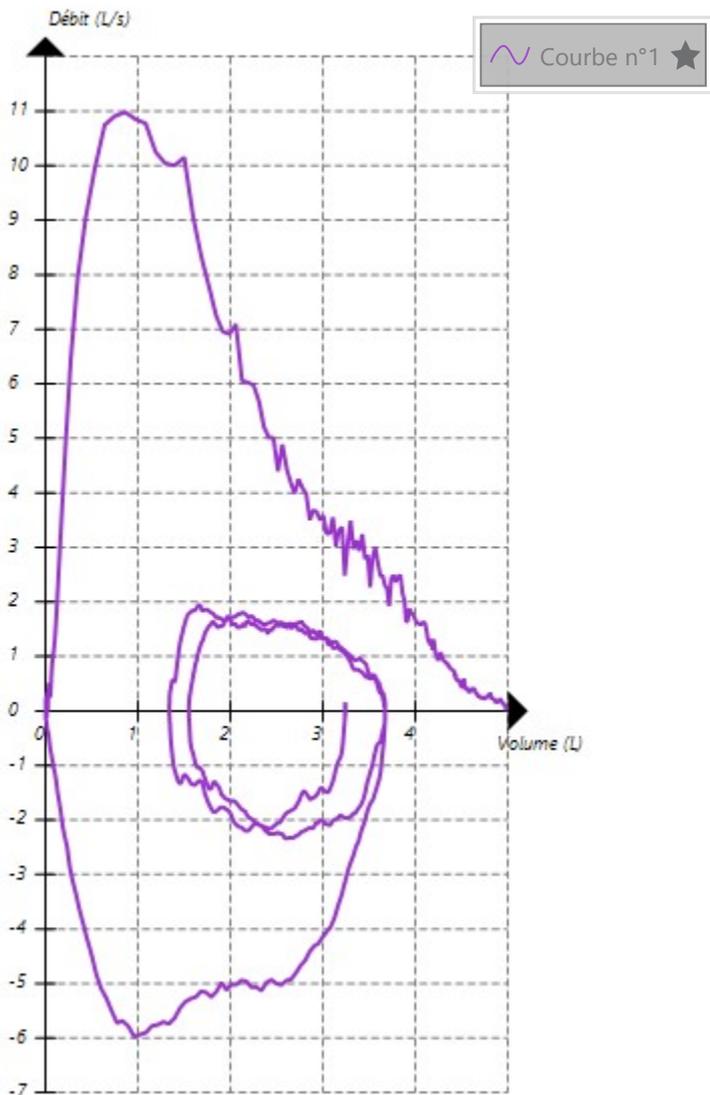

| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 4,97 L | 4,37 L | 113,73 % |
| VEMS | 4,27 L | 3,40 L | 125,59 % |
| DEP | 11,17 L/s | 8,90 L/s | 125,51 % |
| VEMS/ CVF | 85,92 % | 77,74 % | 110,52 % |
| Durée d'expiration | 3,52 s | - | |
| DEMM | 4,56 L/s | 3,09 L/s | 147,57 % |
| DEMM/ CVF | 0,92 s-1 | 0,71 s-1 | 129,58 % |
| DE75 | 10,09 L/s | - | |
| DE50 | 5,12 L/s | - | |
| DE25 | 2,54 L/s | - | |