

<b>Nom</b> BAH	<b>Adresse</b> DIXXIN
<b>Prénom</b> OUMAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 29/06/1978	<b>Profession</b> RESPONSABLE VOLET SOCIAL
<b>Age</b> 46 Ans	<b>Entreprise</b> SYLVA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 09	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,8 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 62 %

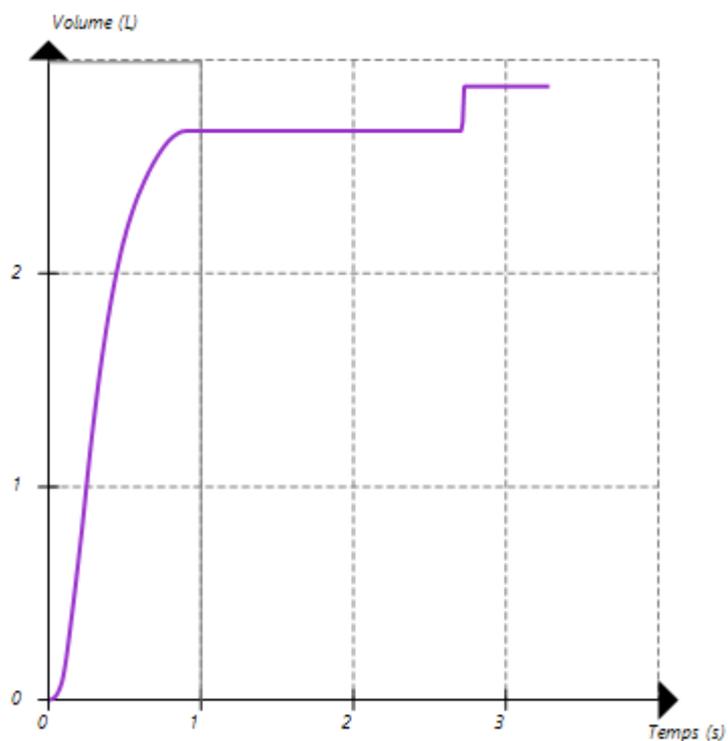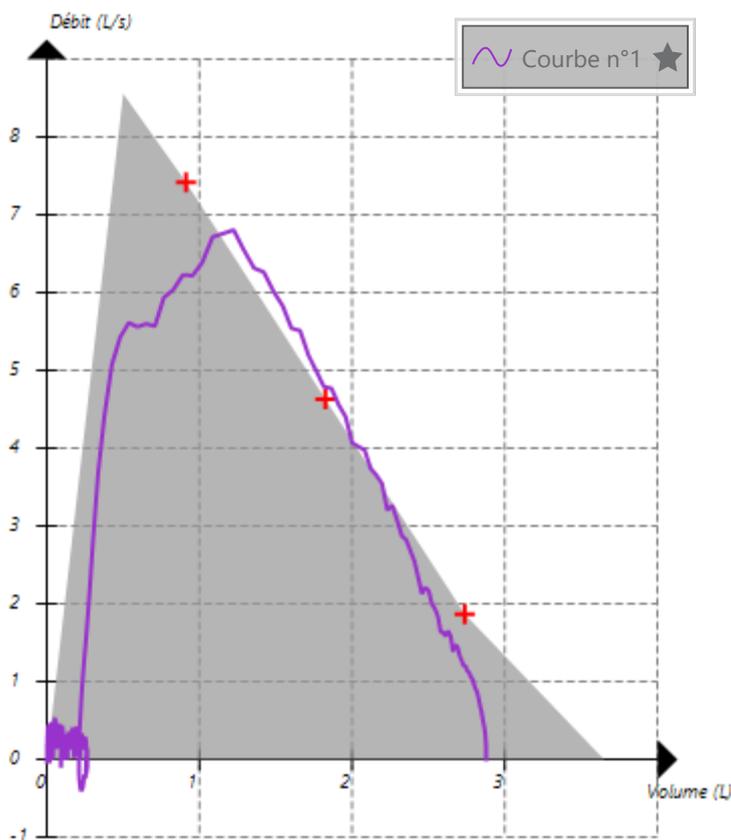

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,67 L	3,65 L	73,15 %
VEMS	2,67 L	2,99 L	89,30 %
DÉP	7,06 L/s	8,56 L/s	82,48 %
VEMS/CVF	100,00 %	78,98 %	126,61 %
Durée d'expiration	0,90 s	-	
DEMM	5,42 L/s	4,01 L/s	135,16 %
DEMM/CVF	2,03 s <sup>-1</sup>	0,96 s <sup>-1</sup>	211,46 %
DE75	6,39 L/s	7,42 L/s	86,12 %
DE50	5,91 L/s	4,63 L/s	127,65 %
DE25	3,36 L/s	1,87 L/s	179,68 %