

<b>Nom</b> DANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> CHENGKAI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/03/1996	<b>Profession</b> ASSISTANT ADMI
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> AUXIN
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 40	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 83 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 58 %

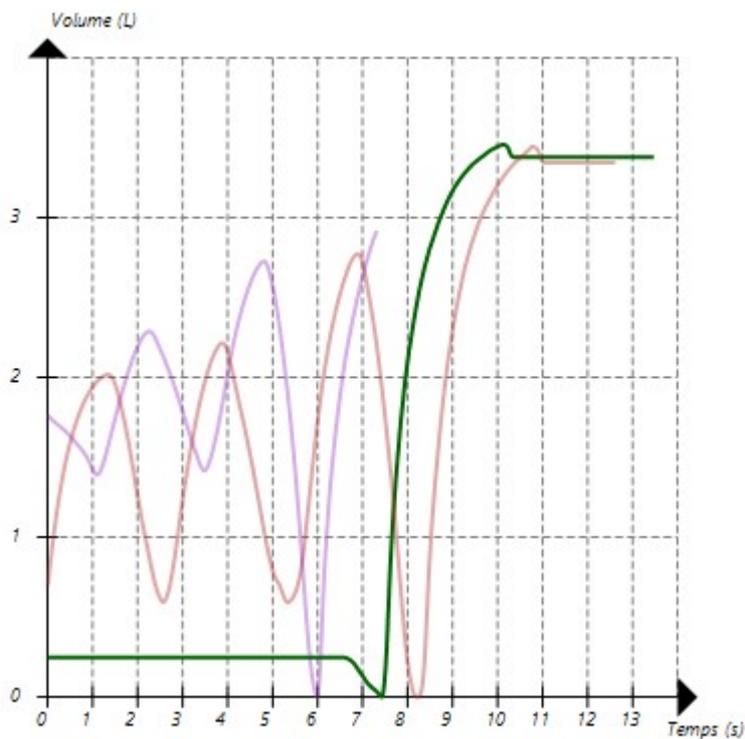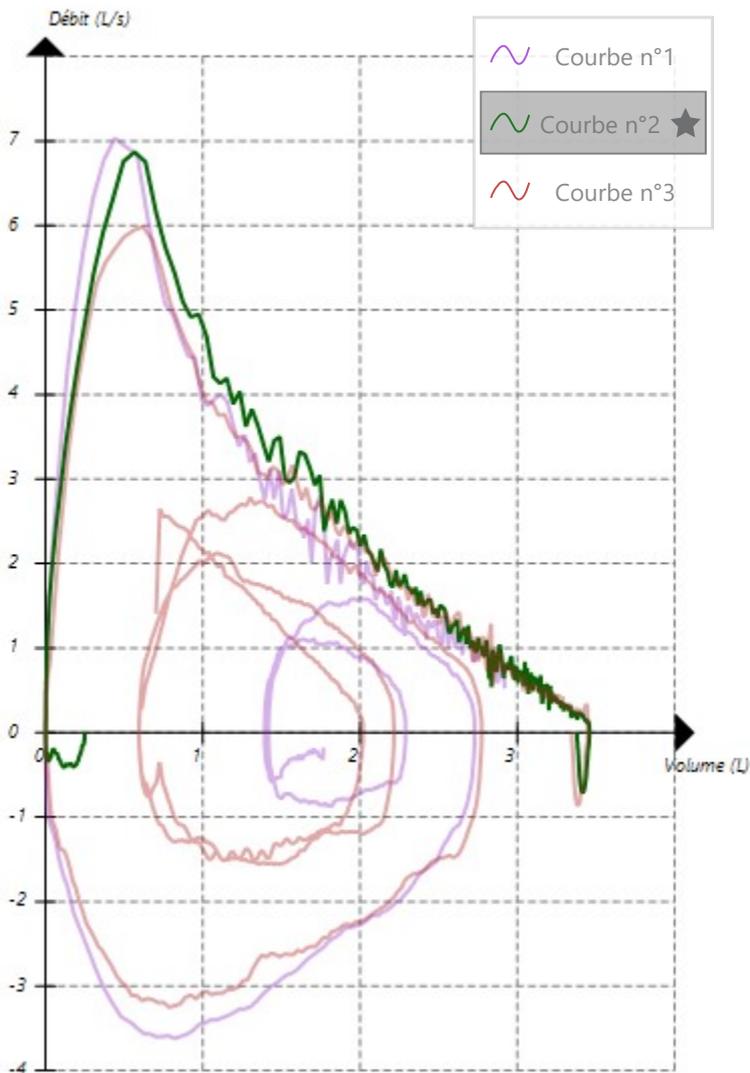

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,93 L	3,46 L	3,45 L	4,99 L	69,34 %
VEMS	2,66 L	2,80 L	2,76 L	4,11 L	68,13 %
DEP	7,11 L/s	6,94 L/s	6,07 L/s	9,57 L/s	72,52 %
VEMS/ CVF	90,78 %	80,92 %	80,00 %	82,07 %	98,60 %
Durée d'expiration	1,34 s	2,67 s	2,55 s	-	
DEMM	2,79 L/s	2,56 L/s	2,44 L/s	4,24 L/s	60,38 %
DEMM/ CVF	0,95 s-1	0,74 s-1	0,71 s-1	0,85 s-1	87,06 %
DE75	5,29 L/s	5,13 L/s	4,85 L/s	-	
DE50	3,21 L/s	3,07 L/s	2,86 L/s	-	
DE25	1,64 L/s	1,32 L/s	1,31 L/s	-	