

**Nom OULARE**  
**Prénom LANCINE**  
**Né le** 02/03/1995  
**Age** 30 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 261  
**Taille** 168 cm  
**Poids** 60 kg  
**Valeurs prédites** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DRIVER  
**Entreprise** CHALIECO  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 49 %

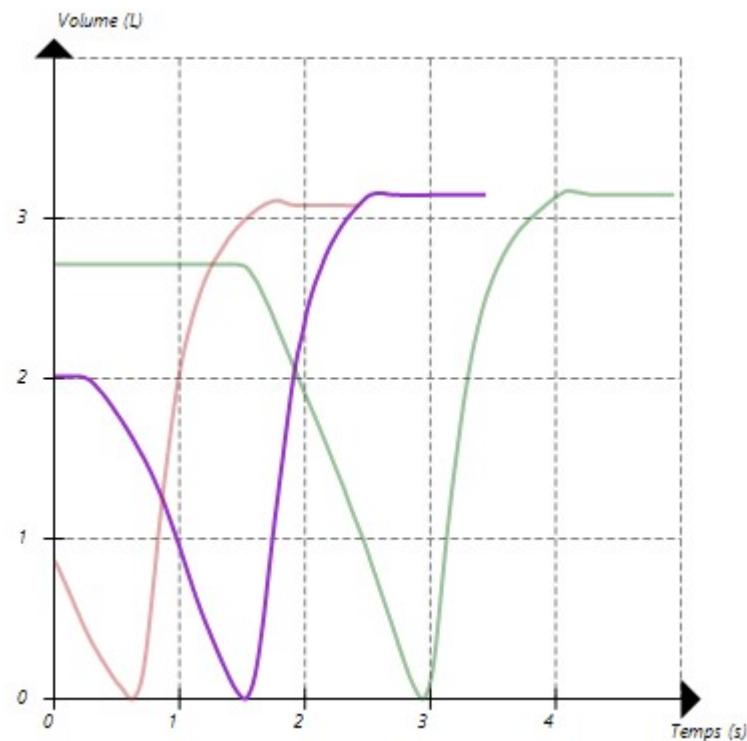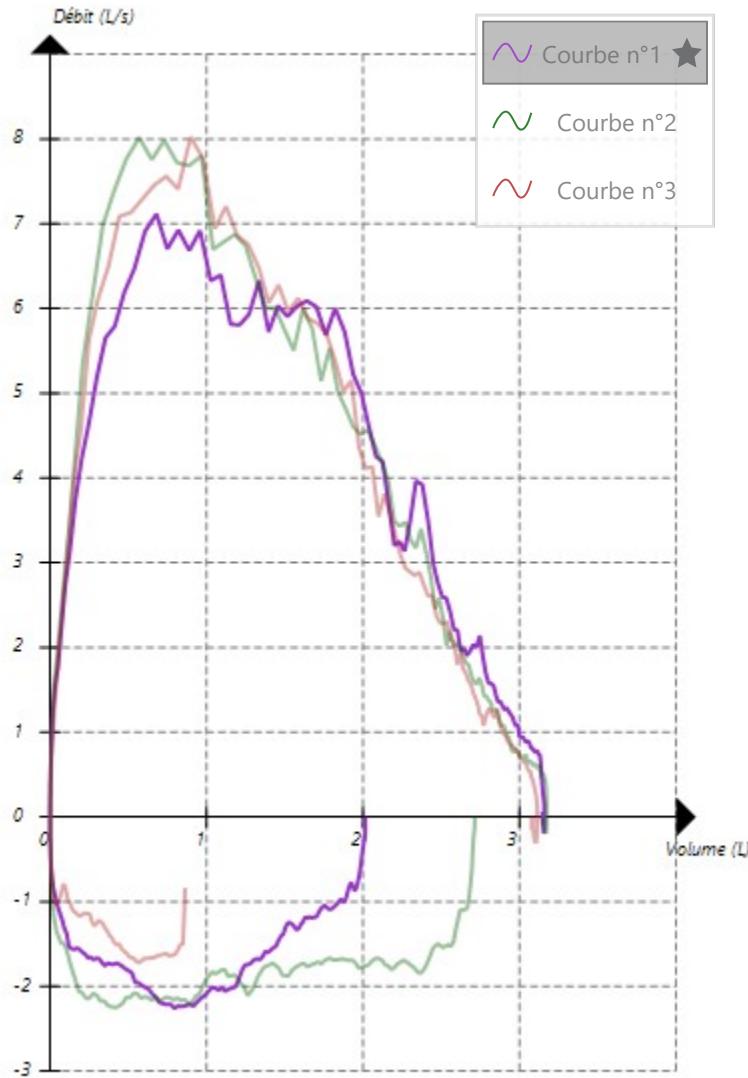

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,16 L	3,17 L	3,11 L	4,00 L	79,00 %
VEMS	3,16 L	3,13 L	3,09 L	3,37 L	93,77 %
DEP	7,36 L/s	8,32 L/s	8,29 L/s	8,72 L/s	84,40 %
VEMS/CVF	100,00 %	98,74 %	99,36 %	83,76 %	119,39 %
Durée d'expiration	1,06 s	1,16 s	1,16 s	-	
DEMM	5,41 L/s	5,38 L/s	5,42 L/s	3,83 L/s	141,25 %
DEMM/CVF	1,71 s <sup>-1</sup>	1,70 s <sup>-1</sup>	1,74 s <sup>-1</sup>	0,96 s <sup>-1</sup>	178,12 %
DE75	7,29 L/s	7,88 L/s	7,31 L/s	-	
DE50	5,96 L/s	6,06 L/s	6,27 L/s	-	
DE25	3,99 L/s	3,51 L/s	2,83 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: