

**Nom CHERIF**  
**Prénom MOUSSA**  
**Né le** 01/01/1985  
**Age** 40 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 214  
**Taille** 174 cm  
**Poids** 77 kg  
**Valeurs prédites** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DRIVER  
**Entreprise** CHALIECO  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,8 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 53 %

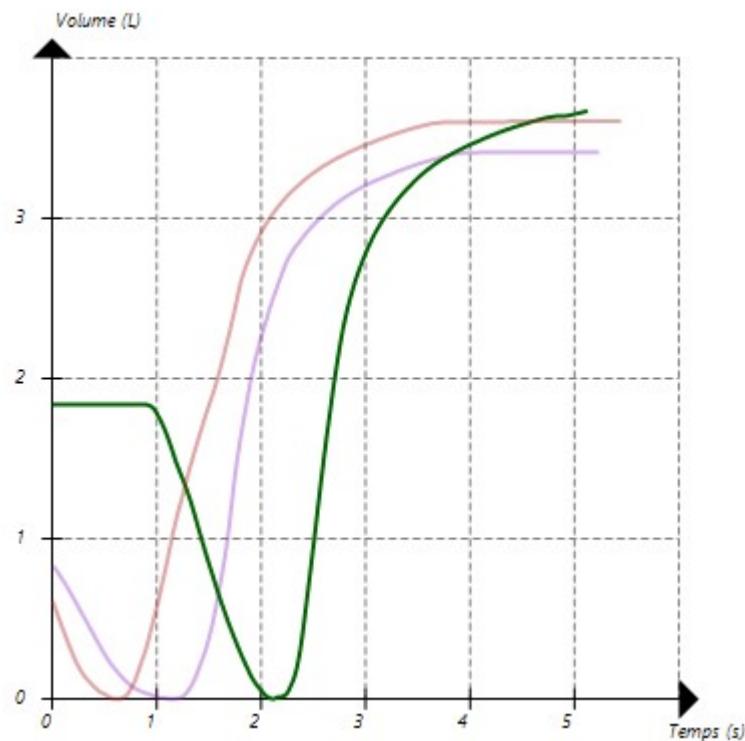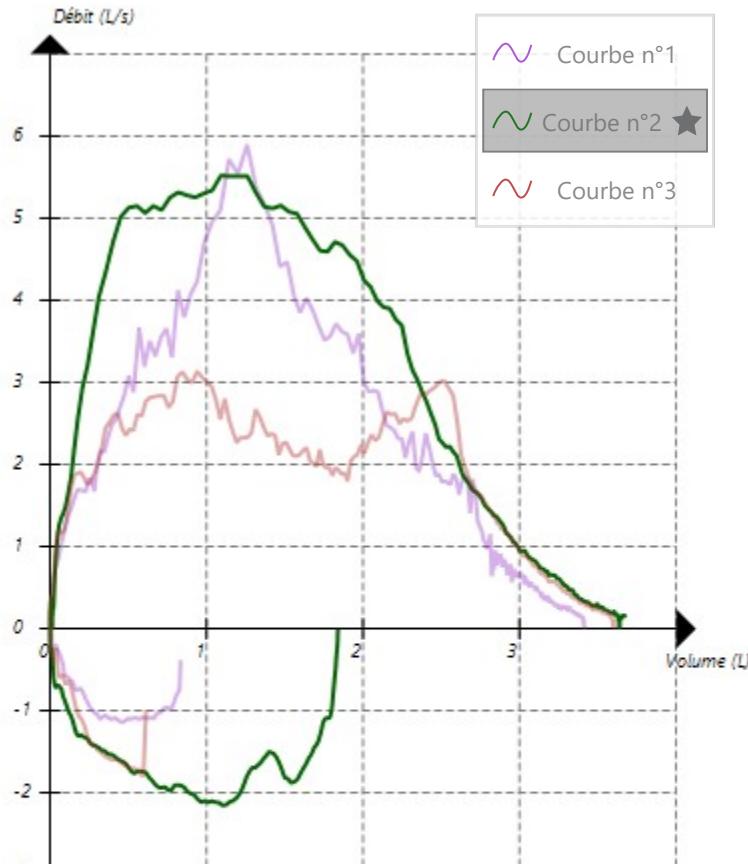

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,41 L	3,67 L	3,61 L	4,16 L	88,22 %
VEMS	2,96 L	3,13 L	2,60 L	3,41 L	91,79 %
DEP	6,04 L/s	5,58 L/s	3,21 L/s	8,87 L/s	62,91 %
VEMS/CVF	86,80 %	85,29 %	72,02 %	81,93 %	104,10 %
Durée d'expiration	3,76 s	3,02 s	3,82 s	-	
DEMM	3,40 L/s	3,76 L/s	2,43 L/s	3,62 L/s	103,87 %
DEMM/CVF	1,00 s <sup>-1</sup>	1,02 s <sup>-1</sup>	0,67 s <sup>-1</sup>	0,87 s <sup>-1</sup>	117,24 %
DE75	3,28 L/s	5,24 L/s	2,90 L/s	-	
DE50	3,66 L/s	4,76 L/s	1,86 L/s	-	
DE25	1,74 L/s	1,59 L/s	1,70 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur:

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51