

**Nom CAMARA**  
**Prénom FODE**  
**Né le 01/10/1998**  
**Age 27 Ans**  
**Genre Masculin**  
**ID 246**  
**Taille 179 cm**  
**Poids 71 kg**  
**Valeurs prédictes NHANES III**  
**Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO**

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession FRIVER**  
**Entreprise CHALECO**  
**Service**  
**Fumeur Fumeur**  
**Groupe ethnique** Caucasiens  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,1 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 55 %

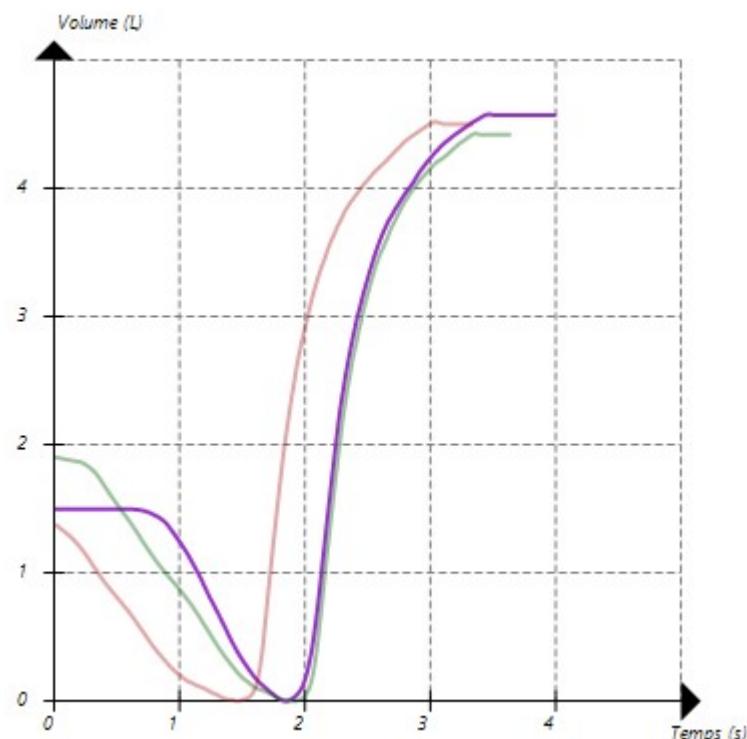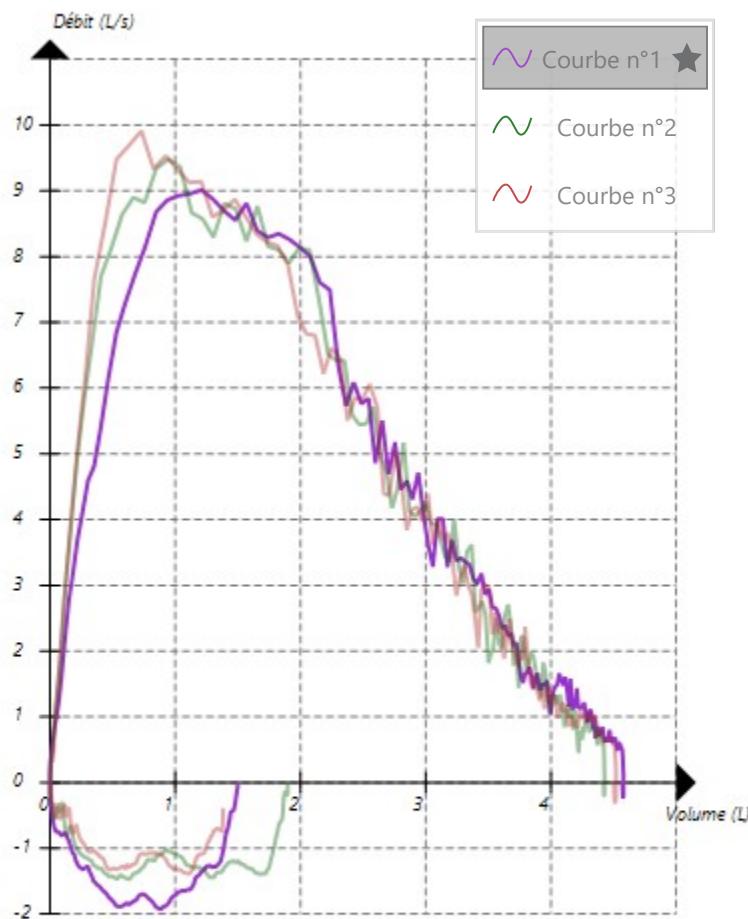

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,58 L	4,43 L	4,52 L	5,60 L	81,79 %
VEMS	4,26 L	4,21 L	4,19 L	4,59 L	92,81 %
DEP	9,16 L/s	9,74 L/s	10,06 L/s	10,34 L/s	88,59 %
VEMS/CVF	93,01 %	95,03 %	92,70 %	82,49 %	112,75 %
Durée d'expiration	1,62 s	1,48 s	1,58 s	-	
DEMM	5,81 L/s	5,97 L/s	5,69 L/s	4,67 L/s	124,41 %
DEMM/CVF	1,27 s <sup>-1</sup>	1,35 s <sup>-1</sup>	1,26 s <sup>-1</sup>	0,83 s <sup>-1</sup>	153,01 %
DE75	9,01 L/s	8,89 L/s	9,03 L/s	-	
DE50	6,42 L/s	6,33 L/s	6,82 L/s	-	
DE25	3,35 L/s	3,72 L/s	2,82 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: