

**Nom CAMARA**  
**Prénom AMADOU**  
**Né le** 01/01/2001  
**Age** 24 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 254  
**Taille** 183 cm  
**Poids** 75 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DRIVER  
**Entreprise** CHALIECO  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,3 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 48 %

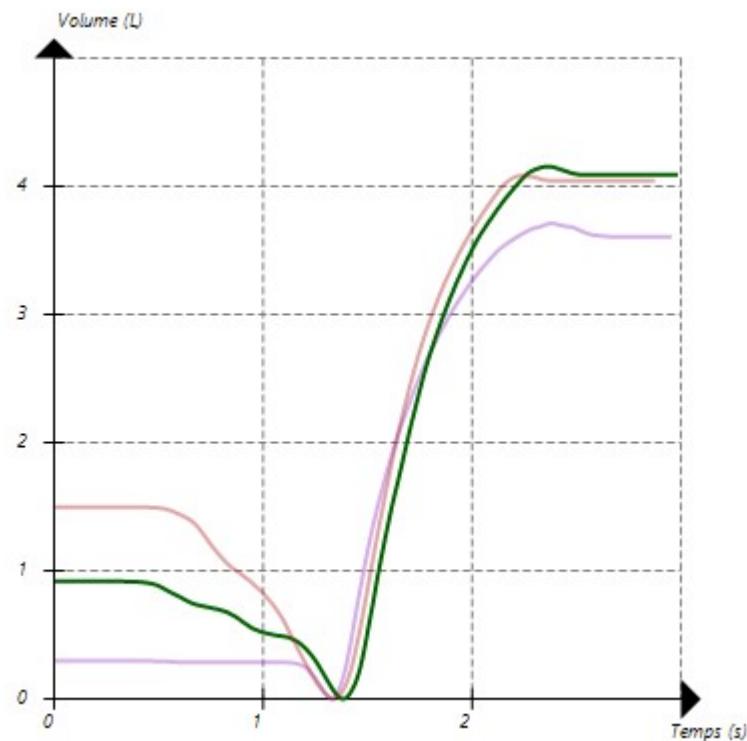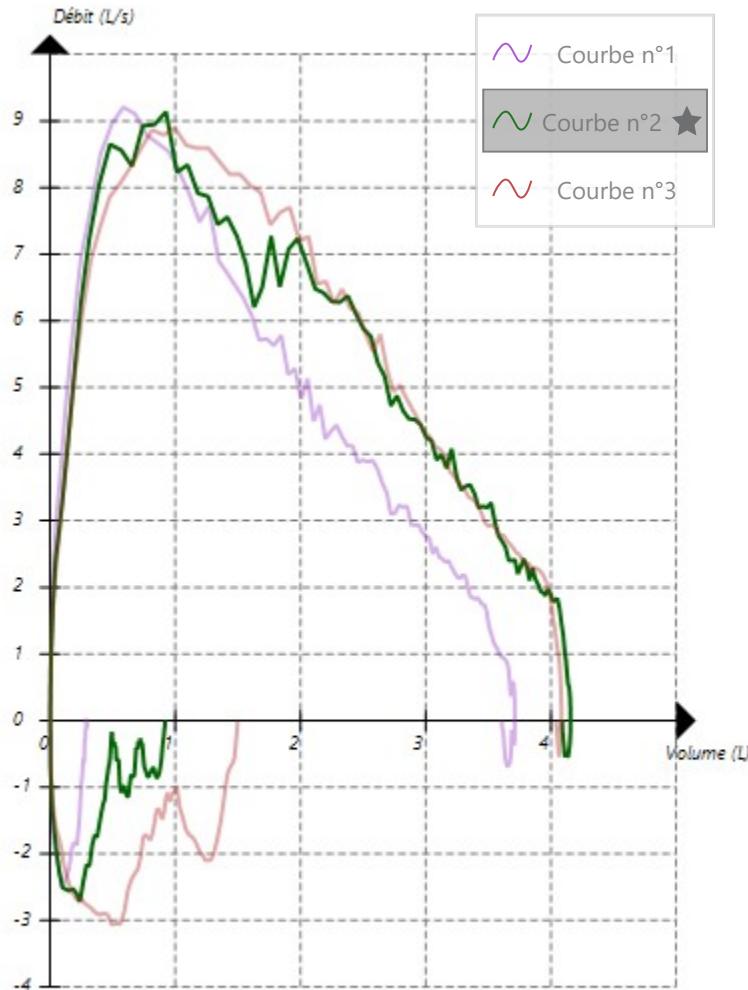

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,71 L	4,16 L	4,08 L	4,98 L	83,53 %
VEMS	3,71 L	4,16 L	4,08 L	4,21 L	98,81 %
DEP	9,54 L/s	9,47 L/s	9,38 L/s	10,40 L/s	91,06 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,85 %	117,86 %
Durée d'expiration	1,05 s	0,98 s	0,89 s	-	
DEMM	5,27 L/s	6,22 L/s	6,70 L/s	4,63 L/s	134,34 %
DEMM/CVF	1,42 s <sup>-1</sup>	1,50 s <sup>-1</sup>	1,64 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	161,29 %
DE75	8,58 L/s	8,51 L/s	8,95 L/s	-	
DE50	5,62 L/s	6,87 L/s	7,46 L/s	-	
DE25	3,24 L/s	4,16 L/s	4,09 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: