

**Nom DOUMBOUYA**  
**Prénom OUSMANE**  
**Né le 01/01/1998**  
**Age 27 Ans**  
**Genre Masculin**  
**ID 233**  
**Taille 167 cm**  
**Poids 65 kg**  
**Valeurs prédictes NHANES III**  
**Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO**

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession DRIVER**  
**Entreprise CHALIECO**  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 60 %

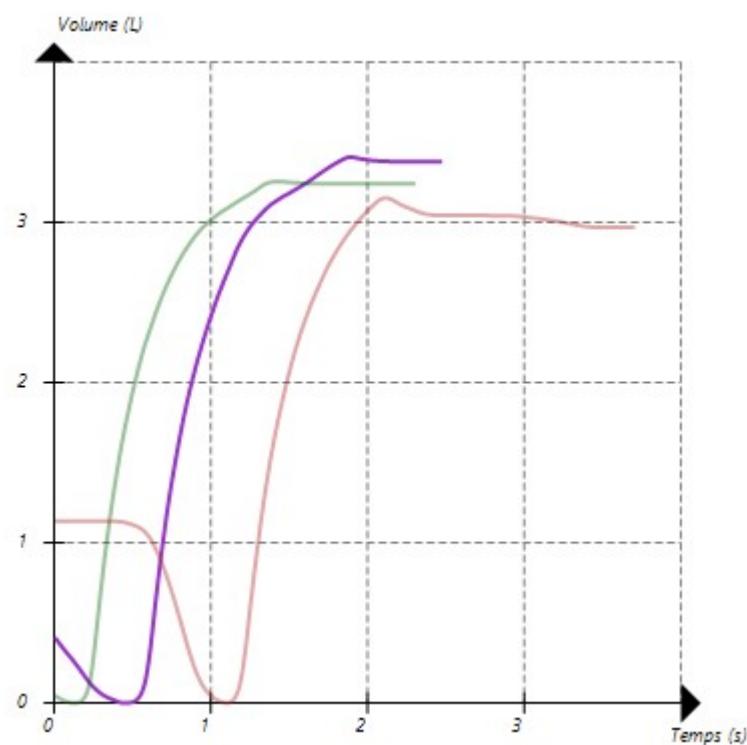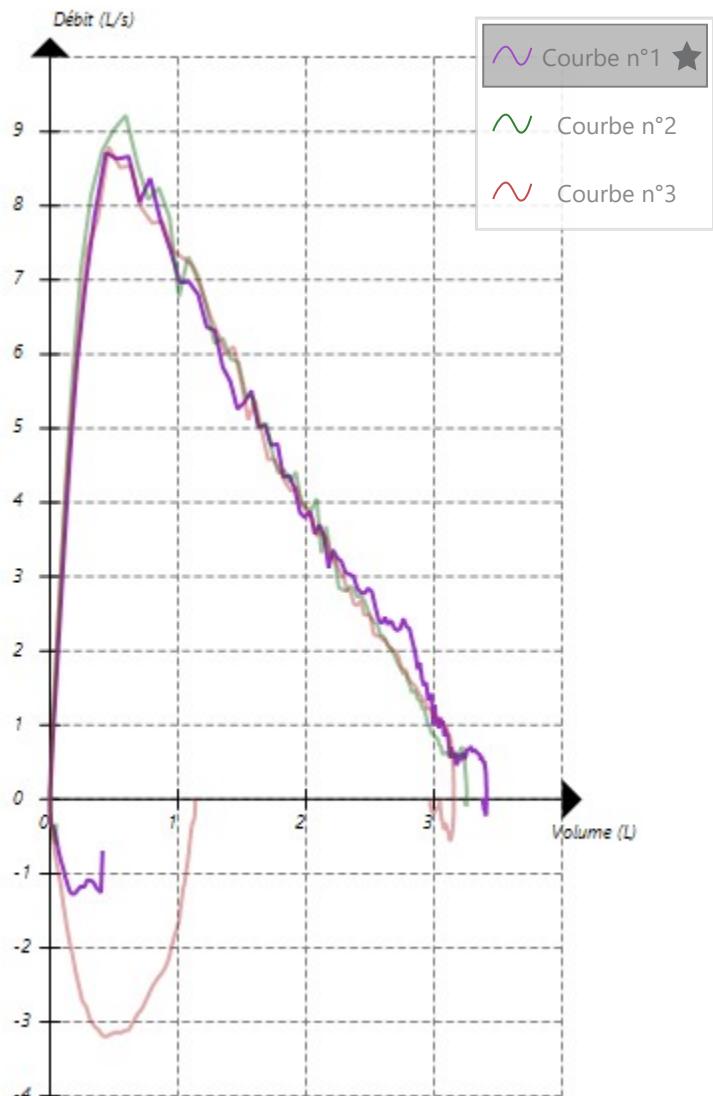

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,41 L	3,26 L	3,15 L	4,00 L	85,25 %
VEMS	3,22 L	3,16 L	3,15 L	3,40 L	94,71 %
DEP	9,15 L/s	9,36 L/s	8,97 L/s	8,75 L/s	104,57 %
VEMS/CVF	94,43 %	96,93 %	100,00 %	84,30 %	112,02 %
Durée d'expiration	1,45 s	1,28 s	1,02 s	-	
DEMM	4,51 L/s	4,80 L/s	4,96 L/s	3,92 L/s	115,05 %
DEMM/CVF	1,32 s <sup>-1</sup>	1,47 s <sup>-1</sup>	1,57 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	134,69 %
DE75	7,87 L/s	8,24 L/s	7,86 L/s	-	
DE50	4,84 L/s	5,05 L/s	5,39 L/s	-	
DE25	2,57 L/s	2,68 L/s	2,57 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: