

**Nom** BALDE  
**Prénom** BOUBACAR  
**Né** le 01/01/1992  
**Age** 33 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 240  
**Taille** 168 cm  
**Poids** 66 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DRIVER  
**Entreprise** CHALIECO  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,3 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 54 %

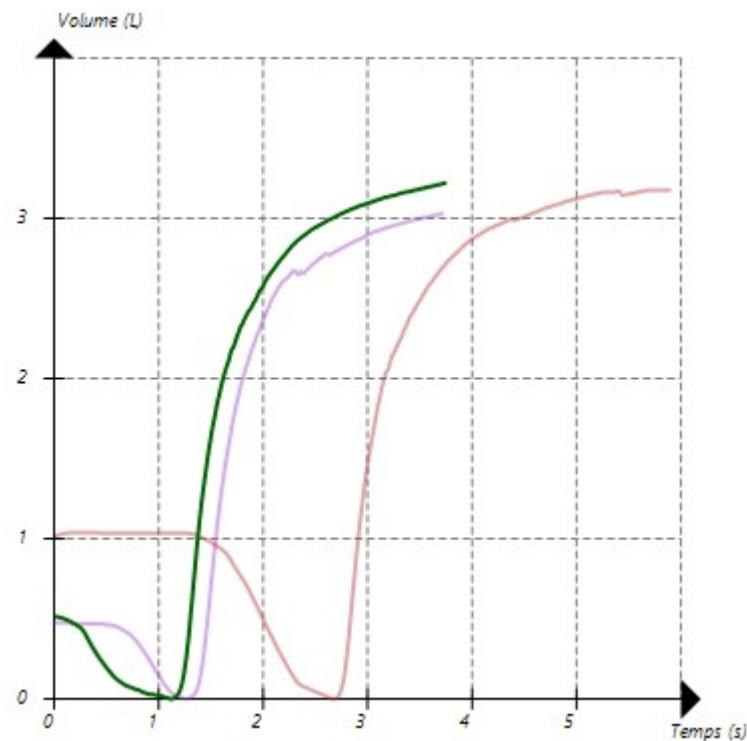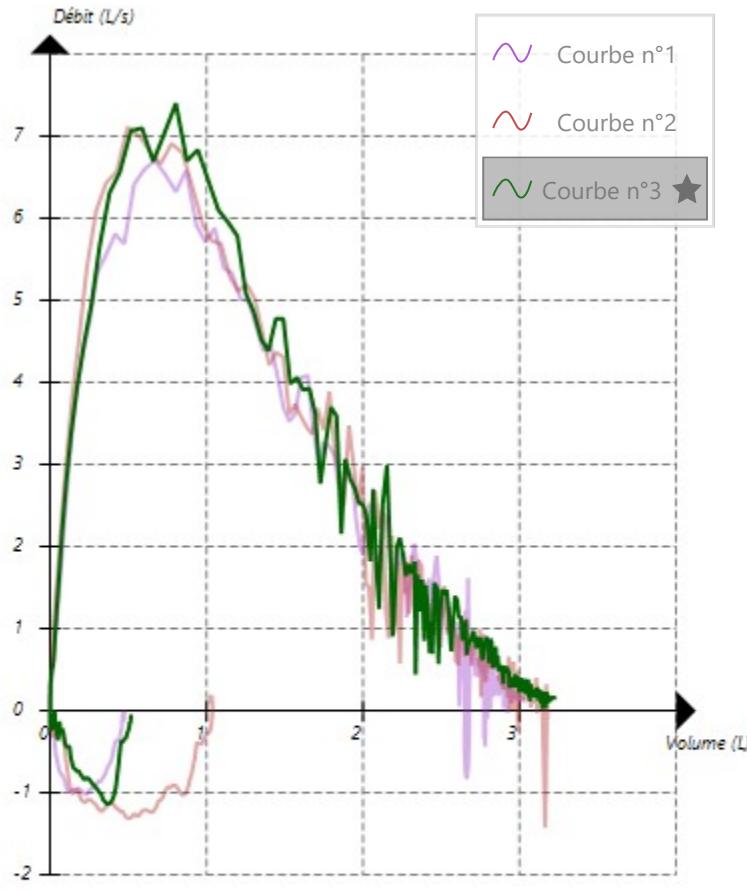

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,03 L	3,18 L	3,22 L	3,94 L	81,73 %
VEMS	2,66 L	2,73 L	2,80 L	3,30 L	84,85 %
DEP	6,97 L/s	7,37 L/s	7,88 L/s	8,59 L/s	91,73 %
VEMS/CVF	87,79 %	85,85 %	86,96 %	83,21 %	104,51 %
Durée d'expiration	2,47 s	3,02 s	2,64 s	-	
DEMM	3,50 L/s	3,04 L/s	3,16 L/s	3,70 L/s	85,41 %
DEMM/CVF	1,16 s <sup>-1</sup>	0,96 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	0,94 s <sup>-1</sup>	104,26 %
DE75	6,37 L/s	6,88 L/s	7,50 L/s	-	
DE50	3,76 L/s	3,94 L/s	4,08 L/s	-	
DE25	1,66 L/s	0,99 L/s	0,98 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: