

<b>Nom FU</b>	<b>Adresse COLEAH</b>
<b>Prénom JUN</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 23/01/1979</b>	<b>Profession KAM</b>
<b>Age 46 Ans</b>	<b>Entreprise NEEMBA GUINEE</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 11</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 169 cm</b>	<b>Groupe ethnique Caucasien</b>
<b>Poids 91 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Eccs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,4 °C  
 Pression atmosphérique : 100,7 kPa  
 Humidité : 45 %

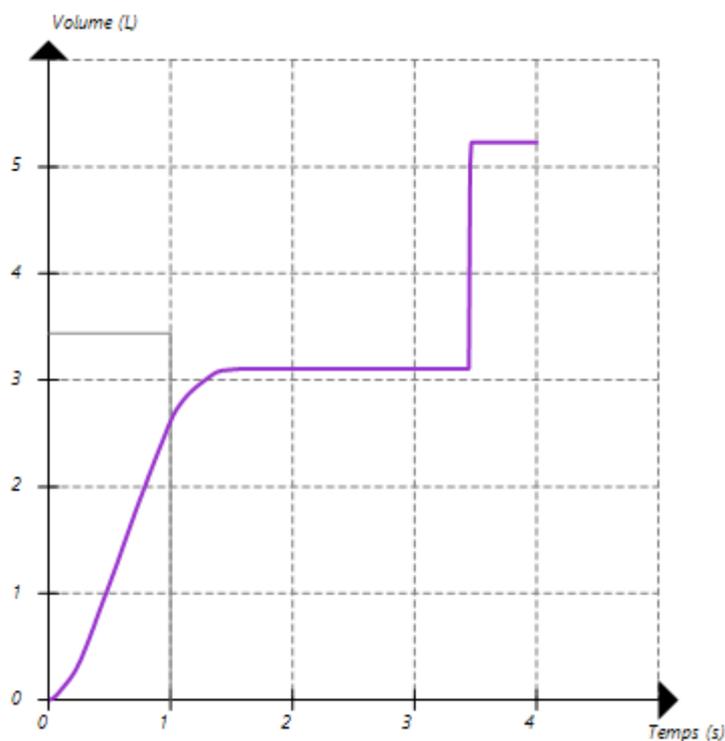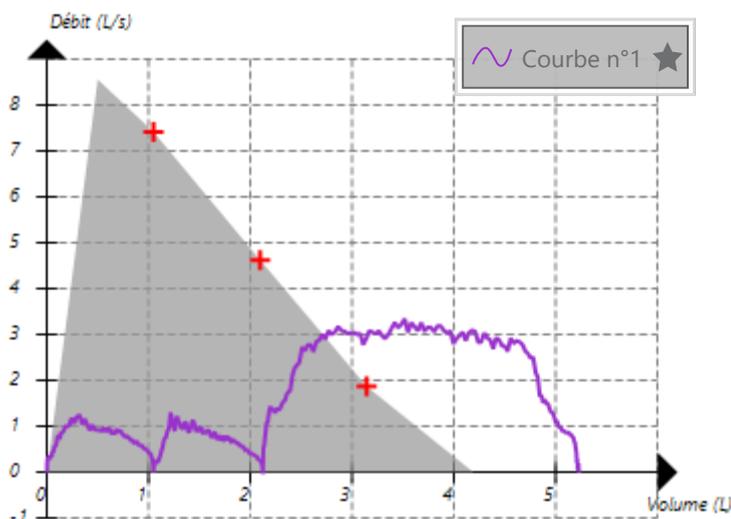

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,11 L	4,19 L	74,22 %
VEMS	2,90 L	3,44 L	84,30 %
DÉP	3,45 L/s	8,56 L/s	40,30 %
VEMS/CVF	93,25 %	78,98 %	118,07 %
Durée d'expiration	3,50 s	-	
DEMM	3,10 L/s	4,01 L/s	77,31 %
DEMM/CVF	1,00 s <sup>-1</sup>	0,96 s <sup>-1</sup>	104,17 %
DE75	3,14 L/s	7,42 L/s	42,32 %
DE50	3,36 L/s	4,63 L/s	72,57 %
DE25	2,92 L/s	1,87 L/s	156,15 %