


<b>Nom</b> BAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOUL KARIM	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 23/01/1998	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> NEEMBA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 26	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,5 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 94 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %

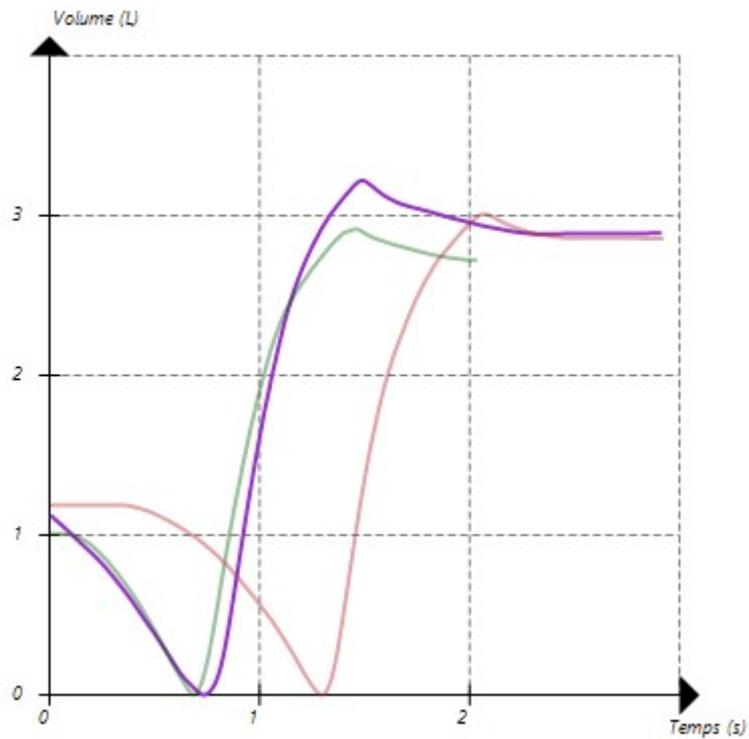

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,22 L	2,92 L	3,01 L	4,40 L	73,18 %
VEMS	3,22 L	2,92 L	3,01 L	3,71 L	86,79 %
DEP	8,71 L/s	8,06 L/s	8,90 L/s	9,40 L/s	92,66 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,30 %	118,62 %
Durée d'expiration	0,75 s	0,77 s	0,77 s	-	
DEMM	6,77 L/s	6,10 L/s	6,05 L/s	4,17 L/s	162,35 %
DEMM/ CVF	2,10 s-1	2,09 s-1	2,01 s-1	0,95 s-1	221,05 %
DE75	8,40 L/s	7,40 L/s	8,42 L/s	-	
DE50	7,20 L/s	5,48 L/s	6,43 L/s	-	
DE25	3,99 L/s	3,57 L/s	2,97 L/s	-	