

<b>Nom</b> WANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YUGUO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 21/11/1971	<b>Profession</b> SOUDEUR
<b>Age</b> 53 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC EPC3
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 431	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 101,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 74 %

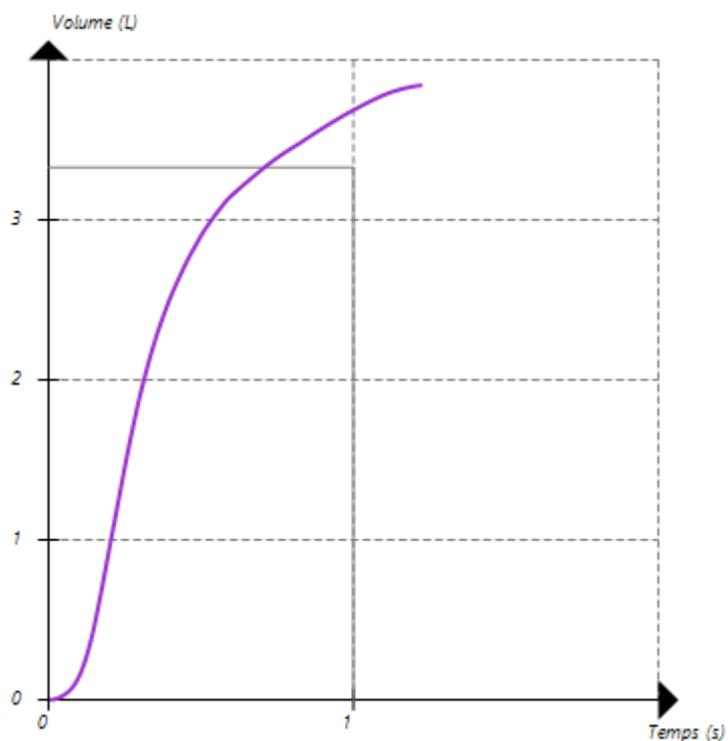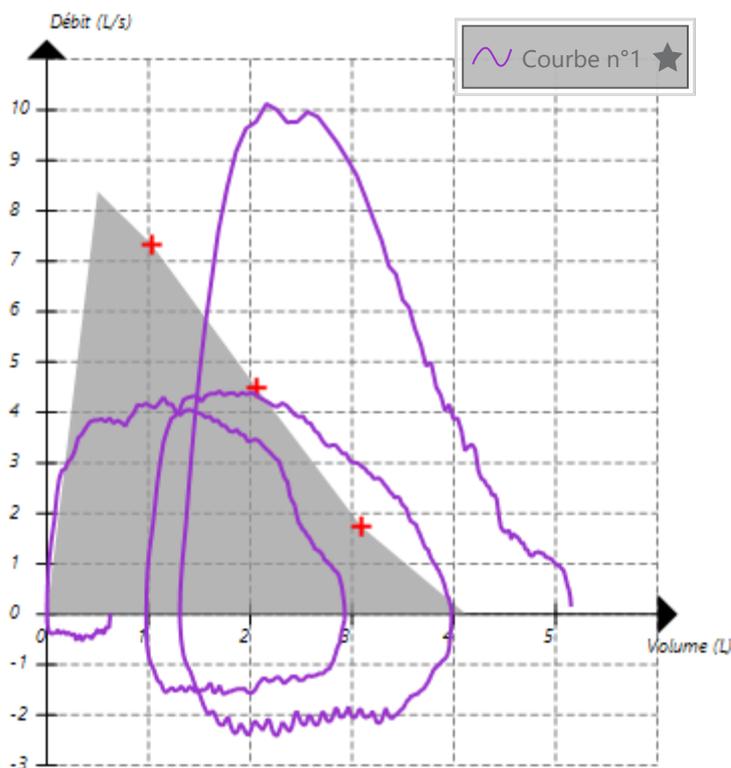

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,84 L	4,12 L	93,20 %
VEMS	3,78 L	3,33 L	113,51 %
DÉP	10,25 L/s	8,38 L/s	122,32 %
VEMS/CVF	98,44 %	77,72 %	126,66 %
Durée d'expiration	1,24 s	-	
DEMM	6,54 L/s	3,74 L/s	174,87 %
DEMM/CVF	1,70 s <sup>-1</sup>	0,91 s <sup>-1</sup>	186,81 %
DE75	10,06 L/s	7,33 L/s	137,24 %
DE50	7,77 L/s	4,49 L/s	173,05 %
DE25	3,33 L/s	1,74 L/s	191,38 %