



<b>Nom</b> TIAN	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> HUILIN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/03/1971	<b>Profession</b> HSE
<b>Age</b> 54 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC EPC3
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 79 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 8
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 253562      Pression atmosphérique : 101,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026      Humidité : 77 %

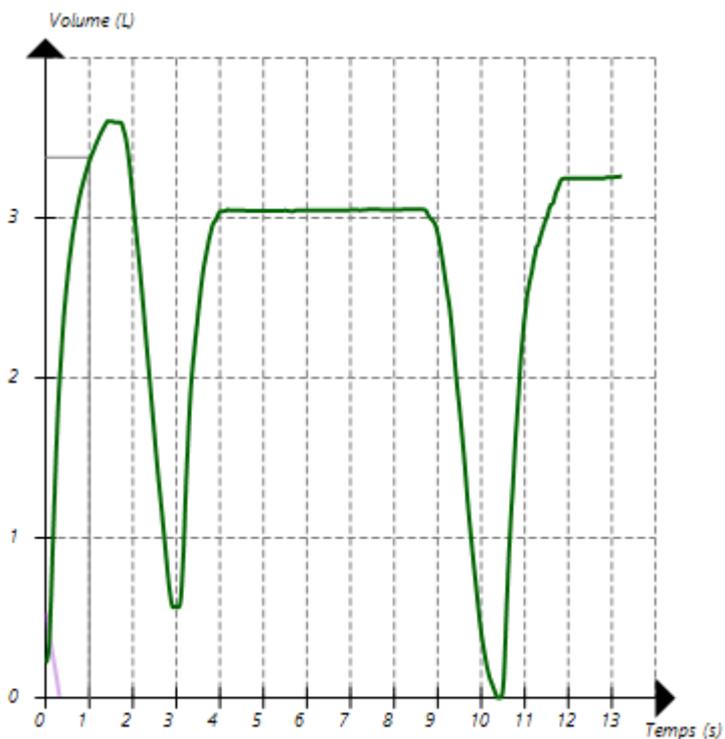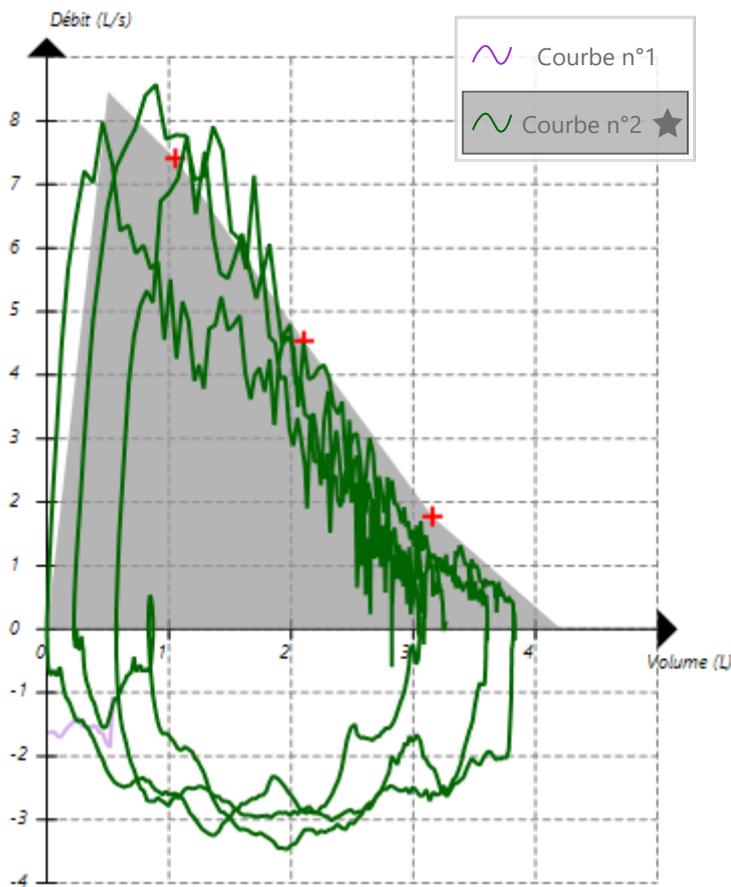

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,54 L	3,39 L	4,21 L	80,52 %
VEMS	0,54 L	3,19 L	3,38 L	94,38 %
DÉP	-	8,96 L/s	8,46 L/s	105,91 %
VEMS/ CVF	100,00 %	94,10 %	77,54 %	121,36 %
Durée d'expiration	-0,32 s	1,43 s	-	
DEMM	-	4,48 L/s	3,74 L/s	119,79 %
DEMM/ CVF	-	1,32 s-1	0,89 s-1	148,31 %
DE75	-	7,60 L/s	7,41 L/s	102,56 %
DE50	-	4,28 L/s	4,54 L/s	94,27 %
DE25	-	2,03 L/s	1,77 L/s	114,69 %