

<b>Nom</b> GAO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> HONGJIE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/06/1978	<b>Profession</b> SCAFFOLDER
<b>Age</b> 47 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC EPC3
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 2	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,8 °C  
 Pression atmosphérique : 101,3 kPa  
 Humidité : 76 %

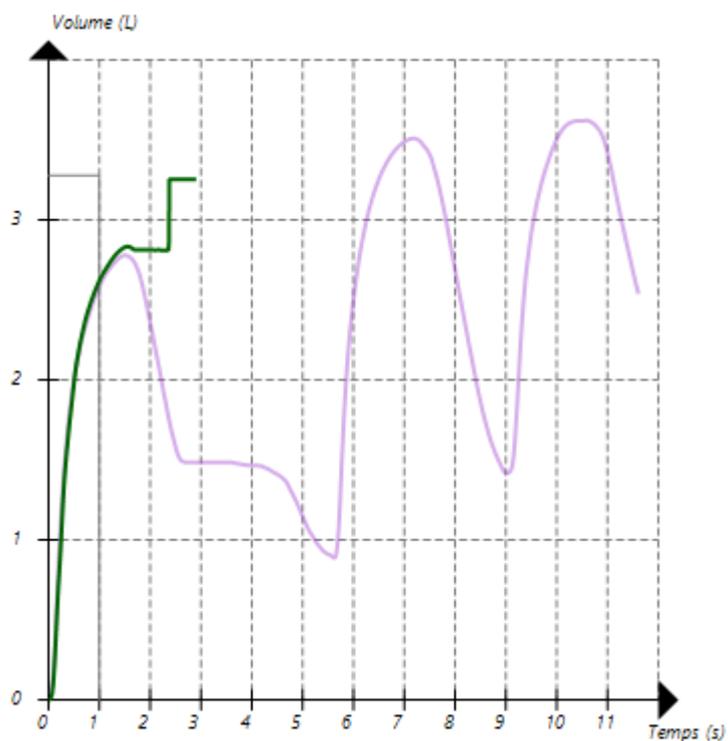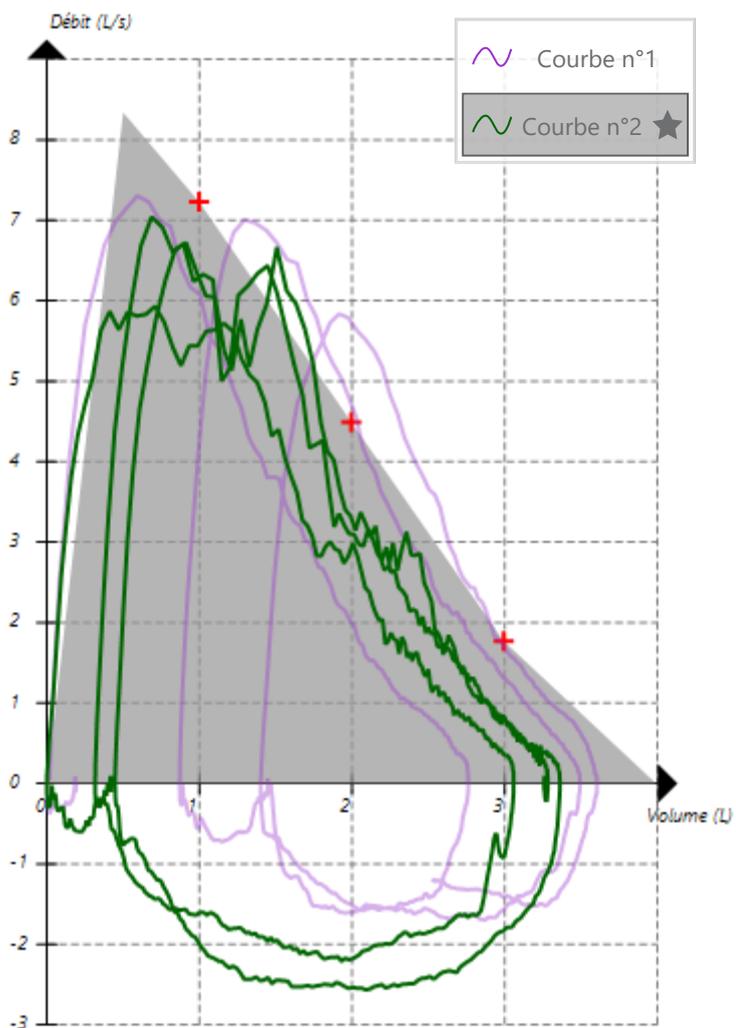

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,76 L	2,84 L	3,99 L	71,18 %
VEMS	2,62 L	2,67 L	3,28 L	81,40 %
DÉP	7,42 L/s	7,40 L/s	8,34 L/s	88,73 %
VEMS/ CVF	94,93 %	94,01 %	78,80 %	119,30 %
Durée d'expiration	1,64 s	1,57 s	-	
DEMM	3,75 L/s	3,85 L/s	3,91 L/s	98,47 %
DEMM/ CVF	1,36 s <sup>-1</sup>	1,36 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	138,78 %
DE75	7,15 L/s	5,76 L/s	7,23 L/s	79,67 %
DE50	4,25 L/s	4,17 L/s	4,49 L/s	92,87 %
DE25	1,71 L/s	1,95 L/s	1,77 L/s	110,17 %